



بررسی آزمایشگاهی دقیق سرعت سنج صوتی جانب‌نگر در میدان جریان آشفته

مصطفی نبی‌پور^۱، سید علی اکبر صالحی نیشابوری^{۲*}، رضا صادقی دودران^۳، امیر رضا زراتی^۴، سید حسین مهاجری^۵، محمد ضابطیان طرقی^۶

- دانشجوی دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

- استاد، مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

- دانشجوی دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

- استاد، مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر، تهران

- استادیار، مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین

- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

*- تهران، صندوق پستی 14115116 salehi@modares.ac.ir

کلید واژگان:

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۰۳ آبان ۱۳۹۶

پذیرش: ۰۴ دی ۱۳۹۶

ارائه در سایت: ۲۹ دی ۱۳۹۶

کلید واژگان:

سرعت سنج صوتی جانب‌نگر

سرعت سنج تصویری ذرات

الگوی جریان

پارامترهای آشفته

چکیده

یکی از روش‌های متدالول در اندازه‌گیری میدان جریان در کانال‌های باز استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر می‌باشد. حضور فیزیکی حسگرها و بدنه دستگاه سرعت سنج صوتی در داخل جریان سبب تغییر در الگو و ساختارهای آشفته‌گی جریان می‌شود. بنابراین خطای دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر از دو عامل خطای ذاتی دستگاه و حضور فیزیکی بدنه و حسگرهای دستگاه در داخل جریان ناشی می‌شود. برای مطالعه این موضوع، در این مقاله میدان جریان با استفاده از ابزار سرعت سنج تصویری ذرات و دستگاه سرعت سنج صوتی جانب‌نگر اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در اندازه‌گیری سرعت طولی، نتایج هر دو ابزار به یکدیگر نزدیک بوده و به طور متوسط ۵ درصد اختلاف دارند، در حالی که سرعت‌های قائم و عرضی دارای تفاوت قابل توجهی با یکدیگر می‌باشند. همچنین مقایسه مقادیر شدت آشفته‌گی طولی و عرضی و نتش برشی رینولز نشان می‌دهد که اختلاف مقادیر در نزدیکی سطح آب کمتر و با نزدیکشدن به بستر افزایش می‌یابد.

اطلاعات مقاله

Experimental study of side looking ADV probe accuracy in a turbulent flow field

Mostafa Nabipour^۱, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri^{۱*}, Reza Sadeghi Dodaran^۱, Amir Reza Zarrati^۲, Seyed Hossein Mohajeri^۳, Mohammad Zabetian Toroghi^۴

۱-Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

۲- Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran

۳- Department of Civil Engineering, Emam Khomeini International University, ghazvin, Iran

۴- Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

* P.O.B. 14115116 Tehran, Iran, salehi@modares.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 25 October 2017

Accepted 25 December 2017

Available Online 19 January 2018

Keywords:

Side looking Acoustic Doppler Velocimeter

Particle Image Velocimetry

Flow pattern

Turbulence parameters

ABSTRACT

One of the usual and useful techniques for the flow field measurement in open channels is Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). Physical presence of ADV probe and its holding system against flow disturb natural flow pattern which can change turbulent flow structure. Thus, the error of the Acoustic Doppler Velocimeter is consist of its intrinsic error and the physical presence of ADV against flow. To study this issue in this paper, flow field in an open-channel is measured using Particle Image Velocimetry (PIV) technique and side-looking ADV probe. The results show that streamwise velocity obtained from both methods are in good agreement and on average, there is 5 percent difference, while vertical and lateral components of velocity are considerably different. Also, comparison of streamwise and lateral turbulence intensities and the Reynolds shear stress shows lower differences for measured points near the water surface and the differences increase approaching to the bed.

۱- مقدمه

جریان در محیط‌های مختلف می‌باشند [۱]، اما هنوز پیش‌بینی میدان جریان در موقعیت‌های پیچیده و شرایط سه بعدی با استفاده از این ابزارها از دقت کافی برخوردار نبوده و با مدل‌سازی عددی امکان پذیر نیست [۲]. از سوی دیگر در بررسی‌های میدانی و آزمایشگاهی اغلب نیاز به کنترل و بررسی جریان به کمک تجهیزات اندازه‌گیری می‌باشد. بنابراین اندازه‌گیری جریان در مطالعات آزمایشگاهی و میدانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و داده‌های با

به طور کلی شناخت یک پدیده هیدرولیکی و کشف زوایای مختلف آن از سه روش بررسی میدانی، مطالعه آزمایشگاهی و یا شبیه‌سازی عددی آن پدیده صورت می‌گیرد. هرچند امروزه شبیه‌سازی‌های عددی با استفاده از مدل‌های هیدرولیک محاسباتی^۱، یکی از پرکاربردترین ابزارها برای شناخت میدان

^۱ Computational Fluid Dynamics (CFD)

Please cite this article using:

M. Nabipour, S. A. A. Salehi Neyshabouri, R. Sadeghi Dodaran, A. R. Zarrati, S. H. Mohajeri, M. Zabetian Toroghi, Experimental study of side looking ADV probe accuracy in a turbulent flow field, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 18, No. 01, pp. 406-412, 2018 (in Persian)


برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

www.SJTU.ir

تجاوز نماید، دوم اینکه شدت‌های آشفتگی زیاد باشند و سوم اینکه محل اندازه‌گیری سرعت در نزدیکی مرزهای صلب (دیواره‌ها) باشد. در نزدیکی دیواره به علت انعکاس گروهی از امواج صوتی توسط مرز صلب، اندازه‌گیری سرعت سیال با مشکل مواجه می‌شود [12]. رونان و همکاران به مقایسه کمی تنش‌های رینولدز در کanal باز حاصل از روش‌های سرعت‌سنجی تصویری درازات^۱ و سرعت‌سنج صوتی پروفایلر^{۱۱} پایین‌نگر پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر اندازه‌گیری شده بوسیله دو دستگاه دارای اختلاف بوده و اندازه‌گیری پارامترهای آشفتگی با دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر نیازمند ارزیابی دقیق می‌باشد [13]. البته ایشان درخصوص دقیق دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر در اندازه‌گیری جریان‌های ثانویه اظهار نظر نکردند.

علاوه بر خطای ذاتی دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر، حضور حسگرهای دستگاه در داخل جریان به صورت یک مانع عمل نموده و موجب تغییر الگوی جریان و بروز خطا می‌شود (شکل ۱). برای کاهش اثر تداخلی شاخک‌های دستگاه سرعت‌سنج صوتی، نسل جدید حسگرهای طراحی و به طور گسترش داول استفاده قرار گرفته است. روزلو و همکاران به بررسی اثر تداخلی شاخک‌های نسل جدید نسبت به نسل قدیم در میدان جریان پرداختند. نتایج پژوهش این محققان نشان داد که نسل جدید این دستگاه تلاطم کمتری در جریان ایجاد نموده و قادر به اندازه‌گیری مشخصات جریان در نسبت‌های پایین سیگنال به نویز می‌باشد [14]. به همین منظور در تحقیق حاضر نیز از شاخک‌های نسل جدید سرعت‌سنج صوتی داپلر استفاده گردید.

على‌رغم استفاده گسترش دستگاه سرعت‌سنجی صوتی داپلر در مطالعات آزمایشگاهی، تاکنون مطالعه جامعی در مورد بررسی دقیق دستگاه سرعت‌سنج صوتی با تکنیک‌های اندازه‌گیری تصویری میدان جریان انجام نشده است. بنابراین لزوم تحقیقات بیشتر بر روی اثر دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر در الگوی جریان و ساختار آشفتگی در محدوده اندازه‌گیری دستگاه ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور در این تحقیق میدان جریان با استفاده از ابزار سرعت‌سنج تصویری ذرات (در محدوده حجم نمونه‌گیری) و دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر جانب‌نگر اندازه‌گیری و مورد بررسی قرار

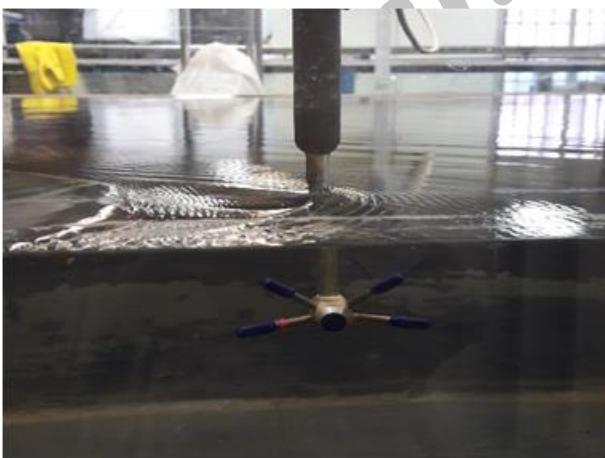

شکل ۱ نمایی از ایجاد تداخل دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر جانب‌نگر در جریان هنگام اندازه‌گیری سرعت (جهت جریان از راست به چپ می‌باشد).

^{۱۰} Particle Image Velocimetry

^{۱۱} ADV Profiler Velocimeter

کیفیت بالا، نقش اساسی در فهم پدیده‌های هیدرولیکی و توسعه و صحبت‌سنجی مدل‌های عددی دارند [3].

از جمله روش‌های پرکاربرد اندازه‌گیری میدان جریان در کanal‌های باز استفاده از دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر^۱ می‌باشد. دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر با توجه به جهت قرارگیری حسگر به دو نوع پایین‌نگر^۲ و جانب‌نگر^۳ تقسیم می‌شود. این دستگاه برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ توسط شرکت سونتک^۴ ارائه شده و به طور گسترش ده برای اندازه‌گیری مولفه‌های سه‌بعدی جریان آشفته مورد استفاده قرار گرفته است [4]. نسل جدید این سرعت‌سنج‌ها از طریق ارسال امواج صوتی^۵ با فرکانس ۱ تا 200 هرتز از یک فرستنده به سمت یک حجم نمونه‌گیری^۶ (به شکل استوانه به قطر ۶ میلی‌متر و ارتفاع ۳ میلی‌متر که در فاصله ۵ سانتی‌متری فرستنده واقع شده است) و دریافت امواج برگشتی توسط سه یا چهار شاخک گیرنده، سرعت ذرات داخل حجم نمونه‌گیری را اندازه‌گیری می‌کند. اساس عملکرد این ابزار، پدیده داپلر شیفت (تغییر فرکانس امواج رفت و برگشتی به واسطه برخورد با ذرات داخل حجم نمونه‌گیری) می‌باشد. در این روش فرض بر آن است که ذرات داخل توجه به اساس عملکرد دستگاه، سنسور فرستنده و همچنین شاخک‌های گیرنده باقیت همواره در جریان مستغرق باشند [5].

مطالعات گذشته حاکی از آن است که دستگاه سرعت‌سنج صوتی دارای دقیق مناسب در اندازه‌گیری سرعت میانگین بوده، در حالی که این دستگاه در اندازه‌گیری پارامترهای آشفتگی از جمله تنش‌های رینولدز و انرژی جنبشی آشفتگی از دقیق کافی برخوردار نیست [7,6]. دو منشا اصلی داده‌های نادرست در دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر، ناشی از پدیده داپلر نویز^۷ و پدیده هم‌اثرسازی سیگنال^۸ می‌باشند [8]. لوهمن و همکاران برای بررسی میزان کارآمدی دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر در اقیانوس‌ها، به مقایسه این دستگاه با دستگاه سرعت‌سنج لیزری داپلر^۹ در فلوم آزمایشگاهی پرداختند. نتایج این پژوهشگران نشان داد که در محدوده سرعت‌های بالا (۵ تا ۸۰ سانتی‌متر در ثانیه) مطابقت خوبی بین تنش‌های رینولدز اندازه‌گیری شده با دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر و دستگاه سرعت‌سنج لیزری داپلر وجود دارد، هر چند این تطابق در سرعت‌های پایین (کمتر از ۱۰ سانتی‌متر در ثانیه) کمتر است [9]. اما ایشان در خصوص جریان‌های متوسط ثانویه (سرعت متوسط قائم و عرضی) و شدت‌های آشفتگی اظهار نظر نکردند. نیکورا و گورینگ به منظور بررسی دقیق دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر در محیط‌های متفاوت، آزمایش‌هایی در سه شرایط مختلف (در حوضچه ذخیره آب حاوی سیلت، در فلوم آزمایشگاهی حاوی ذرات معلق و در آب طبیعی حاوی حباب‌های هوای) انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پدیده داپلر نویز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی مشخصه‌های آشفتگی داشته باشد [10]. همچنین گورینگ و نیکورا به بررسی اثر پدیده هم‌اثرسازی سیگنال بر روی داده‌های حاصل از دستگاه سرعت‌سنج صوتی داپلر پرداختند [11]. احتمال رخداد این خطأ در دستگاه سرعت‌سنجی صوتی داپلر در سه حالت بیشتر است: اول اینکه سرعت جریان از محدوده سرعت مجاز دستگاه

^۱ Acoustic Doppler Velocimetry(ADV)

^۲ Down Looking

^۳ Side Looking

^۴ Sontek

^۵ Acoustic

^۶ Sample Volume

^۷ Doppler Noise

^۸ Aliasing of Signal

^۹ Lasser Doppler Velocimetry

گرفت. تصویربرداری از صفحه نورانی با کیفیت 1080×2048 پیکسل و سرعت ۲۳۹.۷۶ فریم در ثانیه و در حالت خام^۱ انجام شد. برای روش کردن صفحه برداشت از یک لیزر از نوع حالت جامد^۲ با موج پیوسته استفاده شد. این لیزر دارای توان حداکثر ۲.۱۵ وات بوده و نور سبزرنگ با طول موج ۵۳۲ نانومتر را از طریق یک عدسی با زاویه راس ۴۵ درجه پرتاب می‌کند. ذرات الکشده پالیولایت^۳ با اندازه ۳۰۰ تا ۶۰۰ میکرومتر و چگالی ۱.۰۳ گرم در سانتی‌متر مکعب به عنوان مواد ریدیاب در آب استفاده شد. این نوع ذرات توسط پژوهشگران دیگر مانند ژانگ و نف نیز در روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات به کار رفته است [۱۷]. برای به دست آوردن توزیع همگن از مواد ریدیاب در محل برداشت، مقدار مشخصی از مواد ریدیاب در مخزن کانال ریخته شد که پس از آغاز به کار سیستم پمپاژ، این ذرات به صورت گردشی در کل مجموعه مخزن و کانال حرکت می‌کنند. تراکم ذرات ریدیاب و ابعاد پنجره‌های کاوش به گونه‌ای تنظیم شد که دقیق اندازه‌گیری سرعت جریان افزایش یابد [۱۸]. پردازش و تحلیل تصاویر با استفاده از نرم‌افزار پی آی وی لب^۴ انجام شد [۱۹]. فاصله بردارهای سرعت بدست‌آمدۀ در هر یک از صفحه‌های اندازه‌گیری حدود ۱ میلی‌متر بوده است. زمان و فرکانس نمونه‌برداری به ترتیب حدود ۸۰ ثانیه ۲۴۰ هرتز در نظر گرفته شد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، زمان مذکور برای عدم تغییر مقادیر متوسط سرعت و تنش‌های رینولدز کافی است. برای مقایسه داده‌های برداشت شده توسط دستگاه سرعت‌سنجی تصویری ذرات و دستگاه سرعت سنج صوتی جانبی‌تگ، مؤلفه‌های سرعت لحظه‌ای توسط دستگاه سرعت‌سنج صوتی جانبی‌تگ برداشت گردید. این دستگاه سه مؤلفه سرعت لحظه‌ای را در سه جهت به صورت همزمان برداشت می‌کند. مشابه اندازه‌گیری سرعت توسط دستگاه سرعت‌سنجی تصویری ذرات، برداشت سرعت در میانه سیلاپدیست (با فاصله ۳۰ سانتی‌متر از دیواره سمت راست کانال در شکل ۲ و در امتداد قائم (از عمق ۰.۵ تا ۷.۵ سانتی‌متری از کف) انجام شده است. لازم به ذکر است با توجه به محدودیت‌های دستگاه سرعت سنج صوتی جانبی‌تگ، برداشت سرعت در فاصله کمتر از ۵ میلی‌متر از کف کانال و همچنین در فاصله ۲۵ میلی‌متر از سطح آب قابل انجام نیست. علاوه بر این سرعت جریان توسط دستگاه سرعت سنج صوتی جانبی‌تگ در امتداد افقی و در عمق ۵ سانتی‌متری از کف، و در محدوده ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متری از جداره سمت راست هم برداشت گردید. فواصل نقاط برداشت در عمق و در عرض کانال، ۱ سانتی‌متر می‌باشد. فرکانس برداشت اطلاعات ۱۰۰ هرتز و حجم نمونه‌برداری ۶ میلی‌متر مکعب تعیین گردید. برای داشتن سری زمانی پایدار در محاسبه مقادیر مؤلفه‌های متوجه سرعت و همچنین تنش‌های رینولدز، برداشت سرعت در هر نقطه به مدت ۱۸۰ ثانیه (۳ دقیقه) در نظر گرفته شد و برای پاکسازی داده‌های پرت از نرم‌افزار وین ای دی وی^۵ استفاده شد [۲۰].

۳- نتایج و بحث

همان‌طور که در بخش مقدمه گفته شد خطای دستگاه سرعت سنج صوتی دایلر ناشی از دو عامل خطای ذاتی دستگاه و حضور بدنه و شاخک‌های دستگاه در داخل جریان می‌باشد. در ابتدا به منظور بررسی کیفی اثر تداخلی شاخک‌های سرعت سنج صوتی در محدوده حجم کنترل، برداشت اطلاعات جریان بوسیله سرعت سنج تصویری ذرات در صفحه قائم با حضور فیزیکی

گرفته است. در ادامه به توضیح این آزمایش‌ها و نحوه برداشت میدان جریان پرداخته می‌شود.

۲- تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایش‌ها در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس در یک کانال مستقيمه به طول ۱۱، عرض ۱ و ارتفاع ۰.۷ متر انجام شد. کانال آزمایشگاهی مذکور، یک کانال عریض با مقطع مرکب می‌باشد (شکل ۲). با توجه به عرض زیاد کانال و همچنین عرض زیاد سیلاپدیست، پروفیل سرعت در وسط سیلاپدیست مشابه پروفیل سرعت لگاریتمی با بستر صاف می‌باشد و به عبارت دیگر جریان در اواسط سیلاپدیست تقریباً دوبعدی است [۱۵]. همچنین با توجه به نسبت عرض سیلاپدیست به عمق جریان ($b/h = 6 > 5$)، کانال از نوع عریض محسوب می‌شود [۱۶]. جداره‌های جانبی و کف کانال از جنس شیشه بوده و برای تصویربرداری از جریان، مناسب می‌باشند.

محور X موازی بستر بوده و در جهت راستای طولی جریان اصلی و به سمت پایین‌دست مثبت می‌باشد. محور Y عمود بر جهت جریان در راستای Z قائم بوده و جهت مثبت آن از بستر به سمت بالا می‌باشد. در نهایت محور Z در راستای عرضی بوده و مبدأ آن دیواره سمت راست کانال می‌باشد. برای کنترل عمق آب، از یک سریز قابل تنظیم در انتهای کانال استفاده شد. دبی در ورودی کانال با استفاده از شیر تنظیم دبی خروجی از پمپ، کنترل شده و به‌وسیله یک دبی‌سنج الکترومغناطیسی اندازه‌گیری شد. به منظور حذف تلاطم در ابتدای کانال از صفحه‌های موازی آرام‌کننده جریان استفاده شده است. شرایط توسعه یافته‌گی جریان در مقطع اندازه‌گیری توسط نبی‌پور و همکاران مورد بررسی و تایید قرار گرفت [۱۵]. عمق جریان در سیلاپدیست برابر ۱۰ سانتی‌متر بوده و رژیم جریان در کانال، زیرحرانی و کاملاً آشفته می‌باشد.

برای اندازه‌گیری غیرتداخلی میدان جریان از دستگاه سرعت سنجی تصویری ذرات به صورت دوبعدی و دومولفه‌ای در صفحات عمودی X - Z استفاده شد. صفحه عمودی موازی دیواره‌های کانال و به فاصله ۳۰ سانتی‌متری از دیواره سمت راست کانال در شکل ۲ در نظر گرفته شد و صفحه افقی موازی بستر کانال و به فاصله ۵ سانتی‌متر از آن می‌باشد. صفحه‌ها به صورت خط‌چین در شکل ۲ نشان داده‌اند.

در تمامی اندازه‌گیری‌ها، دوربین پرسرعت سونی، با یک حسگر حساس به نور به همراه لنز ماکرو با فاصله کانونی ۱۰۰ میلی‌متر مورد استفاده قرار

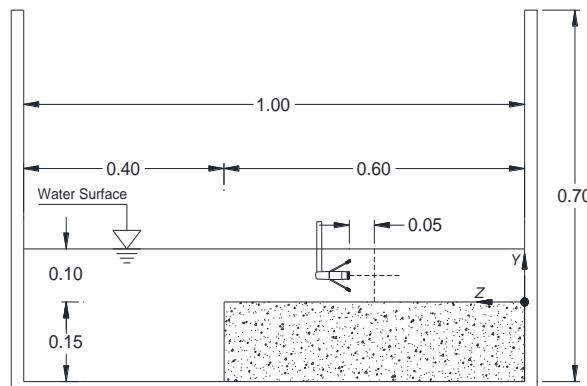


Fig. 2 The cross section of compound channel in present study (All dimensions are in meters.)

شکل ۲ مقطع عرضی کانال در مطالعه حاضر (کلیه ابعاد بر حسب متر است)

¹ Raw
² Solid State
³ Pliolite
⁴ PLV Lab
⁵ Win ADV

در ادامه نتایج برداشت میدان جریان توسط دستگاه سرعت‌سنج تصویری ذرات و دستگاه سرعت‌سنج صوتی جانب‌نگر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در شکل 5 نتایج حاصل از اندازه‌گیری سرعت طولی و قائم جریان (در وسط سیال‌بندش و در راستای عمق) با استفاده از دو روش سرعت‌سنج تصویری ذرات و سرعت‌سنج صوتی جانب‌نگر ارائه شده است. محور عمودی این دو نمودار با استفاده از عمق جریان ($h = 10 \text{ cm}$) (ب) بعد شده است. از مقایسه پروفیل سرعت طولی جریان در عمق به دست آمده از دو روش سرعت‌سنج تصویری ذرات و سرعت‌سنج صوتی جانب‌نگر می‌توان دریافت که مقادیر حاصل از دو روش به یکدیگر نزدیک بوده و این مطلب بیانگر قابلیت هر دو روش در اندازه‌گیری سرعت طولی جریان می‌باشد. سرعت طولی حاصل از روش سرعت‌سنج صوتی جانب‌نگر در راستای عمق (جز در نزدیکی کف) در حدود 5.2 درصد بیشتر از روش سرعت‌سنج تصویری ذرات است. این اختلاف در مطالعات پیشین برابر 4 درصد گزارش شده است [21]. که بیانگر صحت نتایج تحقیق حاضر است.

همان‌طور که در شکل 5- b مشاهده می‌شود برخلاف سرعت طولی، مقادیر سرعت قائم حاصل از دو روش مذکور تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند. با توجه به نمودارهای شکل 5 متوسط نسبت سرعت قائم به سرعت طولی جریان حاصل از روش سرعت‌سنج صوتی جانب‌نگر برابر $\bar{U}/\bar{u} = 0.15$ است و این بدان معنی است که زاویه بردار برآیند سرعت متوسط جریان (با مؤلفه افقی \bar{U} و مؤلفه قائم \bar{U})، دارای زاویه 8.75 درجه نسبت به افق

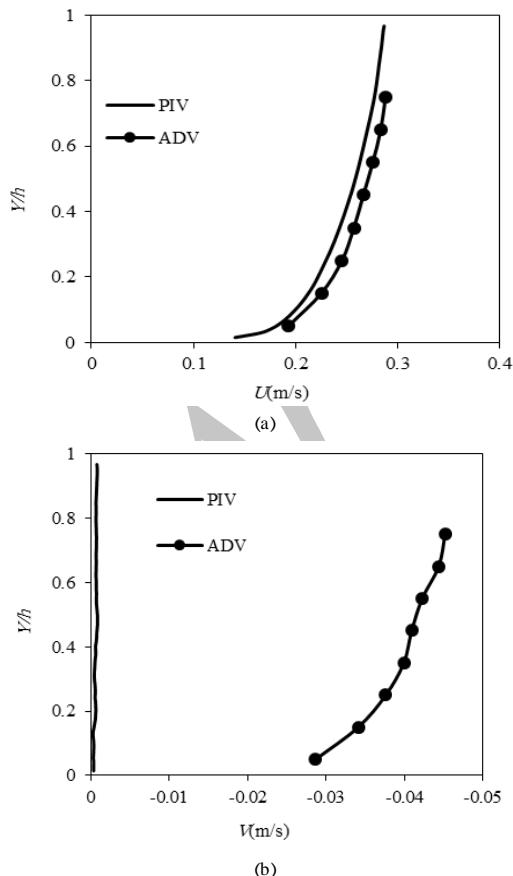


Fig. 5 Comparison the results of measurement the longitudinal and vertical velocity of the flow by using PIV and side looking ADV
شکل 5 مقایسه نتایج اندازه‌گیری سرعت طولی و عمقی جریان با استفاده از روش-

سرعت‌سنج صوتی دایلر (در حالت خاموش) صورت گرفت. دستگاه سرعت‌سنج صوتی در عمق 5 سانتی‌متری جریان و به فاصله عرضی 5 سانتی‌متر از صفحه برداشت قرار داده شد. شکل‌های 3 و 4 اثرات ناشی از حضور بدن و شاخک‌های سرعت‌سنج صوتی را در اندازه‌گیری سرعت طولی و قائم نشان می‌دهند. همان‌طور که در این دو شکل مشاهده می‌شود اثر تداخلی حضور دستگاه سرعت‌سنج صوتی در سرعت طولی قابل ملاحظه نبوده و سرعت طولی جریان در راستای کانال تغییر عمداتی نمی‌کند. این در حالی است که سرعت قائم در راستای جریان کاملاً تغییر کرده و الگوی جریان شکل‌گرفته متفاوت از جریان کاملاً توسعه یافته در کانال باز می‌باشد. بنابراین انتظار می‌رود که اندازه‌گیری جریان‌های ثانویه توسط دستگاه سرعت‌سنج صوتی نسبت به سرعت طولی با خطای بیشتری مواجه گردد. البته قابل ذکر است که بررسی میزان تأثیر تداخل دستگاه سرعت‌سنج صوتی در محدوده حجم نمونه‌گیری آن با توجه به شرایط هیدرولیکی مختلف نیاز به بررسی و مطالعات بیشتر دارد.

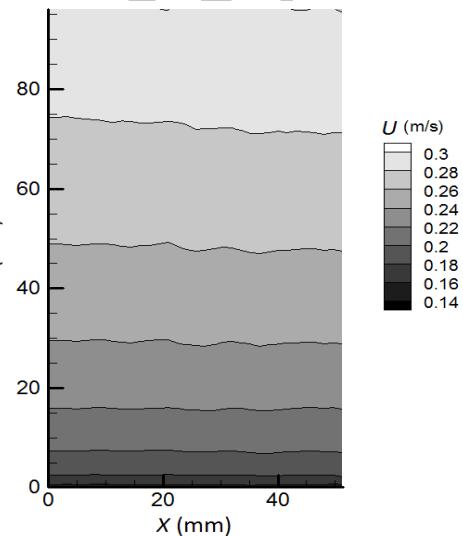


Fig. 3 سرعت طولی جریان در صفحه قائم با حضور فیزیکی سرعت‌سنج صوتی

شکل 3 سرعت طولی جریان در صفحه قائم با حضور فیزیکی سرعت‌سنج صوتی

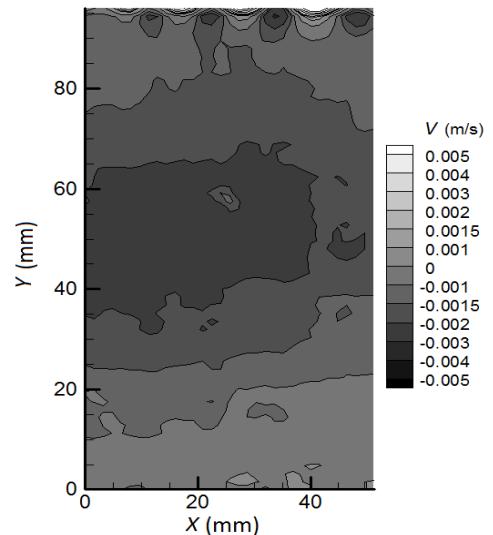


Fig. 4 سرعت قائم جریان در صفحه قائم با حضور فیزیکی سرعت‌سنج صوتی

شکل 4 سرعت قائم جریان در صفحه قائم با حضور فیزیکی سرعت‌سنج صوتی

می باشدند. اما در عرضهای کمتر مقدار سرعت اندازه‌گیری شده توسط سرعت سنجی صوتی کمی بیشتر از سرعت سنجی تصویری ذرات است که این پدیده به دلیل نزدیک شدن سرعت سنجی صوتی به جداره کانال و افزایش سرعت طولی مابین جداره کانال و سرعت سنجی صوتی به واسطه تنگ شدن گیری جریان است.

با دقت در شکل 6- b می‌توان دریافت که سرعت عرضی حاصل از دو روش سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی جانبی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با هم دارند. مقدار سرعت عرضی حاصله از روش سرعت سنجی تصویری ذرات حدود 0.5 درصد حداقل سرعت طولی است، در حالی که این مقدار در روش سرعت سنجی تصویری ذرات با نتایج مشاهدات حاصل از روش سرعت سنج تصویری ذرات با نتایج محققین پیشین در خصوص نسبت مقادیر سرعت ثانویه [24,23] به حداقل سرعت طولی در وسط سیلاند شدت همخوانی داشته و با نتایج حاصل از روش سرعت سنج صوتی جانبی متناقض است.

در شکل 7 نتایج شدت آشفتگی طولی و قائم با استفاده از دو روش سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی جانبی ارائه شده است. مقادیر شدت آشفتگی با استفاده از سرعت برشی کف بی بعد شده‌اند. برای بدست آوردن سرعت برشی کف از برونو بایی مقادیر تنش برشی رینولدز حاصل از روش سرعت سنجی تصویری ذرات استفاده شده است. همان‌طور که در شکل 7 مشاهده می‌شود مقادیر شدت آشفتگی طولی و قائم حاصل از سرعت سنجی صوتی همواره بزرگ‌تر از مقادیر سرعت سنجی تصویری ذرات می‌باشد. با دقت در نتایج شکل 7 می‌توان دریافت که اختلاف مقادیر شدت آشفتگی طولی و قائم حاصل از دو روش سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی جانبی با نزدیک شدن به بستر افزایش می‌باشد. علت این پدیده می‌تواند ناشی از افزایش تداخل دستگاه سرعت سنج صوتی در اندازه‌گیری نقاط با عمق بیشتر باشد.


از مقایسه شکل 6- a و 6- b می‌توان دریافت که علی‌رغم اختلاف کم سرعت طولی حاصل از دو روش (به طور متوسط 5.2 درصد)، تفاوت شدت آشفتگی طولی به دست آمده از روش سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی زیاد است، به طوری که میزان خطای شدت آشفتگی طولی روش سرعت سنجی صوتی نسبت به روش سرعت سنجی تصویری ذرات در بیشترین حالت (در نزدیکی بستر) به حدود 42 درصد می‌رسد. علت خطای بیشتر شدت آشفتگی طولی نسبت به سرعت متوسط طولی این است که مقدار نوسانات سرعت طولی نسبت به مقادیر لحظه‌ای سرعت طولی کوچک‌تر بوده و اندازه‌گیری آن با خطای بیشتری همراه است.

از طرفی میزان خطای شدت آشفتگی قائم حاصل از روش سرعت سنجی صوتی نسبت به شدت آشفتگی طولی در این روش بیشتر است که این اختلاف با توجه به خطای بسیار بالای روش سرعت سنجی صوتی در اندازه‌گیری سرعت قائم جریان قابل توجیه است. البته واضح است که میزان خطای حاصل از روش سرعت سنجی صوتی در اندازه‌گیری نوسانات سرعت قائم کمتر از سرعت متوسط قائم می‌باشد.


در شکل 8 نتایج شدت آشفتگی طولی و عرضی با استفاده از دو روش سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی جانبی ارائه شده است. مقادیر شدت آشفتگی با استفاده از سرعت برشی کف (حاصل از برونو بایی مقادیر تنش برشی رینولدز روش سرعت سنجی تصویری ذرات تا کف) بی بعد شده‌اند. بازه اعداد شدت آشفتگی طولی و عرضی در شکل 8 به گونه‌ای در نظر

خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اطمینان از برقراری جریان یکنواخت در کanal و همچنین شبیه بسیار کم آن (0.0003)، بدیهی است که نتایج برداشت سرعت قائم توسط دستگاه سرعت سنج صوتی با واقعیت مطابقت ندارد. خطای زیاد دستگاه سرعت سنج صوتی جانبی در اندازه‌گیری سرعت قائم در راهنمای دستگاه مورد اشاره قرار گرفته است. دلیل این خطای زیاد، ایجاد داده‌های نادرست متعدد در راستای قائم نسبت به راستای افقی به علت ساختار هندسی سرعت سنج صوتی جانبی ذکر شده است [22]. علت عدم دقت مقادیر سرعت قائم حاصل از سرعت سنج صوتی جانبی، عدم هم‌راستایی امواج ارسالی و دریافتی در جهت قائم می‌باشد. گفتنی است در سرعت سنج صوتی پایین‌ترگر به دلیل هم‌راستایی امواج ارسالی و دریافتی در راستای عمق، مقادیر سرعت اندازه‌گیری شده در راستای قائم دارای دقت بیشتری نسبت به راستای عرضی است [22].

در شکل 6 نتایج حاصل از اندازه‌گیری سرعت طولی و عرضی جریان (در وسط سیلاند شدت و در راستای عرض) با استفاده از دو روش سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی جانبی ارائه شده است. محور عمودی این دو نمودار با استفاده از عرض کanal ($B = 100\text{ cm}$) بی بعد شده است. بازه اعداد سرعت طولی در شکل 6- a از 0 تا 0.4 متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است تا امکان مقایسه دو نمودار -5 و -6 وجود داشته باشد. همان‌طور که در شکل 6- a مشاهده می‌شود مقادیر سرعت طولی حاصل از دو روش سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی به هم نزدیک

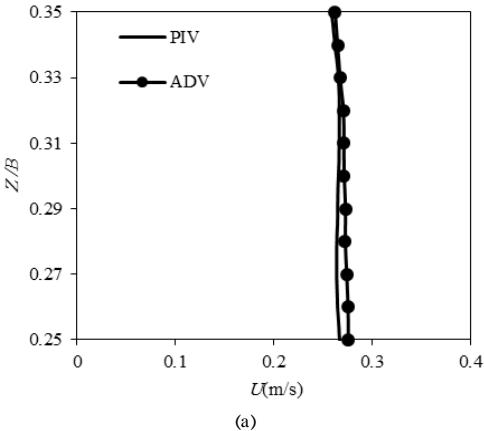


(a)

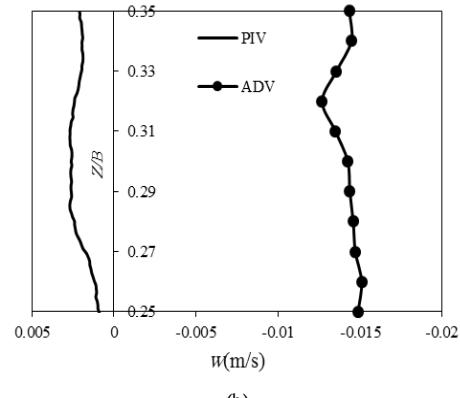


(b)

Fig. 6 Comparison the results of measurement the longitudinal and transverse velocity of the flow by using PIV and side looking ADV


شکل 6 مقایسه نتایج اندازه‌گیری سرعت طولی و عرضی جریان با استفاده از روش‌های PIV و ADV جانبی.

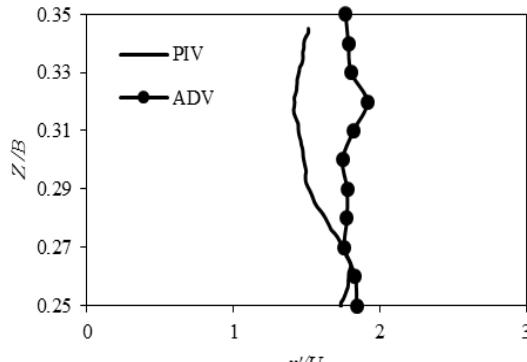


(a)

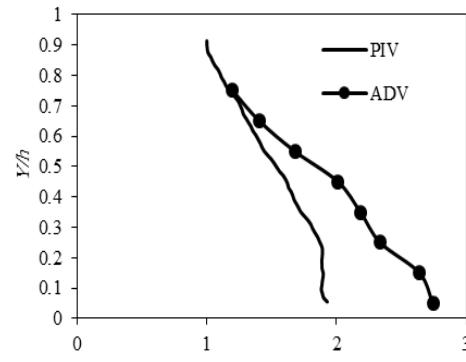

(a)

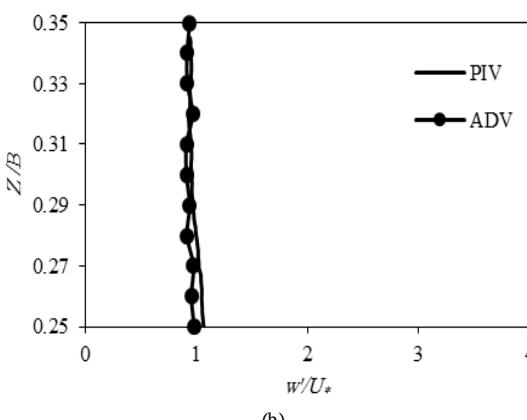

(b)

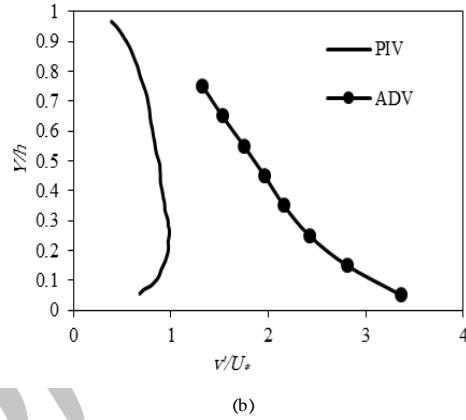

(b)

Fig.8 Comparison the results of longitudinal and transverse turbulence intensity by using PIV and side looking ADV

شکل 8 مقایسه نتایج شدت آشفتگی طولی و عرضی جریان با استفاده از روش‌های PIV و ADV جانب‌نگر

Fig.7 Comparison the results of longitudinal and vertical turbulence intensity by using PIV and side looking ADV

شکل 7 مقایسه نتایج شدت آشفتگی طولی و قائم جریان با استفاده از روش‌های PIV و ADV جانب‌نگر

گرفته شده است تا امکان مقایسه این نمودارها با نمودارهای شکل 7 وجود داشته باشد.

با توجه به شکل 8-a می‌توان دریافت که شدت آشفتگی طولی حاصل از دستگاه سرعت‌سنجه صوتی در صفحه افق نیز مشابه صفحه قائم با نتایج حاصل از روش سرعت‌سنجه تصویری ذرات اختلاف قابل توجهی دارد. از سوی دیگر شکل 8-b نشان می‌دهد که شدت آشفتگی عرضی حاصل از دو روش سرعت‌سنجه تصویری ذرات و سرعت‌سنجه صوتی (برخلاف شدت آشفتگی قائم) تغییرات بسیار ناچیزی دارد و می‌توان نتیجه گرفت که سرعت‌سنجه صوتی جانب‌نگر شدت آشفتگی عرضی را به خوبی اندازه‌گیری می‌کند. این در حالی است که سرعت‌سنجه صوتی جانب‌نگر در اندازه‌گیری سرعت متوسط عرضی مناسب نیست (شکل 6-b).

در شکل 9 نتایج تنش برشی رینولذز با استفاده از دو روش سرعت‌سنجه تصویری ذرات و سرعت‌سنجه صوتی جانب‌نگر ارائه شده است. مقادیر تنش برشی رینولذز با استفاده از سرعت برشی کف بی بعد شده‌اند. همان‌طور که گفته شد سرعت برشی کف با استفاده از برونویایی تنش برشی رینولذز (حاصل از روش سرعت‌سنجه تصویری ذرات) تا بستر به دست آمده است. با دقت در نتایج شکل 9 می‌توان دریافت که اختلاف مقادیر تنش برشی رینولذز از دو روش سرعت‌سنجه تصویری ذرات و سرعت‌سنجه صوتی جانب‌نگر با نزدیک شدن به بستر افزایش می‌یابد. مقایسه کمی نتایج تنش برشی رینولذز با استفاده از دو روش اندازه‌گیری نشان می‌دهد که تنش برشی کف حاصل از دستگاه سرعت‌سنجه صوتی حدود 3.4 برابر دستگاه سرعت‌سنجه

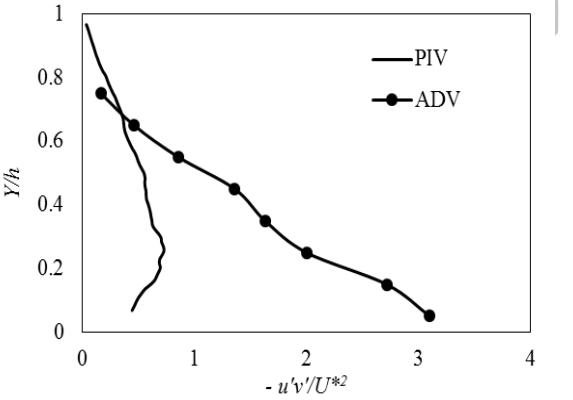


Fig.9 Comparison the results of Reynolds Shear Stress by using PIV and side looking ADV

شکل 9 مقایسه نتایج تنش برشی رینولذز جریان با استفاده از روش‌های PIV و ADV جانب‌نگر

تصویری ذرات می‌باشد. با توجه به اختلاف شدت آشفتگی طولی و قائم در دو روش سرعت‌سنجه تصویری ذرات و سرعت‌سنجه صوتی جانب‌نگر، می‌توان انتظار داشت که نتایج تنش برشی رینولذز حاصل از روش سرعت‌سنجه صوتی نیز دارای دقت کافی نباشد. افزایش اختلاف مقادیر تنش برشی رینولذز حاصل از دو روش سرعت‌سنجه تصویری ذرات و سرعت‌سنجه صوتی جانب‌نگر با نزدیک شدن به بستر و در سرعت‌های پایین با نتایج تحقیق لوهمن و همکاران سازگار است [9].

- 848-858, 2009.
- [2] E. Lobutova, C. Resagk, R. Rank, D. Müller, Extended three dimensional particle tracking velocimetry for large enclosures, In: W. Nitsche, Dobriloff C. (eds) *Imaging Measurement Methods for Flow Analysis*, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009.
 - [3] P. H. Biwole, W. Yan, Y. Zhang, J. Roux, A complete 3D particle tracking algorithm and its applications to the indoor airflow study, *Measurement Science and Technology*, Vol. 20, No. 11, pp. 1154-1156, 2009.
 - [4] S. Fu, P. H. Biwole, Ch. Mathis, Particle tracking velocimetry for indoor airflow field: A review, *Building and Environment*, Vol. 87, No. 1, pp. 34-44, 2015.
 - [5] A. Sarfrazadeh, *Experimental Study of Turbulent Flow Pattern Around a Groyne with Various Head Shapes*, PhD Thesis, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, 2011. (in Persian)
 - [6] G. Voulgaris, J. H. Trowbridge, Evaluation of the acoustic Doppler velocimeter (ADV) for turbulence measurements, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, Vol. 15, No. 1, pp. 272-289, 1998.
 - [7] D. Hurther, U. Lemmin, A correction method for turbulence measurements with a 3D acoustic Doppler velocity profiler, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, Vol. 18, No. 1, pp. 446-458, 2001.
 - [8] T. L. Wahl, Discussion of despiking acoustic Doppler velocimeter data, *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 129, No. 1, pp. 484-487, 2003.
 - [9] A. Lohrmann, R. Cabrera, G. Gelfenbaum, J. Haines, Direct measurements of reynolds stress with an acoustic doppler velocimeter, *5th Working Conference on Current Measurement*, IEEE, Piscataway, USA, 1995.
 - [10] V. Nikora, D. Goring, ADV Measurements of Turbulence: Can we improve their interpretation?, *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 124, No. 6, pp. 630-634, 1998.
 - [11] D. Goring, V. Nikora, Despiking acoustic doppler velocimeter data, *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 128, No. 1, pp. 117-126, 2002.
 - [12] M. Parsheh, F. Sotiropoulos, P. Agel, Estimation of power spectra of acoustic-doppler velocimetry data contaminated with intermittent spikes, *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 136, No. 6, pp. 368-378, 2010.
 - [13] B. Ruonan, C. Liekai, W. Xingkui, L. Danxun, Comparison of ADV and PIV measurements in open channel flows, *Procedia Engineering*, Vol. 154, No. 1, pp. 995-1001, 2016.
 - [14] P. Rusello, A. Lohrmann, E. Siegel, T. Maddux, Improvements in acoustic doppler velocimetry, *The 7th International Conference on Hydroscience and Engineering (ICHE-2006)*, Philadelphia, USA, 2006.
 - [15] M. Nabipour, S. A. A. Salehi Neyshabouri, S. H. Mohajeri, A. R. Zarrati, M. Zabetian, Study on turbulent flow in a compound channel with shallow overbank using Particle Image Velocimetry, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, No. 8, pp. 164-172, 2017. (in Persian)
 - [16] I. Nezu, Nakagawa, *Turbulence in Open-Channel Flows*, pp. 96-97, Rotterdam, Balkema, 1993.
 - [17] X. Zhang, H. Nepf, Exchange flow between open water and floating vegetation, *Environmental Fluid Mechanics*, Vol. 11, No. 5, pp. 531-546, 2011.
 - [18] M. Raffel, Ch. Willert, S. Wereley, J. Kompenhans, *Particle Image Velocimetry, A practical Guide*, pp. 170-172, New York, Springer, 2007.
 - [19] W. Thielicke, E. Stamhuis, PIVLab-Towards user-friendly, affordable and accurate digital particle image velocimetry in matlab, *Journal of Open Research Software*, Vol. 2, No. 1, pp. e30, 2014.
 - [20] A. Safarzadeh, S. A. A. Salehi Neyshabouri, A. R. Zarrati, Experimental investigation on 3D turbulent flow around straight and T-shaped groynes in a flat bed channel, *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 142, No. 8, pp. 1-15, 2016.
 - [21] U. Lemmin, T. Rolland, An acoustic velocity profiler for laboratory and field studies. *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 123, No. 12, pp. 1089-1098, 1997.
 - [22] Nortek, *Comprehensive Manual*, pp. 110-120, Rud, Norway: Nortek AS, 2015.
 - [23] S. Kara, T. Stoesser, T. W. Sturm, Turbulence statistics in compound channels with deep and shallow overbank flows, *Journal of Hydraulic Research*, Vol. 50, No. 5, pp. 482-493, 2012.
 - [24] A. Tominaga, I. Nezu, Turbulent structure in compound open-channel flows, *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 117, No. 1, pp. 21-41, 1991.

4- نتیجه گیری

دستگاه سرعت سنجی صوتی داپلر به طور گسترده در مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر به بررسی آزمایشگاهی دقیق سرعت سنج صوتی جانبنگر در جریان آشفته می پردازد. در این تحقیق میدان جریان در محدوده حجم نمونه گیری با استفاده از دستگاه سرعت سنجی تصویری ذرات و سرعت سنجی صوتی جانبنگر اندازه گیری شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر عبارتند از:

- حضور فیزیکی سرعت سنج صوتی داپلر جانبنگر در میدان جریان اثر تداخلی داشته که این اثر در اندازه گیری سرعت های ثانویه شدیدتر از سرعت طولی جریان می باشد.
- دستگاه سرعت سنج صوتی در اندازه گیری سرعت طولی، دارای دقیق مناسب بوده و سرعت طولی حاصل از دستگاه سرعت سنج صوتی به طور متوسط حدود 5 درصد بیشتر از مقادیر سرعت طولی حاصل از سرعت سنج تصویری ذرات می باشد.
- علی رغم دقیق مناسب دستگاه سرعت سنج صوتی در اندازه گیری سرعت طولی، این دستگاه در اندازه گیری سرعت های قائم و عرضی دارای خطای قابل توجهی می باشد.
- خطای دستگاه سرعت سنج صوتی جانبنگر در اندازه گیری سرعت قائم بسیار بیشتر از سرعت عرضی است. که دلیل این امر هندسه شاخک های سرعت سنج صوتی جانبنگر می باشد.
- علی رغم دقیق بودن در اندازه گیری سرعت طولی با استفاده از سرعت سنج صوتی، مقادیر شدت آشفتگی طولی این ابزار تفاوت قابل ملاحظه ای با نتایج سرعت سنج تصویری ذرات دارد.
- مقادیر شدت آشفتگی طولی و قائم حاصل از سرعت سنجی صوتی جانبنگر همواره بزرگتر از مقادیر سرعت سنجی تصویری ذرات می باشد و با نزدیک شدن به بستر افزایش می یابد.
- شدت آشفتگی عرضی حاصل از دو روش سرعت سنجی صوتی جانبنگر و سرعت سنجی تصویری ذرات تغییرات بسیار ناچیزی دارد و لذا سرعت سنجی صوتی جانبنگر شدت آشفتگی عرضی را به خوبی اندازه گیری می کند، اما نتایج شدت آشفتگی قائم حاصل از سرعت سنجی صوتی جانبنگر قابل اعتماد نیست.
- مقادیر تنش برشی رینولدز حاصل از سرعت سنج صوتی جانبنگر در اکثر نقاط بزرگتر از مقادیر حاصل از روش سرعت سنج تصویری ذرات بوده و در نزدیکی بستر حدود 3.4 برابر مقدار حاصل از روش سرعت سنجی تصویری ذرات است.

5- مراجع

- [1] Q. Chen, Ventilation performance prediction for buildings: A method overview and recent applications, *Building Environment*, Vol. 44, No. 4, pp.