

## بررسی اثر ماده آلی خاک روی کالیبراسیون TDR برای اندازه‌گیری رطوبت

مریم مزیدی<sup>۱\*</sup> و عیسی معروف‌پور

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان، Maryam.Mazidi@gmail.com

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان، isamarofpoor@yahoo.om

### چکیده

روش‌های مختلفی برای تخمین رطوبت خاک وجود دارد. روش TDR (Time domain Reflectometry) روشی نسبتاً جدید است که در آن بر اساس سرعت حرکت امواج الکترومغناطیسی، میزان رطوبت حجمی خاک تخمین زده می‌شود. تأثیر ترکیبات خاک روی منحنی دستگاه، منجر به کالیبراسیون مجدد دستگاه می‌شود. هدف از این تحقیق ارائه معادله کالیبراسیون برای خاک‌های حاوی ماده آلی می‌باشد. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی در سه نوع خاک با بافت سبک، متوسط و سنگین و در پنج تیمار شامل درصدهای مختلف ماده آلی (کود لاشبرگ) و در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که برای هر سه بافت، رطوبت اندازه‌گیری شده در پنجره ۱۰ نانوثانیه از دقت بالاتری برخوردار بود. همچنین TDR در رطوبت‌های پایین، مقدار رطوبت را بیشتر از روش وزنی تخمین می‌زد. این میزان تفاوت با افزایش درصد رس و ماده آلی افزایش می‌یافت. با افزایش درصد ماده آلی مقادیر RMSE نیز افزایش یافت که نشان دهنده تأثیر ماده آلی خاک روی دقت دستگاه TDR بود. بین مقادیر رطوبتی مشاهده شده به روش‌های وزنی و TDR، در درصدهای مختلف ماده آلی و در سطح احتمال ۵ درصد، تفاوت معنی‌داری وجود داشت. در نهایت برای هر بافت معادله کالیبراسیون با ضرایب رگرسیون بالا به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: انعکاس‌سنجی حوزه زمانی، رطوبت حجمی

### مقدمه

زمانی است که طول می‌کشد تا یک پالس الکترومغناطیسی از یک موج بر یا حسگر که در زمین وارد شده است عبور نماید. سرعت انتشار پالس با مقدار ثابت دی‌الکتریک خاک که تابعی از رطوبت است، نسبت عکس دارد. در روش TDR، دستگاه ثابت دی‌الکتریک خاک را اندازه گرفته و با استفاده از رابطه تعریف شده در حافظه خود (رابطه بین ثابت دی‌الکتریک و رطوبت حجمی)، آن را به رطوبت حجمی تبدیل

روش انعکاس‌سنجی حوزه زمانی برای تخمین رطوبت خاک، روشی نسبتاً جدید است. این روش اولین بار برای اندازه‌گیری رطوبت خاک توسط تاپ و همکاران (۱۹۸۰) گزارش شده است. از مزیت‌های آن می‌توان به دقت بالا، عدم نیاز به فرآیند کالیبراسیون برای اندازه‌گیری رطوبت در بعضی خاک‌ها (غیر از خاک‌های سنگین بافت، شور و دارای مواد آلی) و تکرارپذیری اشاره کرد. اصول کار دستگاه مبتنی بر اندازه‌گیری مدت

<sup>۱</sup> نویسنده مسئول، آدرس: تهران، ابتدای سهرودی شمالی، کوچه مهاجر، شرکت مهندسین مشاور آب‌فن، واحد شبکه‌های آبیاری و زهکشی

\* دریافت: شهریور ۱۳۹۱ و پذیرش: آبان ۱۳۹۲

نخورده استفاده شد. هدف از این تحقیق تعیین سهم چگالی ظاهری برای توابعی است که ثابت دی‌الکتریک را به رطوبت حجمی برای انواع مختلف پیت با درصد‌های مختلف ماده آلی ارتباط می‌دهد. آنها نشان دادند که چگالی ظاهری به طور اساسی بر رابطه بین ثابت دی‌الکتریک و رطوبت حجمی در خاک‌های پیت تأثیر دارد.

اسچاپ و همکاران (۱۹۹۶) TDR را در خاک‌های مناطق جنگلی کالیبره نمودند. آنها در این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی بین رطوبت و شاخص انکساری، مشاهده نمودند که انقباض مواد آلی به طور معنی‌داری روی رطوبت حجمی و زمان‌های انعکاس یافته توسط TDR تأثیر دارد. پرسون و برندتسون (۱۹۹۸) با بررسی اثر دما و بافت خاک روی کالیبراسیون TDR، در سه خاک رسی، آلی و شنی نتیجه گرفتند که در خاک‌هایی با سطح ویژه زیاد (خاک رس و خاک‌های آلی)، اگرچه اثر دما روی کالیبراسیون TDR حداقل است، اما زیاد بودن سطح ویژه و هدایت الکتریکی محلول خاک باعث ایجاد یک فاکتور مثبت و در نتیجه تخمین بیش از مقدار واقعی رطوبت می‌شود. سلطانی محمدی (۱۳۸۴) تأثیر بافت خاک را روی کالیبراسیون TDR در شرایط خاک‌های استان خوزستان بررسی کرد. همچنین معروف‌پور و همکاران (۲۰۰۹) نیز تأثیر بافت خاک را در شرایط خاک‌های استان کردستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داد که با افزایش مقدار رس و سنگین‌تر شدن بافت خاک دقت دستگاه در برآورد رطوبت حجمی خاک کاهش می‌یابد و لازم است معادله جهانی آن کالیبره شود.

### مواد و روش‌ها

این تحقیق در سه خاک با بافت سبک، متوسط و سنگین (لوم شنی، لوم و لومی شنی رسی) و در پنج تیمار با درصد‌های ۰/۵، ۲، ۳/۵، ۵ و ۶/۵ از ماده آلی شامل کود لاشبرگ و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. دستگاه TDR مورد استفاده با مارک TRASE مدل

می‌کند. رابطه تعریف شده به دستگاه برای تبدیل ثابت دی‌الکتریک به رطوبت حجمی نیاز به واسنجی دارد و متأسفانه تاکنون یک رابطه جامع و کامل که تأثیر همزمان تمامی پارامترهای مؤثر روی ثابت دی‌الکتریک را در نظر بگیرد ارائه نشده است. به استناد مطالعات به عمل آمده، در نقاط مختلف جهان برای کامل کردن این رابطه، تحقیقات فراوانی در حال انجام است که اصطلاحاً تحت عنوان "کالیبراسیون TDR نام گرفته است.

کالیبراسیون خاک‌های آلی از رابطه جهانی تاپ و همکاران (۱۹۸۰) به دست نمی‌آید. در این میان چگالی ظاهری خاک به طور اساسی بر رابطه بین ثابت دی‌الکتریک و رطوبت حجمی تأثیر دارد. چگالی ظاهری پارامتری فیزیکی است که رطوبت حجمی خاک‌های دارای ماده آلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به دلیل تأثیر قابل توجه در کاهش چگالی ظاهری و سطح ویژه، این رابطه در خاک‌های آلی نسبت به خاک‌های معدنی متفاوت است (اولسزوک و همکاران، ۲۰۰۴).

پومپیانن و الوسنینی (۲۰۰۵) اساس اندازه‌گیری‌های TDR را ثابت دی‌الکتریک ظاهری خاک دانستند که با رطوبت حجمی خاک تغییر می‌کند. در این تحقیق آنها کالیبراسیون‌هایی را برای لایه‌های هوموس دست‌نخورده و همگن ارائه دادند و سه مدل کالیبراسیون را با هم مقایسه کردند. در نهایت تأثیر تغییر در حجم چگالی ظاهری و حجم نمونه را بررسی کردند. در رطوبت‌های حجمی بالا، مقدار  $k_a$  برای نمونه هوموس دست‌نخورده بیشتر از نمونه‌های همگن در همان رطوبت حجمی بود. این به دلیل تفاوت در فضای خالی بین دو نمونه یا به عبارتی تخلخل می‌باشد. در مجموع حجم نمونه‌های دست‌نخورده اندازه گرفته شده در رطوبت اشباع، یکسان فرض شد که در همه نمونه‌ها یکسان بود. اگرچه انقباض قابل توجهی با کاهش مقدار آب مشاهده شده بود.

اولسزوک و همکاران (۲۰۰۴) معادلات کالیبراسیونی را برای انواع پیت در دره Biebrza واقع در هلند انجام دادند. در این تحقیق از نمونه‌های دست

TDR و  $\overline{\theta_V}$  میانگین رطوبت حجمی اندازه گرفته شده است.

### نتایج و بحث

تعیین دقت TDR در پنجره های اندازه گیری ۱۰، ۲۰ و ۴۰ نانوثانیه

نتایج این تحقیق برای سه بافت با درصد های مختلف ماده آلی نشان داد که در هر سه بافت پنجره ۱۰ نانوثانیه از دقت بالایی برخوردار است. پنجره ۴۰ نانوثانیه در کلیه بافت ها از دقت کمی برخوردار بود. در کاتالوگ دستگاه، استفاده از پنجره ۱۰ نانوثانیه برای پروب های دفنی ( طول میله موج بر ۲۰ سانتی متر) توصیه شده است که با نتایج این تحقیق نیز هماهنگی دارد. در پنجره ۴۰ نانوثانیه، رطوبت کمتر از ۲۰ درصد در کلیه بافت ها قابل اندازه گیری نبود. عدم امکان اندازه گیری رطوبت و یا تفاوت زیاد بین مقادیر رطوبت روش TDR و روش وزنی در پنجره ۴۰ نانوثانیه می تواند به دلیل عدم توانایی نرم افزار دستگاه در تعیین نقطه انتهایی حرکت پالس در موج بر باشد. فشرده شدن خاک در حین نصب پروب که افزایش دانسیته خاک را به دنبال دارد و خشک بودن خاک از جمله عواملی هستند که روی نرم افزار دستگاه برای تعیین نقطه بازتاب تأثیر می گذارند، که در این شرایط استفاده از پنجره با عرض بیشتر توصیه می شود. سلطانی محمدی (۱۳۸۵) در تحقیق خود نتیجه گرفت که بهترین پنجره برداشت در بافت های لوم رسی و رس سیلتی پنجره ۲۰ نانوثانیه و برای بافت های شن ریز، شن لومی، لوم شنی و لوم سیلتی، پنجره ۱۰ نانوثانیه است. همچنین کمالی و مهدیان (۱۳۸۴) نتیجه گرفتند که بهترین پنجره ۱۰ نانوثانیه است.

مقایسه رطوبت حجمی اندازه گیری شده به روش وزنی و

### دستگاه TDR

برای مقایسه رطوبت حجمی اندازه گیری شده با استفاده از TDR و روش وزنی در درصد های مختلف ماده آلی در سه بافت مورد نظر، از میانگین مقادیر رطوبتی استفاده شد. بدین ترتیب که از مقادیر رطوبتی اندازه گیری

6050X1 و ساخت شرکت Soil Moisture می باشد. به منظور ایجاد تیمارهای مختلف خاک با درصد های مختلف ماده آلی، بعد از تعیین درصد ماده آلی (کود لاشبرگ) به روش آزمایشگاهی، به نسبت های وزنی در هر بافت، کود لاشبرگ به دپوی خاک با تیمار مشخص از ماده آلی اضافه شد. اندازه گیری رطوبت حجمی خاک به وسیله دستگاه TDR در هر سه پنجره ۱۰، ۲۰ و ۴۰ نانوثانیه انجام شد. همچنین برای اندازه گیری رطوبت وزنی نمونه ها در هر روز، گلدان ها و تغییرات میزان آب خاک گلدان ها، اندازه گرفته شد. اندازه گیری رطوبت حجمی خاک با این دو روش تا زمانی انجام شد که رطوبت وزنی اندازه گرفته شده تقریباً به یک مقدار ثابت رسیده باشد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای SAS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضمن تعیین معنی دار بودن اختلاف بین دو روش TDR و روش وزنی و جهت مقایسه بین این دو روش از آزمون T-test استفاده شد. برای مقایسه بین تیمارها در هر بافت و معنی دار بودن اختلاف بین تیمارها در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. همچنین تجزیه واریانس از طریق آزمون ANOVA به منظور مقایسه بین بافت ها در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی صورت گرفت. آزمون دانکن نیز به منظور تعیین همگن بودن اختلاف بین تیمارها انجام شد. جهت تعیین میزان خطا از پارامترهای آماری ریشه متوسط مربعات خطا (RMSE) و خطای نسبی (RE) استفاده شد. این پارامترها به صورت زیر تعریف می شوند:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n di^2}{n}} \quad (1)$$

$$RE = \frac{\sum_{i=1}^n |\theta_V - \theta_{VP}| / n}{\overline{\theta_V}} \times 100 \quad (2)$$

که در آن di: تفاوت بین رطوبت حجمی اندازه گرفته شده به روش وزنی و روش TDR، n تعداد نمونه ها،  $\theta_V$  و  $\theta_{TDR}$  رطوبت حجمی اندازه گرفته شده به روش وزنی و

تقریباً نامنظم می‌باشد. اولسزوک و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقاتی که بر روی انواع پیت انجام دادند نشان دادند که در درصدهای بالای ماده آلی از انواع پیت، دستگاه TDR، رطوبت را کمتر از مقدار واقعی تخمین می‌زند که این نتیجه بیشتر در درصدهای بالای رطوبت مشاهده شده است. با توجه به اینکه در کاتالوگ دستگاه، مقدار خطا  $\pm 2\%$  ذکر شده است، بنابراین به دلیل زیاد بودن تفاوت بین مقادیر اندازه‌گیری شده (بیش از ۲ درصد) و همچنین بالا بودن مقادیر RMSE و خطای استاندارد، معادلات کالیبراسیونی برای تعیین دقیق رطوبت لازم است (جدول ۲). با برازش خطوط رگرسیونی برای همه بافت‌ها در درصدهای مختلف ماده آلی، معادلات کالیبراسیونی با ضریب همبستگی ۰/۸۹ تا ۰/۹۶ در بافت سبک، ۰/۸۲ تا ۰/۹۷ در بافت متوسط و ۰/۸۷ تا ۰/۹۳ در بافت سنگین به دست آمد. که این نشان دهنده همبستگی بالا بین مقادیر رطوبتی TDR و روش وزنی است. از آنالیز واریانس (در نرم‌افزار SAS) در سطح ۵ درصد برای کلیه تیمارها مشخص شد که بین واریانس و میانگین تیمارهای مختلف در هر سه بافت، تفاوت معنی‌داری وجود دارد ( $p < 0/05$ ). و با افزایش ماده آلی در هر سه بافت خطای استاندارد رو به افزایش است. با استفاده از مقایسه آماری میانگین تیمارها به روش دانکن، زیر گروه‌های همگن و متفاوت از هم تعیین گردیدند. نتایج آزمون دانکن به منظور مقایسه بین میانگین‌ها در جدول ۳ آورده شده است. به منظور اطمینان از نرمال بودن مانده‌ها، تست Shapiro-Wilk به کار گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه بین میانگین‌ها، نشان‌دهنده تفاوت بودن مقادیر رطوبتی تیمارهای مختلف (درصدهای مختلف ماده آلی) در سطح ۵ درصد ( $p < 0/05$ ) می‌باشد. با افزایش ماده آلی مقدار خطای استاندارد با افزایش روبرو بوده است. همچنین نتایج آزمون Shapiro-Wilk جهت اطمینان از نرمال بودن مانده‌ها نشان داد که در کلیه بافت‌ها داده‌ها از توزیع نرمال تبعیت می‌کنند. پیرسون و برنندتسون (۱۹۹۸) هم با بررسی اثر بافت خاک روی کالیبراسیون TDR در سه خاک رسی، آلی و شنی نتیجه

شده در سه تکرار میانگین گرفته شده و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با آزمون T-test در سطح احتمال ۵ درصد، تجزیه و تحلیل آنها انجام گردید. هدف از انجام این آزمون تعیین معنی‌دار بودن اختلاف بین مقادیر اندازه‌گیری شده با دستگاه و روش وزنی است. در جدول ۱ نتایج مقایسه بین پنجره‌های اندازه‌گیری آورده شده است. نتایج نشان داد که در بافت سبک و متوسط به غیر از تیمار ۰/۵ درصد ماده آلی و در بافت سنگین در تمامی تیمارها بین رطوبت حجمی اندازه‌گیری شده به روش وزنی با TDR اختلاف معنی‌دار وجود دارد.

### مقایسه رطوبت حجمی به روش وزنی و دستگاه TDR در تیمارهای مختلف در هر بافت

در شکل‌های ۱ الی ۳ مقادیر رطوبت حجمی اندازه‌گیری شده به روش وزنی و دستگاه TDR برای هر سه بافت نشان داده شده است. همانگونه که از روی شکل‌های مذکور ملاحظه می‌شود دستگاه TDR در محدوده رطوبتی اندازه‌گیری شده (۰/۱ تا ۰/۳ حجمی)، در تیمارهای ۳/۵، ۵، ۶/۵ درصد ماده آلی، رطوبت را کمتر از روش وزنی تخمین می‌زند که اختلاف بین این مقادیر بیشتر از ۲ درصد می‌باشد. در تیمار ۲ درصد رطوبت اندازه‌گیری شده به وسیله دستگاه در حدود ۲ درصد بیشتر از روش وزنی می‌باشد. در تیمار ۰/۵ درصد ماده آلی در رطوبت‌های متوسط (۱۵ تا ۲۲ درصد) میزان رطوبت اندازه‌گیری شده توسط دستگاه، تقریباً مطابق روش وزنی می‌باشد و در رطوبت‌های بالاتر یا کمتر، دستگاه TDR رطوبت را کمتر از روش وزنی تخمین می‌زند و تفاوت بین آنها به طور متوسط بیشتر از ۲ درصد می‌باشد. در بافت‌های متوسط و سنگین (شکل‌های ۲ و ۳) دستگاه TDR در محدوده رطوبتی اندازه‌گیری شده در کلیه تیمارها رطوبت را بیشتر از روش وزنی تخمین می‌زند که اختلاف بین این مقادیر بیشتر از ۲ درصد می‌باشد. همچنین در تمامی تیمارهای هر دو بافت در رطوبت‌های بیشتر از ۰/۳ حجمی، دستگاه TDR رطوبت را کمتر از روش وزنی تخمین می‌زند و روند آن نیز

(۰/۹۴۸) و در خاک لوم سیلتی (۰/۹۸۲) به دست آورده‌اند. چندلر و همکاران (۲۰۰۴) همبستگی بالایی بین رطوبت حجمی خاک و مقدار تعیین شده با دستگاه TDR مشاهده کردند و گزارش کرده‌اند که منحنی کالیبراسیون دستگاه با نوع خاک تغییر می‌کند.

علی‌رغم همبستگی بالا بین رطوبت TDR و رطوبت روش وزنی، از بررسی خطای استاندارد و انحراف معیار محاسبه شده، وجود اختلاف بین داده‌های رطوبتی حاصله از دو روش مشهود است. در بحث عوامل مؤثر بر کاهش دقت دستگاه در تعیین رطوبت می‌توان به دو عامل میزان رس خاک و نوع رس و میزان مواد آلی خاک اشاره کرد. با افزایش رس و مواد آلی در بافت‌ها، میزان دقت دستگاه با کاهش چشمگیری همراه بوده است. تأثیر رس بر کالیبراسیون دستگاه به علت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این کانی به ویژه سطح مخصوص ویژه آن می‌باشد. خاک‌های مختلف سطوح ویژه مختلفی دارند که نتیجه اختلاف در نوع کانی رس، بافت خاک، میزان رس، نوع رس و میزان ماده آلی آن می‌باشد. بعضی از خصوصیات مهم خاک‌ها مثل ظرفیت نگهداری و ظرفیت تبادل کاتیونی، با سطح ویژه خاک‌ها مرتبط هستند (هرکلراس و همکاران، ۱۹۹۱).

با برازش مقادیر ثابت دی‌الکتریک اندازه‌گیری شده در مقابل مقادیر رطوبت اندازه‌گیری شده توسط دستگاه TDR با درصد‌های مختلف ماده آلی، معادله خط رگرسیونی برای این مقادیر به دست آمد که معادله چند جمله‌ای درجه سه کمترین میزان خطا و بیشترین همبستگی را داشته است. با توجه به مقالات بررسی شده بهترین رابطه‌ای که تاکنون تطابق بهتری با داده‌های به دست آمده با روش وزنی داشته، یک رابطه چندجمله‌ای درجه سه می‌باشد. همچنین برای هر بافت با برازش دادن کلیه داده‌ها می‌توان یک معادله کلی را ارائه داد. برای نمایش میزان همبستگی رطوبت TDR با ثابت دی‌الکتریک ارائه شده توسط دستگاه، در رابطه داده شده از  $\theta_{TDR}$  استفاده شد. جدول ۶ معادله خطوط برازش یافته

گرفتند که در خاک‌هایی با سطح ویژه زیاد یعنی رس و خاک‌های آلی، زیاد بودن سطح ویژه و هدایت الکتریکی محلول خاک با هم، باعث ایجاد فاکتور مثبت و در نتیجه تخمین رطوبت، بیشتر از مقدار واقعی می‌شود.


### مقایسه رطوبت حجمی به روش وزنی و دستگاه TDR در هر سه بافت نسبت به هم

از آنالیز واریانس (در نرم‌افزار SAS) در سطح ۵ درصد برای کلیه تیمارها مشخص شد که بین واریانس و میانگین تیمارهای مختلف در هر سه بافت تفاوت معنی‌داری وجود دارد ( $p < 0/05$ ) و با افزایش رس خطای استاندارد رو به افزایش است که نتایج آن در جدول ۴ آورده شده است. معادلات برازش یافته در جدول ۵ آورده شده است. به منظور اطمینان از نرمال بودن مانده‌ها، تست Shapiro-Wilk به کار گرفته شد. در کلیه بافت‌ها و در درصد‌های مختلف ماده آلی، تفاوت بین مقادیر اندازه‌گیری شده به روش وزنی و TDR از دو درصد بیشتر است. با برازش خطوط رگرسیونی برای تمامی بافت‌ها در محدوده اندازه‌گیری، معادلات کالیبراسیونی با ضرایب همبستگی در محدوده‌های ۰/۸۰ تا ۰/۸۹ به دست آمد. نتایج، همبستگی نسبتاً بالایی را بین داده‌های رطوبتی TDR و روش وزنی نشان می‌دهد که این میزان همبستگی با افزایش ماده آلی و میزان رس کاهش یافته است. در تحقیقی که یرمی و همکاران (۱۳۸۷) در زمینه تخمین رطوبت خاک توسط دستگاه TDR و اثر بافت خاک روی کالیبراسیون دستگاه انجام دادند، یک سری معادلات کالیبراسیونی را برای تخمین رطوبت خاک بر اساس رطوبت قرائت شده از دستگاه TDR و رطوبت حجمی به دست آمده از روش وزنی در سه نوع بافت ارائه دادند که نشان داد با افزایش درصد رس ضرایب همبستگی کاهش یافته است و متناسب با آن با سنگین‌تر شدن بافت خاک، جذر متوسط مربع خطا نیز افزایش یافته است. داسبرگ و دالتون (۱۹۸۵)، نادلر و همکاران (۱۹۹۱) هم در تحقیق خود همبستگی بالایی بین داده‌های وزنی و TDR را در بافت شنی و لومی شنی


صورت خطوط برازش یافته در جدول ۶ می‌باشند. اما با توجه به اینکه میزان خطای دستگاه در برآورد رطوبت حجمی، بیشتر از خطایی است که در کاتالوگ دستگاه ذکر شده است، لازم است رطوبت حجمی که توسط دستگاه ارائه می‌شود، به صورت معادلات پیشنهادی در جدول ۲ کالیبره شوند.

و ضرایب رگرسیونی را برای بافت‌های مختلف نشان می‌دهد. این معادلات، به صورت  $= A \times \varepsilon^3 + B \times \varepsilon^2 + C \times \varepsilon + D$  برای هر بافت در درصدهای مختلف ماده آلی ارائه شده است. از رابطه بین ثابت دی‌الکتریک و رطوبت حجمی اندازه‌گیری شده به وسیله دستگاه ضرایب رگرسیون بالایی به دست آمده است. رابطه بین ثابت دی‌الکتریک و رطوبت حجمی در شرایط حاضر به


Archive of SID

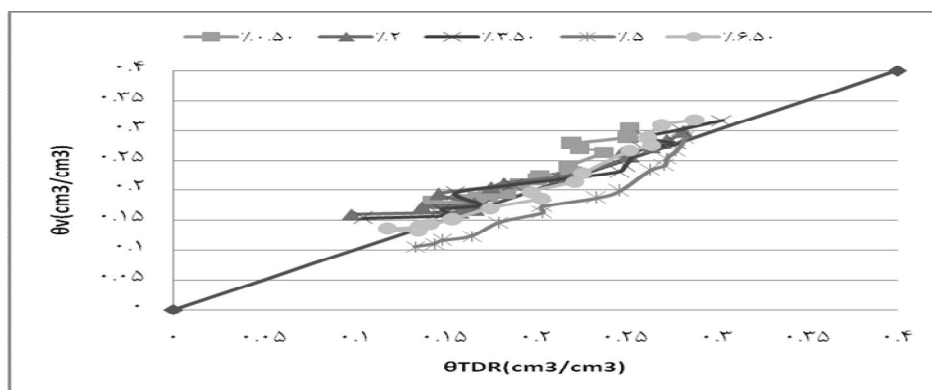

شکل ۱. مقایسه رطوبت حجمی اندازه‌گیری شده به روش وزنی  $\theta_v$  و دستگاه TDR  $\theta_{TDR}$  در بافت سبک

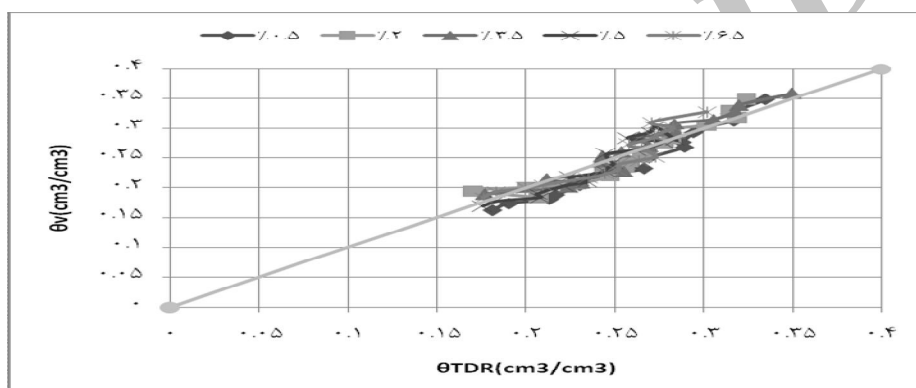

شکل ۲. مقایسه رطوبت حجمی اندازه‌گیری شده به روش وزنی  $\theta_v$  و دستگاه TDR  $\theta_{TDR}$  در بافت متوسط

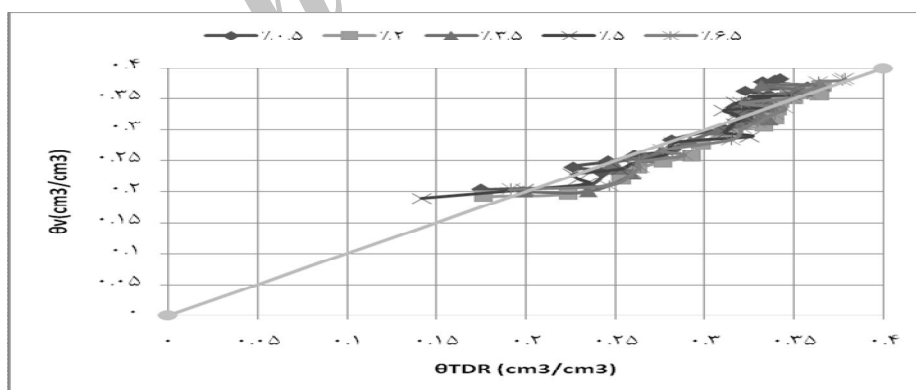

شکل ۳. مقایسه رطوبت حجمی اندازه‌گیری شده به روش وزنی  $\theta_v$  و دستگاه TDR  $\theta_{TDR}$  در بافت سنگین

جدول ۱. مقادیر RMSE و RE پنجره‌های اندازه‌گیری در درصدهای مختلف ماده آلی در سه بافت

پنجره اندازه‌گیری						درصد ماده آلی	بافت خاک
۴۰		۲۰		۱۰			
RE	RMSE	RE	RMSE	RE	RMSE		
۳۰/۰۷	۰/۰۷۵	۶/۲۱۳	۰/۰۱۷	۴/۸۹۸	۰/۰۱۵	۰/۵	سیک (لوم شنی)
۳۲/۴۰۹	۰/۰۷۵	۱۹/۸۰۱	۰/۰۳۷	۵/۳۳۴	۰/۰۱۶	۲	
۴۸/۴۷	۰/۰۶۲	۷/۹۱۵	۰/۰۲۱	۵/۹۹۵	۰/۰۱۶	۳/۵	
۵۰/۷۵۴	۰/۱۱۱	۹/۶۶۴	۰/۰۳۲	۶/۲۱۵	۰/۰۱۸	۵	
۵۸/۴۹۷	۰/۱۱۲	۲۴/۹۲۲	۰/۰۶۸	۶/۹۹۱	۰/۰۱۹	۶/۵	
۱۹/۶۴۷	۰/۱۳۶	۸/۵۲۹	۰/۰۲۴	۵/۳۳	۰/۰۱۹	۰/۵	متوسط (لوم)
۲۷/۲۱۴	۰/۰۵۶	۷/۵۲۱	۰/۰۱۹	۴/۸۳	۰/۰۱۷	۲	
۳۲/۶۶	۰/۰۷۳	۶/۲۰۷	۰/۰۱۹	۴/۸۸۸	۰/۰۱۸	۳/۵	
۳۸/۸۸۳	۰/۱۰۳	۸/۰۹۵	۰/۰۲۱	۵/۸۹۸	۰/۰۲۰	۵	
۳۷/۵	۰/۰۹۲	۷/۸۵۱	۰/۰۲۴	۶/۷۷۴	۰/۰۲۲	۶/۵	
۳۷/۵	۰/۰۹۲	۷/۸۵۱	۰/۰۲۴	۶/۷۷۴	۰/۰۲۲	۰/۵	سنگین (لوم رسی شنی)
۱۱/۸۹۷	۰/۰۹۴	۷/۳۴۴	۰/۰۱۹	۵/۷۸	۰/۰۲۲	۲	
۱۰/۶۹۷	۰/۰۴۸	۹/۴۸۲	۰/۰۲۴	۶/۱۱۴	۰/۰۱۹	۳/۵	
۱۳/۲۰۶	۰/۰۳۳	۱۴/۸۵۶	۰/۰۳۰	۶/۸۰۱	۰/۰۲۶	۵	
۱۲/۷۸۳	۰/۰۴۵	۱۷/۶	۰/۰۳۳	۵/۶۳۴	۰/۰۲۱	۶/۵	

جدول ۲. معادلات و ضرایب رگرسیونی خطوط برازش یافته در درصدهای مختلف ماده آلی برای سه بافت

ضریب همبستگی	معادله خط	درصد ماده آلی	بافت خاک
۰/۹۶	$\theta_V = 1.141 \theta_{TDR} - 0.021$	۰/۵	سیک (لوم شنی)
۰/۹۶	$\theta_V = 1.113 \theta_{TDR} - 0.055$	۲	
۰/۹۲	$\theta_V = 0.873 \theta_{TDR} + 0.04$	۳/۵	
۰/۹۱	$\theta_V = 0.796 \theta_{TDR} + 0.059$	۵	
۰/۸۹	$\theta_V = 1.121 \theta_{TDR} + 0.015$	۶/۵	
۰/۹۷	$\theta_V = 1.224 \theta_{TDR} - 0.072$	۰/۵	متوسط (لوم)
۰/۹۰	$\theta_V = 1.108 \theta_{TDR} - 0.032$	۲	
۰/۹۲	$\theta_V = 1.131 \theta_{TDR} - 0.031$	۳/۵	
۰/۸۸	$\theta_V = 1.273 \theta_{TDR} - 0.068$	۵	
۰/۸۲	$\theta_V = 1.108 \theta_{TDR} - 0.025$	۶/۵	
۰/۸۸	$\theta_V = 1.124 \theta_{TDR} - 0.027$	۰/۵	سنگین (لوم رسی شنی)
۰/۹۲	$\theta_V = 1.102 \theta_{TDR} - 0.043$	۲	
۰/۹۲	$\theta_V = 1.212 \theta_{TDR} - 0.065$	۳/۵	
۰/۸۷	$\theta_V = 0.95 \theta_{TDR} - 0.014$	۵	
۰/۹۳	$\theta_V = 1.129 \theta_{TDR} - 0.049$	۶/۵	

جدول ۳. نتایج آزمون دانکن جهت مقایسه بین میانگین‌ها در بافت‌های سبک، متوسط و سنگین

بافت سنگین		بافت متوسط		بافت سبک		درصد ماده آلی
RE	RMSE	RE	RMSE	RE	RMSE	
۴/۸۵۱a	۰/۰۱۷۶a	۵/۸۴۲a	۰/۰۱۷۹a	۵/۹۳۷۳a	۰/۰۱۶a	۰/۵
۵/۷۳۵b	۰/۰۲۴۱ab	۶/۶۵۴۹ab	۰/۰۱۹۴a	۷/۷۹۷۶b	۰/۰۲۷۳a	۲
۶/۳۹۷b	۰/۰۲۳۱ab	۷/۵۴۰۲bc	۰/۰۲۴۹ab	۸/۴۱۲۶b	۰/۰۲۴ab	۳/۵
۷/۳۹۳c	۰/۰۲۵b	۸/۲۷۱c	۰/۰۲۴۶ab	۱۱/۲۴۰۲c	۰/۰۳۱۴b	۵
۸/۵۸۰۵d	۰/۰۳۱۷c	۱۰/۱۰۰۱d	۰/۰۲۹۵b	۱۴/۶۴۹۷d	۰/۰۴۷c	۶/۵

تیمارهایی که در یک ستون دارای حروف مشترک می‌باشند، اختلاف معنی‌داری ندارند. ( $\alpha = 0.05$ )

جدول ۴. مقادیر خطای استاندارد در سه بافت سبک، متوسط و سنگین

خطای استاندارد		بافت خاک
RE	RMSE	
۰/۲۰۸۷۷۹	۰/۰۰۳۱۳	سیک
۰/۲۲۰۲۳	۰/۰۰۷۴	متوسط
۰/۳۶۲۰۶	۰/۰۰۰۷۹	سنگین



**جدول ۵. معادله خط برازش یافته در سه بافت سبک، متوسط و سنگین**

بافت خاک	معادله خط	ضریب همبستگی
سبک	$\theta_v = 0.971 \theta_{TDR} + 0.012$	۰/۸۹
متوسط	$\theta_v = 0.149 \theta_{TDR} - 0.041$	۰/۸۴
سنگین	$\theta_v = 1.070 \theta_{TDR} + 0.023$	۰/۸۰

**جدول ۶. معادله و ضرایب رگرسیونی خطوط برازش یافته بر منحنی رطوبت TDR و ثابت دی الکتریک**

A	B	C	D	ضریب همبستگی	درصد ماده آلی	بافت خاک
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۵	۰/۰۳۳	۰/۱۶۸	۰/۹۹۲	۰/۵	سبک (لوم شنی)
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۹	۰/۰۲۸	۰/۰۶۶	۰/۹۹۹	۲	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۹	۰/۰۱۸	۰/۰۱۳	۰/۹۷۶	۳/۵	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۴	۰/۰۱۸	۰/۱۱۰	۰/۹۹۸	۵	
۰/۰۰۰	-۰/۰۱۸	۰/۰۱۷	۰/۶۳۹	۰/۹۸۳	۶/۵	
۰/۰۰۰۰۹	-۰/۰۰۲	۰/۰۰۶	۰/۰۷۶	۰/۹۹۷	هر بافت	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۴	۰/۰۸۳	۰/۰۲۸	۰/۹۸۹	۰/۵	متوسط (لوم)
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۶	۰/۱۰۸	۰/۳۹۷	۰/۹۸۹	۲	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۳	۰/۰۶۷	۰/۲۱۲	۰/۹۸۵	۳/۵	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۳	۰/۰۶۵	۰/۲۰۷	۰/۹۸۹	۵	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۲	۰/۰۶۳	۰/۱۹۶	۰/۹۸۹	۶/۵	
۰/۰۰۰۰۵	-۰/۰۰۴	۰/۰۷۷	۰/۰۲۵۴	۰/۹۸۷	هر بافت	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۹	۰/۰۱۶	۰/۰۱۴	۰/۹۶۱	۰/۵	سنگین (لوم رسی شنی)
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۲	۰/۰۵۲	۰/۰۱۴	۰/۹۶۸	۲	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۲	۰/۰۴۹	۰/۰۱۳	۰/۹۶۹	۳/۵	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۲	۰/۰۵۴	۰/۰۱۶	۰/۹۷۴	۵	
۰/۰۰۰	-۰/۰۰۱	۰/۰۴۰	۰/۰۸۳	۰/۹۶۸	۶/۵	
۰/۰۰۰۰۳	-۰/۰۰۱	۰/۰۴۸	۰/۱۲۵	۰/۹۸۴	هر بافت	

## فهرست منابع

۱. سلطانی محمدی ا. ۱۳۸۴. تاثیر بافت خاک روی کالیبراسیون TDR برای اندازه‌گیری رطوبت در شرایط خاک‌های خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی علوم آب. گروه آبیاری و زهکشی. ۱۹۲ ص.
2. Dasberg, S and F. N. Dalton . 1985. Time Domain Reflectometry Field Measurements of Soil Water Content and Electrical Conductivity. Soil Science Society American Journal. 49:293-297.
3. Chandler, D.G. Sayfried, M. Murdock, M., and J.P. Mcnamara, 2004. Field Calibration of Water Content Reflectometers. Soil Science Society American Journal. 68: 1501-1507.
4. Herkelrath, W.N. Hamburg, S.P., and F. Murphy. 1991. Automatic, real-time monitoring of soil moisture in a remote field area with time domain reflectometry. Water Resource Research Journal. 27: 857-864.
5. Jacobsen, O.H., and P. Schjonning. 1993. A laboratory calibration of time domain reflectometry for soil water measurement including effects of bulk density and texture. Hydrology Journal. 151: 147-157.
6. Kamali, K., and M.H. Mahdian. 2005. Assessment of bnrial sensors options for TDR. Physics and Relations of water, Soil and Plant. (In Farsi).
7. Maroufpoor, E. Emamgholizadeh, S. Torabi, H., and M. Behzadinasab. 2009. Impact of soil texture on the calibration of TDR for water content measurement. Applied Science Journal. 28:105-115.
8. Nadler, A., Dasberg, S., and I. Lapid. 1991. Time domain reflectometry measurements of water content and electrical conductivity of layered soil columns. Soil Science Society American Journal. 55:938-943.

9. Oleszczuk, R. Brandyk, T. Gnatowski, T., and J. Szatyłowicz. 2004. Calibration of TDR for moisture determination in peat deposits. *International Agrophysics Journal*. 18: 145-151.
10. Persson, M., and R. Berndtsson. 1998. Texture and electrical conductivity effects on temperature dependency in time domain reflectometry. *Soil Science Society American Journal*. 62: 887-893.
11. Pumpanen, L., and H. Ilvesniemi. 2005. Calibration of time domain reflectometry for forest soil humus layers. *Boreal Environment Research*. 10: 589-595.
12. Roth, K. Schulin, R. Fluhler, H., and W. Attinger. 1990. Calibration of time domain reflectometry for water content measurement using a composite dielectric approach. *Water Resources Research Journal*. 26: 2267-2273.
13. Schaap, M.G. Lange, D. L., and T.J. Heimovaara. 1996. TDR calibration of organic forest floor media. *Soil Technology Journal*. 11: 205-217.
14. Soltani Mohammadi, A. 2005. Effect of soil texture on TDR calibration for measurement of water content in Khozestan soil condition. M.Sc. Thesis. Shahid Chamran University. Ahvaz, Iran.
15. Soilmoisture Equipment corporation, 1996. Trase system I operation instructions. Soilmoisture. Equipment Corporation Incorporated, Santa Barbara CA, USA.
16. Topp, G.C. Davis, J.L., and A.P. Annan. 1980. Electromagnetic determination of soil water content: Measurement in coaxial transmission lines. *Water Resources Research Journal*. 16: 574-582.
17. Yarmi, N. Zand-E-Parsa, SH. Nehzati Paghale, A., and A.L. Kamkar Haghghi. 2008. Estimation of water content in different texture with TDR and comparison it with measured amount, The second Congress of drainage and irrigation network management. Ahvaz, Iran.

Archive