

شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی

Characterization and Synthesis of Denture Base Polymer

محمد عطایی^{۱*}، حسین میلانی^۲

۱- تهران، پژوهشگاه پلیمر ایران، ستاد فیضی ۱۹۵/۱۶۹۷۵-۲، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه شاهروود، ستاد فیضی ۸۵۱/۳۶۱۵۵
دریافت: ۱۵/۴/۷۹ | پذیرش: ۱۱/۵/۷۹

چکیده

قاعده دندان مصنوعی بخشی از پروتز کامل با جزئی است که دندانهای مصنوعی روی آن نصب و پخت می‌شوند. این بخش از پروتز دندانی خلاصه بر داشتن خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب، باید ظاهری شیوه به باشت له طبیعی نیز داشته باشد. امروزه، قاعده دندان مصنوعی و نیز پیشر دندانهای مصنوعی از پلیمر یا کوپلیمرهای متیل متاکریلات ساخته می‌شوند. در این طرح ابتدا یک نمونه خارجی با استفاده از روش‌های DSC، DMTA، GPC، NMR، GC، FTIR و تعیین توزیع اندازه ذرات نشانی شد. سپس، با توجه به نتایج بدست آمده نمایه‌های ارزاده پلیمر شدن تعیین شد. مشخصات نمونه‌های ساخته شده تعابیر و نتایجه عمومی با نمایه سارسی داشت.

واژه‌های کلیدی: مواد دندانی، قاعده دندان مصنوعی، شناسایی، پلی متیل متاکریلات، پلیمر شدن تعیینی

Key words: dental materials, denture base, characterization, poly(methyl methacrylate), suspension polymerization


مقدمه

پلی استیرن و سایر کوپلیمرهای وینیلی نیز ساخته‌اند، ولی آنچه که بطور عمدۀ مورده استفاده قرار می‌گیرد پلی متیل متاکریلات و کوپلیمرهای آن است [۲، ۴]. پلی متیل متاکریلات پلیمری شفاف است و آن را می‌توان به آسانی به رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرد و شفافیت آن را نیز تغییر داد. رنگ و خواص ظاهری این پلیمر در شرایط عادی پایدار بوده و خواص فیزیکی و مکانیکی آن برای کاربردهای دندانپزشکی مناسب است [۳-۵]. موادی که برای ساخت قاعده دندان مصنوعی مصرف می‌شوند به صورت مجموعه دو جزئی اند که جزء مایع شامل موتومر متیل متاکریلات و جزء پودر، ذرات کروی پلی متیل متاکریلات است که از راه پلیمر شدن تعیینی تهیه می‌شوند. برای شکل دهنده و تهیه پروتز دندانی این دو جزء با هم محلول می‌شوند. با نفوذ موتومر به درون ذرات پلیمر و حل شدن پلیمر در موتومر محلول به صورت خمیری با قوام مناسب برای قالبگیری در می‌آید. سپس، این

دلدانهای مجهزترین بخش دستگاه جویدن اند که همیشه دستخوش شایعترین ضایعات به نام پوسیدگی می‌شوند. پیشرفت پوسیدگی و عدم جلوگیری از آن می‌تواند منجر به از دست رفتن دندانهای طبیعی و شروع دوره بی‌دندانی در انسان گردد. جیران این نقص بطور مطلوب امکان پذیر نیست و با تمام کوشش‌های انجام شده و پیشرفت علوم، دندانهای مصنوعی هنوز توانسته‌اند وظایف دندانهای طبیعی را بطور کامل انجام دهند [۱].

اکثر پروتزهایی که امروزه جایگزین دندانهای از دست رفته می‌گردند از پلیمر ساخته می‌شوند [۱-۳]. قاعده دندان مصنوعی بخشی از یک دست دندان کامل (پروتز کامل) است که دندانهای مصنوعی روی آن چیده و نصب می‌شود. هر چند قاعده دندان مصنوعی را از

* سترل مکابات، پامگار؛ M.Altai@proxy.ipm.ac.ir

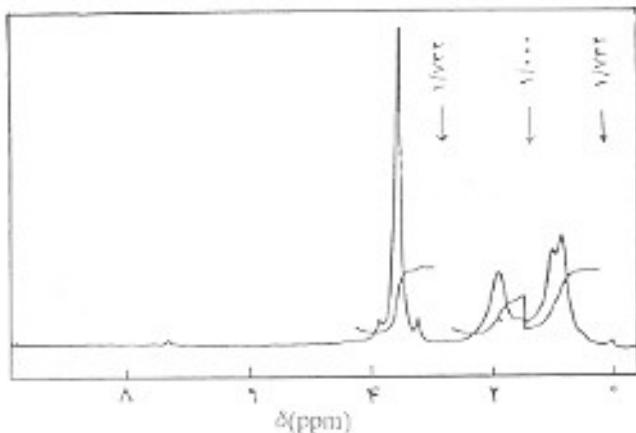

شکل ۲ - طیف FT-NMR پلیمر خالص شده پودر قاعده دندان مصنوعی نمونه مرجع.

(SDBS) از شرکت آلمانی تهیه شد و کلیه حلالهای مورد استفاده نمود آزمایشگاهی بودند و از شرکت مرک تهیه شدند.

دستگاهها برای شناسایی نمونه مرجع و نیز تعیین مشخصات نمونه‌های تهیه شده از دستگاه‌های زیر استفاده شد:

- طیف سنجی زیر فرماز تبدیل فوریه (FTIR) به وسیله DPS48 Broker

- گرومافگرامی گازی (GC) به وسیله دستگاه GC-10 VB شرکت صنایع پارس آنالیز و سنتون PBG،

- گرومافگرافی ژل تراوایپ (GPC) به کمک دستگاه ۱۵۰ و سونهای استاندارد پلی استرین (PS)،


- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی همه (^1H NMR) به کمک JNM-EXA ۸ MHz JEOL, FT-NMR

- تحریزه گرمایی دینامیکی-مکانیکی (DMA) به وسیله دستگاه PL.

- گرماسنجی پوتیسی تناصلی (DSC) به وسیله دستگاه FRITSCH (PARTICLE SIZER ANALYSETTE ۲۲)

روشها شناسایی پلیمر

برای شناسایی ساختار پلیمر قاعده دندان مصنوعی، جزء پودر در حلحل THF حل شد و پس از صاف کردن در مقدار زیادی مثانول (به عنوان ضد حلال) رسوب داده شد. رسوب حاصل پس جدا و خشک گردید و این عمل سه بار تکرار شد. برای شناسایی نمونه روی رسوب نهایی

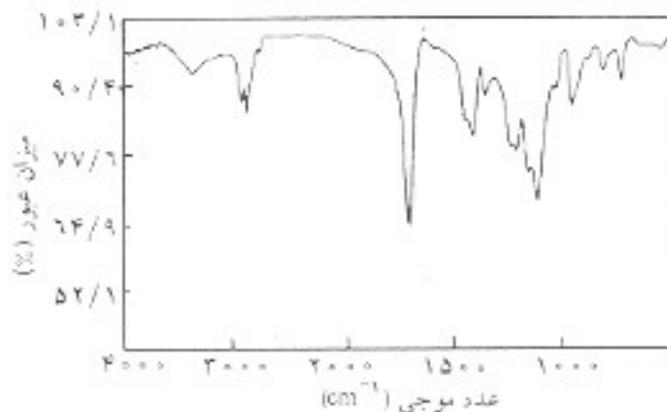

شکل ۱ - طیف FTIR پلیمر خالص شده پودر قاعده دندان مصنوعی نمونه مرجع.

خوبی در قالب‌های مناسب شکل داده و با اعمال گرمابخت می‌شود. فرایند پخت در واقع پلیمر شدن را دیگانی مونومرهای متاکربلات است [۴۶].


برای رسیدن به رنگ و حالت طبیعی لئه، به جزء پودر قاعده دندان مصنوعی رنگدانه‌های مناسب افزوده شده و سرای اسجاد حالتی که مسیرگها در لئه طبیعی ایجاد می‌کنند به پودر باد شده الاف قدر رنگی اضافه می‌شود [۴۷]. این پودر در آغاز پلیمر شدن تعلیقی می‌گردد و توزیع اندازه ذرات در آن نقن مهمنی این سی کند [۴۸].

تجربی


نمونه‌ای که برای شناسایی انتخاب شد، ساخت شرکت بایر آلمان و با نام تجاری Melindent بود (این نمونه یکی از انواع سراغوب موجود در بازار ایران است). مونومر متیل متاکربلات، آغار گریتزو نیل پروکسید، نری سدسم فنات و کلسیم کلرید از شرکت مرک تهیه شد و بدون خالص سازی اضافی مصرف شد. سدیم دودسیل سترن سولفورات

جدول ۱ - داده‌های مربوط به دمای انتقال شیشه‌ای، حرتم سولکولی و درصد مونومر آزاد نمونه‌های ساخته شده و مرجع.

نمونه	Tg (°C)	Tg (°C)	Mw (GPC)	درصد مونومر آزاد
مرجع	۷۸-۷۹	۸۵-۸۶	۷۷۵۰۰۰	۰/۸
ساخته شده	۷۹-۸۰	۸۷-۸۸	۷۲۹۰۰۰	۰/۵

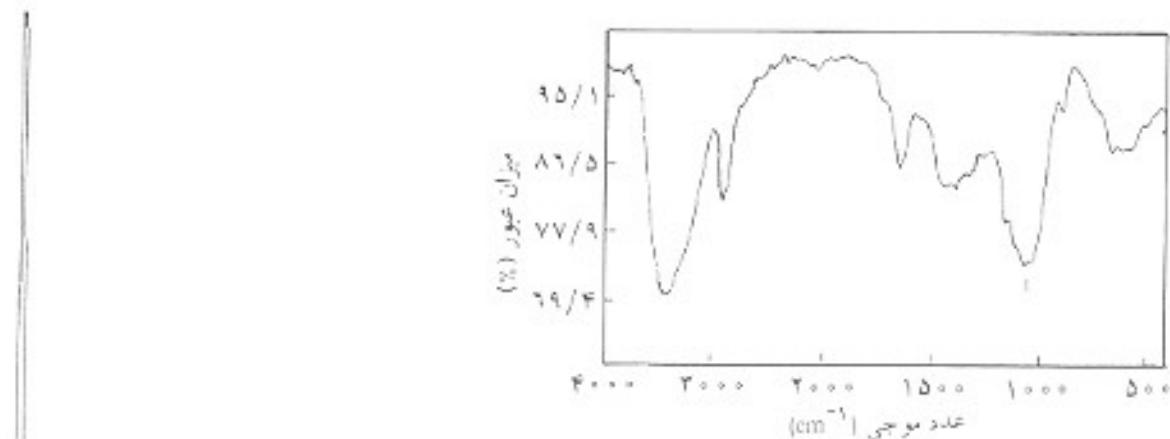

شکل ۲. طیف FTIR الیاف موجود در جزء پودر نمونه مرجع.

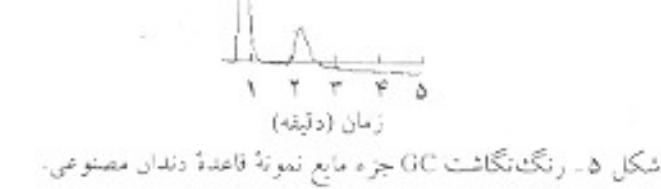

شکل ۵. رنگ تکاشت GC جزء مایع نمونه قاعدة دندان مصنوعی.

فرمز استفاده شد که طیف حاصل در شکل ۳ آمده است.


شناختی مواد معدنی موجود در پودر برای تعیین مواد معدنی موجود در پودر مقداری از پودر در کوره الکتریکی در دمای 70°C حدود ۲ ساعت سورانده شد. سپس، از خاکستر باقیمانده طیف زیر فرمز نهیه شد (شکل ۴).

شناختی جزء مایع برای تعیین اجزای تشکیل دهنده جزء مایع روی نمونه آزمون


پس از خشک شدن کامل آزمونهای طیف سنجی زیر فرمز (شکل ۱) و رزوئنس مغناطیسی هست (شکل ۲) و گریو-ماتو-گرافی ژل تراوایس (جدول ۱) انجام گرفت. همچنین، دمای انتقال شیشه‌ای این نمونه و نمونه ساخته شده با استفاده از روش‌های DSC و DMTA اندازه‌گیری شد (جدول ۱).

تعیین درصد عویوبه آزاد در پودر برای الدازه گیری درصد مولومن آزاد مقداری از نمونه پودر بدقت توزین شده و در آون خلاه در دمای حدود 55°C به مدت ۱۰ ساعت قرار داده شد. پس از اینکه نمونه به وزن لایت رسیده دوباره توزین گردید، درصد مولومن آزاد با نویجه به احت و وزنی نمونه محاسبه شد.

شناختی الیاف فرمز رنگ طول و قطر الیاف پس از جدا کردن از پودر به کمک میکروسکوپ نوری اندازه گیری شد. برای تعیین جنس الیاف نیز از طیف سنجی زیر

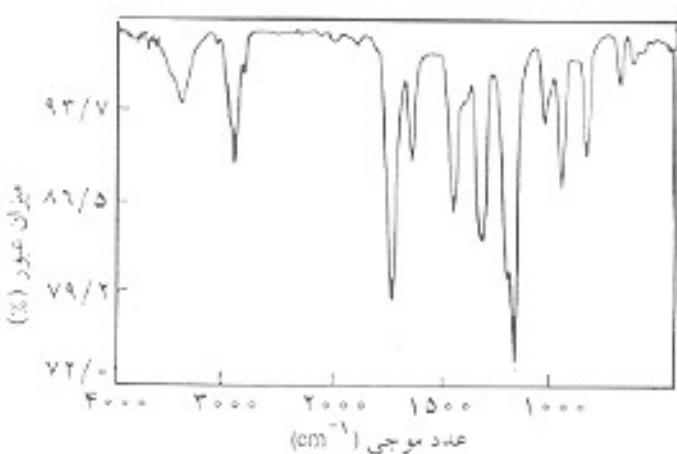

شکل ۶. طیف FTIR جزء مایع قاعدة دندان مصنوعی (استبل متاکربلات).

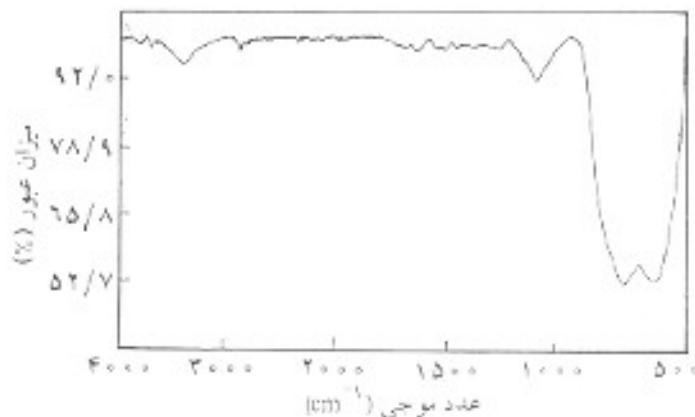


شکل ۴. طیف FTIR خاکستر حاصل از سوراندن جزء پودر نمونه مرجع.

گروی پلیمر و الیاف است. برای تعیین توزیع اندازه ذرات پودر استاد ایافت را داشده از پودر جدا شد و سپس توزیع اندازه ذرات آن معنی گردید (شکل ۶).

ساخت پلیمر

پس از شناسایی نموده، پلیمر شدن متیل متاکریلات برای تهیه دانه های پلی متیل متاکریلات (پودر) در یک راکتور شیشه ای پس از همان از راه پلیمر شدن تعیقی انجام گرفت. این راکتور به قطر ۱۵ cm و محیط به ۴ متر مربع به پهنای ۵ cm، ورودی مونومر، ورودی گاز سیتروزن، میزد، دماج و یک حمزه مکابیکی با پرده ای به قطر ۵ cm بود. دور همزه از همزه و سیله یک دور سیع دقیق اندازه گیری و کنترل شد. برای تعیین از عامل تعیقی تری کلسیم فسفات (که از واکنش مقادیر استوکیومتری از تری سدیم فسفات و کلرید کلسیم در جا تهیه شد) و عامل کاهش دهنده کلشن سطوحی SDBS استفاده شد. بتوابیل یروکسید به عنوان آغازگر هورده استفاده قرار گرفت و واکنش پس از اضافه شدن مونومر به راکتور، به مدت ۲ ساعت در دمای ۷۰°C و ۲ ساعت در ۹۰°C کامل شد. ذرات تعیقی حاصل پس از شستشو، خشک شده و توزیع اندازه ذرات آن معین شد. برای رسیدن به اندازه ذرات مناسب، دور همزه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد و تعیین اندازه ذرات به عنوان متغیر وابسته بوسیله شد (شکل ۱).

نمای انتقال شیشه ای نموده های تهیه شده با روشهای DMTA و DSC اندازه گیری و با نمونه مرجع مقایسه شد (جدول ۱). جرم

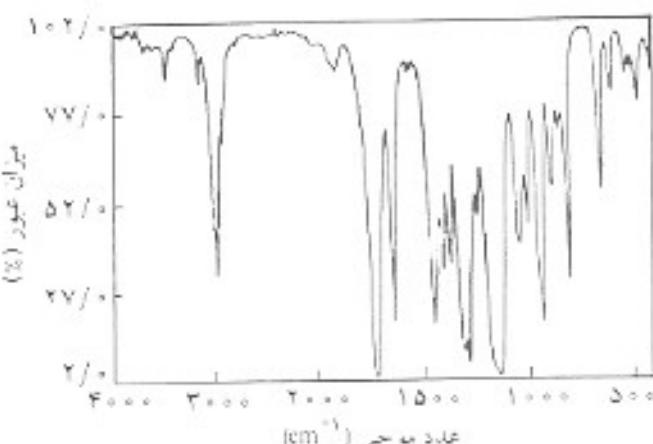


شکل ۷ - طیف FTIR جزء دوم مایع فاقد دندان مخصوصی (انیلن گلیکول دی متاکریلات).


گروماتوگرافی گازی (GC) انجام گرفت (شکل ۵)، از سولونرهای خالص متیل متاکریلات (MMA) و انیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA) به عنوان استاندارد در آزمون GC استناده شد. از گرمایگانست GC مشخص شد که مایع شامل دو جزو است. این دو جزو به وسیله تقطیر در خلاه از پکدیگر جدا شدند و سپس، طیف زیر قرمز هر یک تهیه گردید (شکل های ۶ و ۷).

تعیین توزیع اندازه ذرات پودر

جزء بودر نموده، همان طور که در شکل ۸ دیده می شود، شامل ذرات


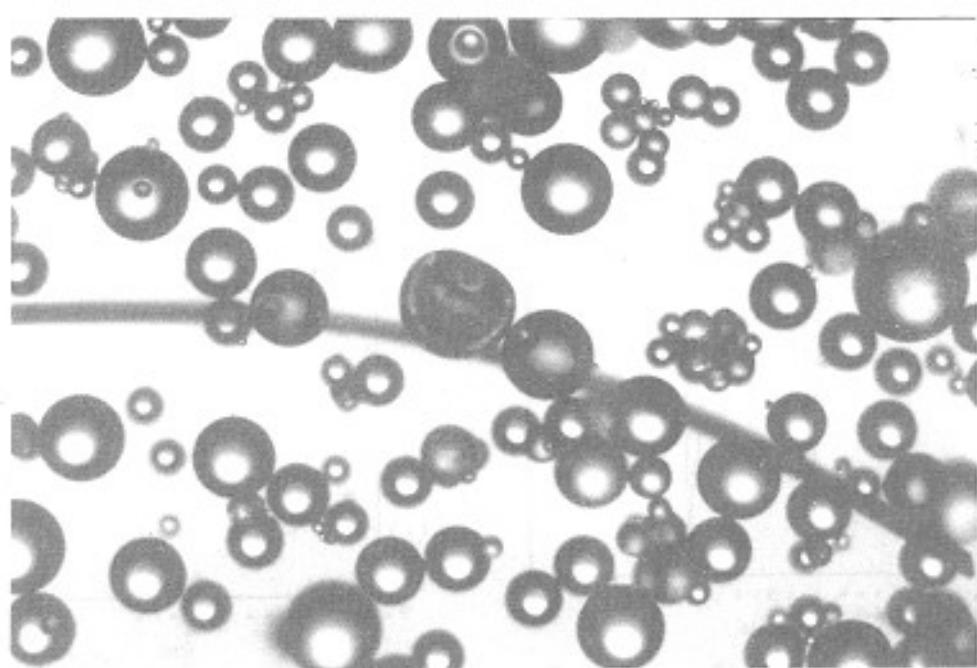


شکل ۸ - تصویر میکروسکوپی نوری از جزء بودر فاقد دندان مخصوصی نموده مرجع (ازرگنجایی ۱۰۰ برابر).


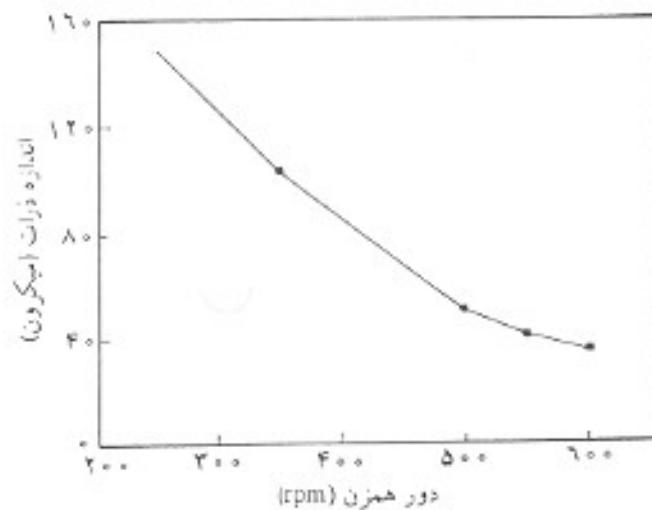


شکل ۱۰ - اثر دور همزن بر اندازه ذرات در پلیمر شدن تعیینی پودر قاعده دندان مصنوعی.

مرجع را نشان می دهد، همان طور که مشخص است، ماده معدنی فوق تیتانیم دیوکسید است، TiO_2 برای مات کردن قاعده دندان مصنوعی و ایجاد رنگ مناسب به جزء پودر اضافه می شود [۲، ۴] .

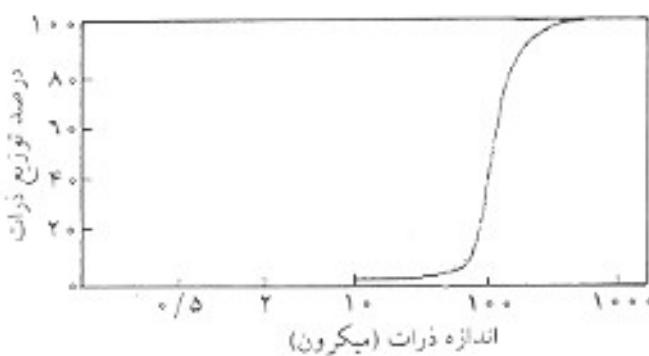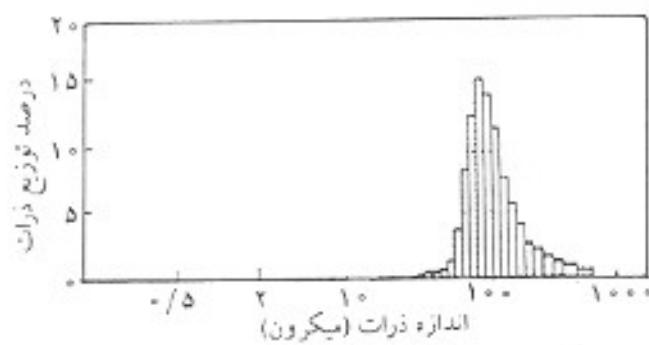

شکل ۱۱ - توزیع اندازه ذرات پودر قاعده دندان مصنوعی سونوئه ساخته شده با دور همزن rpm ۳۵۰: (الف) توزیع فرکانس و (ب) انتگرال آن.

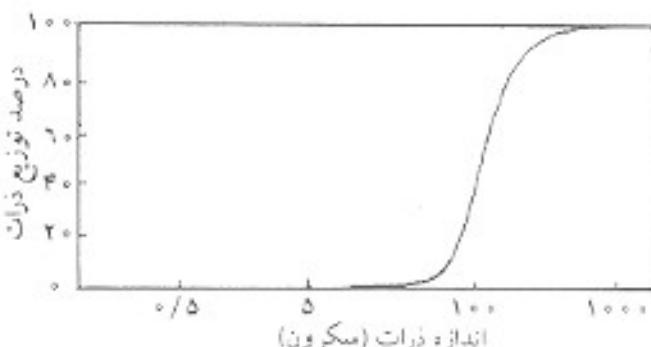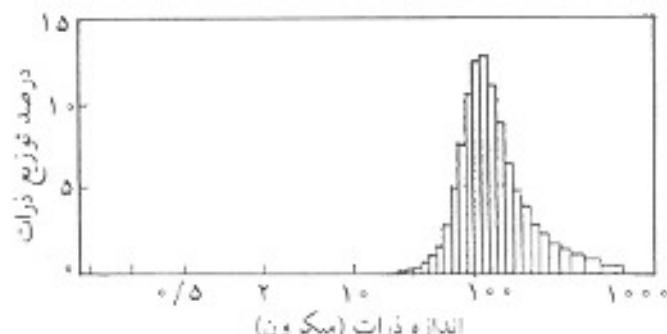

شکل ۹ - توزیع اندازه ذرات پودر قاعده دندان مصنوعی سونوئه مرجع: (الف) توزیع فرکانس و (ب) انتگرال آن.


مولکولی نمونه های ساخته شده نیز در شرایط یکسان با نمونه مرجع معین گردید (جدول ۱).

نتایج و بحث

همان طور که در طیف FTIR پلیمر خالص شده پودر سونوئه مرجع (شکل ۱) مشاهده می شود، نمونه از جنس پلی متیل متاکریلات است. برای اطمینان از خلوص پلیمر یادشده و بررسی نوع آرایش لپازی پلیمر طیف 1H NMR نمونه خالص شده تهیه گردید (شکل ۲)، همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود، نمونه پلی متیل متاکریلات خالص است که بمنظور می برسد بطور عمده دارای آرایش فضایی بسی نظم و همنظم باشد. داده های 1H NMR نمونه که از روش های DSC و DMTA بدست آمد (جدول ۱) نیز تایید کننده این نظر است [۸]. درصد موتومر آزاد پالیمانده در نمونه ساخته شده و مرجع نیز در جدول ۱ آمده است.

در شکل ۲ طیف FTIR الیاف فرمز رنگ جدا شده از نمونه مرجع آمده است. با توجه به طیف فوق الیاف از جنس سلولوز و با قطر حدود 0.2 mm و 0.75 mm و 2 mm است.

شکل ۴ طیف خاکستر حاصل از سورزندن جزء پودر نمونه

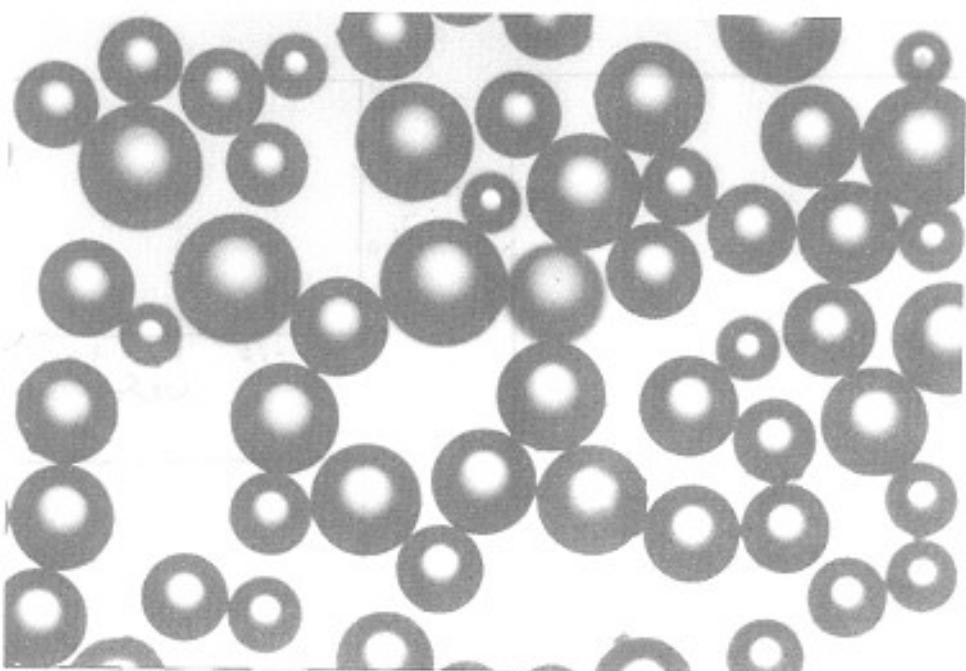

شکل ۱۲ - تصویر میکروسکوپی نوری سویه ساخته شده برای قاعده دندان مخصوص از ارتفاعی ۳۰ برابر

ذات رنگه داشتن سایر شرایط، دور همزن به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. با افزایش دور همزن اندازه ذرات پالیمر شدن تعیین کاوش می‌باید [۱۰، ۱۱] همان طور که در شکل ۱۰ نیز مشاهده می‌شود، در سویه‌های ساخته شده با افزایش دور همزن اندازه ذرات کاوش می‌باید. غرایی از این اتفاق احتمالی شده و شکل هندسی راکور استفاده شده دور ۲۵۰ rpm اندازه ۲۵ آنرا می‌توان مرجع بذست می‌دهد که برای کاربرد به عنوان پودر قاعده دندان مصنوعی مناسب است. توزیع اندازه ذرات نمونه تهیه شده در دور ۲۵۰ در شکل ۱۱ آمده است که تشابه خوبی با توزیع اندازه ذرات نمونه مرجع (شکل ۹) دارد. تصویر میکروسکوپی نوری بوده باشد متابل میکریلات ساخته شده بیرون از شکل ۱۲ آنده است.

نتیجه‌گیری

سویه‌ای از مواد متدائل مصرفي در ساخت قاعده‌های دندان مخصوص به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. پس از شناسایی نمونه مرجع، سویه‌های آزمایشی از راه پالیمر شدن تعیین ساخته شد و با نمونه مرجع مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که جزو پودر مجموعه سوره استفاده در ساخت قاعده دندانی مصنوعی شامل ذرات کروی یا متابل میکریلات (ساخته شده از روش تعیینی) است و این اثاف سلولوزی کوتاه و رنگدانه برای ایجاد حالت طبیعی لبه بوده اضافه شده است. جزو مراجع مجموعه

شناختی جزو مراجع سا آزمون کروماتوگرافی گازی آغاز شد. همان طور که در شکل ۵ دیده می‌شود، رنگ‌نمگاشت جزو مراجع نشان دهنده دو جزو است. پس، جزو مراجع تنظیر در خلاصه شد. در شکل‌های ۶ و ۷ صیغه‌ای FTIR اجزای جدا شده مشاهده می‌شود. جزو اول که خیلی عدد مراجع را تشکیل می‌دهد میتوان متابل میکریلات است (شکل ۶) و جزو دوم که دارای درصد کمی است (شکل ۷) می‌توان در عالمی اینبل گلیکول دی‌مناکریلات است. این میتوان در عالمی در فرایند پخت که شامل پالیمر شدن میتوانند. متابل میکریلات است وارد راکش شده و با شبکه‌ای گردان پالیمر باعث افزایش مقاومت مکانیکی از حمله مقاومت سیستم سویه می‌شود [۱۹].

برای تأیید تابع بذست آنده برای جزو مراجع میتوانند این متابل میکریلات و اینبل گلیکول دی‌مناکریلات خالص در شرایط بکسان و به عنوان استاندارد به IEC تزریق شد. زمانهای اذمانت بذست آنده سویه متابل میکریلات خالص ۰/۶۶ min و سویه اینبل گلیکول دی‌مناکریلات ۰/۸ min بود که تأیید کننده تابع رنگ‌نمگاشت GC و صیغه‌ای FTIR بالاست.

پس از شناسایی سویه مرجع، سویه‌های آزمایشی از راه پالیمر شدن تعیینی تهیه شد. مشخصات دمای انتقال مشاهده ای و جرم مونکولی یا متابل میکریلات سنجش شده در جدول ۱ آمده است که تشابه خوبی با سویه مرجع دارد. برای رسیدن به سوریع اندازه ذرات مناسب و مشابه نمونه مرجع (شکل ۹) با

- W.B.Saunders Co. 10th, ed., 1996
5. McCabe J. F. and Walls A. W. G.; *Applied Dental Materials*; 8th ed., Blackwell Science, 1998.
- ۶- شاهروdi محمد حسن، قدم به قدم تهیه پروتئر کامل، موسسه فرهنگی آزاد، ۱۳۷۶.
7. C.E. Schildknecht; *Polymerization Processes*; John Wiley & Sons, 1977.
8. Brandrup J. and Immergut E.H.; *Polymer Handbook*; 3rd ed., John Wiley & Sons, 1989.
- ۹- امانتی سروش، عطایی محمد و صادقی مصطفی، اثر مونومرهاي دو عاملی در مقاومت سایشی دندانی مصنوعی آکریلیک، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سیزدهم، مجله سوم، صفحه ۶۸-۶۲، پاییز ۱۳۷۹
10. Matejicek A., Seidl J. and Musil V., Ueber den Einfluss der Groesse des Reaktors auf die Partikelbildung bei der Suspensions Polymerisation Von Acrylsacureethylester-Acrylnitril-Divinylbenzol; *Angew. Makromol. Chem.*, 126, 177-194, 1984.
11. Bieringer H., Flatau K. and Reese D.; Industrielle Aspekte der Suspensionspolymerisation; *Angew. Makromol. Chem.*; 123/124, 307-34, 1984.

قاعده دندان مصنوعی شامل موتومر متیل متاکریلات (حدود ۹۷-۹۸ درصد) و موتومر دو عاملی اتیلن گلیکول متاکریلات (حدود ۴-۳ درصد) است. در ضمن نتایج آزمایشها نشان می دهد که:

- دانه های پلیمری با اندازه ذرات مناسب برای کاربرد در قاعده دندان مصنوعی از روش پلیمر شدن تعیینی قابل تهیه است.
- یکی از عوامل کنترل کننده اندازه ذرات در پلیمر شدن تعیینی دور همزن است.
- با توجه به شکل هندسی راکتور مورد استفاده در سرعت ۳۵۰ rpm اندازه ذرات مشابه سونه مرجع و مناسب برای قاعده دندان مصنوعی بدمت می آید.

عوابج

- ۱- اجلالی م، درمان بیماران بدون دندان (جلد اول) پروتئر کامل ۱، چاپ دوم، نشر جهاد، ۱۳۷۴.
- ۲- کریگک، ابرین و پاورز، مواد دندانی؛ خواص و کاربرد، ترجمه اکبر فاضل و همکاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، ۱۳۷۶.
۳. Gerhard,M.B.,*Dental Applications of Polymers: A Review*; JADA; 72, 1151-58, 1966.
4. Anusavice K. J.; *Skinner's Science of Dental Materials*;