

مقایسه تأثیر سیستم‌های چرخشی Profile و Race بر آناتومی اولیه کانال‌های مشابه‌سازی شده دارای انحنای شدید

دکتر صدیقه خدمت^{*}- دکتر مجید وحدتی‌فر[†]

* استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی، درمانی تهران

** اندودنتیست

Title: Effect of Profile and Race rotary systems on original canal anatomy in simulated severely curved canals.

Authors: Khedmat S. Assistant Professor*, Vahdatifar M. Endodontist

Address: Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Background and Aim: Recent advances in technology have permitted manufacturers to produce endodontic files from NiTi alloy and rotary systems. According to manufacturers, these files maintain original canal shape better than hand files and reduce treatment time. The aim of this study was to compare a new rotary system (Race) with an older one (Profile) in maintaining the original shape of curved canal and the working length as well as the procedural accidents rate.

Materials and Methods: In this experimental study, 40 polyester blocks with curved canals (45°), were fabricated and divided into 2 groups. After primary working length determination and staining with methylene blue, photographs were taken. Canal preparation was done with Profile and Race rotary systems according to manufacturers and working length was measured again. Canal staining by eosin was performed and photographs were taken for the second time. The two images were superimposed and changes in canals anatomy in 5 sections were recorded. Data were analyzed by t test with $p < 0.05$ as the limit of significance.

Results: There was no significant difference in inner and outer canal walls transportation between 2 groups ($P > 0.05$). Changes in working lengths and procedural accidents were similar in the studied groups ($P > 0.05$).

Conclusion: Based on the results of this study, changes in canal anatomy and working length of simulated severely curved canals as well as procedural accidents rate are similar in two rotary systems and both are suitable for canal preparation.

Key Words: Simulated canal; Rotary system; Profile; Race

چکیده

زمینه و هدف: فناوری نوین در دندانپزشکی سبب ورود انواع مختلف سیستم‌های چرخشی با فایل‌های NiTi در درمانهای اندو شده است. طبق ادعای کارخانه‌های سازنده، این فایل‌ها در مقایسه با فایل‌های دستی، آناتومی کانال‌های ریشه را بهتر حفظ کرده و باعث کاهش زمان کار و خستگی دندانپزشک می‌شوند. تنوع زیاد و عرضه روزافزون سیستم‌های جدید به بازار مصرف، انتخاب سیستم مناسب برای درمان ریشه را مشکل ساخته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یک سیستم جدید (Race) با یک سیستم قدیمی‌تر (Profile) از

[†] مؤلف مسؤول: نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان قدس - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی اندودنتیکس
تلفن: ۰۲۶۴۰۶۶۴۰ نشانی الکترونیک: s_khdmt@yahoo.com

نظر حفظ آناتومی کanalهای خمیده، حفظ طول کارکرد و میزان بروز خطاها درین درمان انجام شد.

روش بررسی: در این بررسی تجربی آزمایشگاهی، ۴۰ عدد بلوك پلی استر که دارای کanalهایی با خمیدگی ۴۵ درجه بودند، به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند. پس از تعیین طول اولیه کanalها و رنگ‌آمیزی با متیلن بلو، عکسبرداری از بلوكها انجام شد. آماده‌سازی کanalها با سیستمهای چرخشی Profile و Race طبق دستور کارخانه‌های سازنده انجام شد. طول کanalها مجدداً تعیین و تغییرات آن ثبت گردید. کanalهای آماده شده با اوزین رنگ‌آمیزی شده و عکسبرداری مجدد از بلوكها انجام شد. تصاویر قبل و بعد از کار روی هم قرار داده شد و تغییرات آناتومی کanalها در پنج مقطع مختلف بررسی گردید. داده‌های این مطالعه با استفاده از آزمون t مورد بررسی قرار گرفتند و $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: تفاوت قابل توجهی در میزان جایه‌جایی دیواره داخلی و خارجی کanal در مقاطع مختلف بین دو گروه وجود نداشت ($P > 0.05$)؛ همچنین میزان تغییر طول کارکرد و خطاها درین درمان در دو گروه مشابه بود ($P > 0.05$).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، میزان بروز خطاها درین درمان و تغییرات آناتومی و طول کارکرد در کanalهای مشابه‌سازی شده با خمیدگی شدید، بعد از آماده‌سازی با دو سیستم فوق، مشابه یکدیگر بوده و هر دو سیستم چرخشی فوق برای آماده‌سازی کanalها مناسب بودند.

کلیدواژه‌ها: کanalهای مشابه‌سازی شده؛ سیستمهای چرخشی؛ Race؛ Profile

وصول: ۸۴/۰۴/۱۴ اصلاح نهایی: ۸۴/۰۹/۲۱ تأییدچاپ: ۸۴/۱۲/۲۰

مقدمه

اندازه‌های بزرگ (بالاتر از شماره ۳۰) این نوع فایل‌ها به طور قابل توجهی مؤثرتر از فایل‌های استنلس استیل مسیر اولیه کanal را حفظ کنند و میزان صاف شدن خمیدگی کanalها، stripping ledge و apical perforation کanal کمرتر شود (۶).

اخیراً انواع مختلفی از فایل‌های چرخشی نیکل تیتانیوم ساخته و به بازار عرضه شده است که از نظر میزان tapering، مقطع عرضی و طراحی تیغه (flute design) با هم متفاوت می‌باشند. طبق مطالعه Jeon و همکاران، وسایل دارای sharp cutting edge (مانند فایل‌های سیستم Race)، از نظر میزان برداشت دبری‌ها از داخل کanal (cleaning efficiency) بهتر از وسایل دارای Profile (مانند radial landed flutes) هستند (۷).

حال این سؤال مطرح است که آیا توانایی شکل‌دهی فایل‌های دارای sharp cutting edge بهتر از وسایل دارای

پاکسازی و شکل‌دهی کanal ریشه، هدف اصلی و اولیه درمانهای اندودنیک می‌باشد (۲،۱). انجام این کار با فایل‌های دستی استنلس استیل دارای مشکلاتی است که از جمله آنها می‌توان به طولانی بودن زمان آماده‌سازی کanal و در نتیجه خستگی دندانپزشک و بیمار، تغییرات آناتومی کanal و یا جایه‌جایی آن که به طور طبیعی با افزایش قطر فایل و سختی آن ایجاد می‌شود، اشاره نمود. این مشکل به خصوص در کanalهایی با خمیدگی شدید منجر به بروز خطاها درین کار و شکست درمان می‌گردد (۴،۳).

برای رفع این مشکلات سیستمهای آماده‌سازی کanal ریشه با وسایل موتوری چرخشی (rotary system) معرفی شده‌اند که با فایل‌های ساخته شده از آلیاژ Nitinol استفاده می‌شوند.

الاستیسیته این فایل‌ها در خم شدن و چرخش ۳-۲ برابر فایل‌های استنلس استیل است (۵) که باعث می‌شود حتی

سطح هر بلوک از دو جنس تحت آزمایش سنجش ریز سختی ویکرز قرار گرفت.

پس از جمع‌آوری داده‌ها ماده پلی‌استر به دلیل این که از نظر سختی، شباهت بیشتری با عاج داشت، انتخاب گردید. در این مطالعه تجربی که در دانشکده دندانپزشکی تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ انجام شد، تعداد ۴۰ عدد بلوک از جنس پلی‌استر که دارای کانالی با قسمت مستقیم ۸ میلیمتر و قسمت خمیده ۴ میلیمتر (خمیدگی ۴۵ درجه و شاعع ۲/۵ میلیمتر) بودند، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.

طول اولیه کانال‌ها با فایل دستی شماره ۱۰ به این صورت تعیین گردید که ابتدا فایل تا انتهای کانال برده شد، سپس فایل کمی بیرون کشیده شد تا زمانی که فقط نوک فایل با چشم دیده شود. پس از آن از نمای مقابل نیز قرارگیری فایل در تمام طول کارکرد (درست قبل از فضای خالی تعبیه شده در بلوک بعد از انتهای کانال) کنترل گردید.

بعد از تعیین طول اولیه، کانال‌ها با متیلن بلو رنگ‌آمیزی شدند و عکسبرداری از آنها با دوربین دیجیتالی قابل تنظیم Fuji-S2PRO با درجه وضوح (resolution) ۱۲ مگاپیکسل بر اینچ مریع از فاصله ۶۰ سانتیمتری در یک موقعیت ثابت انجام شد.

آماده‌سازی کانال‌ها با دو سیستم Profile و Race با دستگاه Endo IT Control مطابق دستور کارخانه‌های سازنده جهت آماده‌سازی کانال‌های باریک انجام شد. از هر فایل تنها برای آماده‌سازی یک کانال استفاده شد.

از گلیسیرین به عنوان ماده لغزاننده و از آب جهت شستشوی کانال‌ها استفاده گردید. کانال‌های گروه اول با فایل‌های سیستم Profile به ترتیب زیر آماده شدند:

- ۱- بازکننده مدخل شماره ۳ (orifice shaper # 3)
- ۲- بازکننده مدخل شماره ۲ (orifice shaper # 2)
- ۳- فایل شماره ۲۵ با تقارب ۰/۰۶

radial landed flutes کارکرد کanal و میزان بروز خطاهای حین درمان بین این دو نوع سیستم وجود دارد؟

در مطالعات مختلف جهت ارزیابی آماده‌سازی کانال ریشه معمولاً دو روش به کار می‌رود:

- ۱- استفاده از دندانهای خارج شده انسان ۲- کانال‌های مشابه‌سازی شده در بلوک‌های ریزینی که درجه خمیدگی و شاعع خمیدگی در آنها مشخص باشد (۱۰، ۹، ۸).

مزیت کانال‌های مشابه‌سازی شده، یکسان کردن قطر و طول کانال ریشه، شاعع انحنای کانال و همچنین سختی نمونه‌ها است (۱۱، ۹). بنابراین این روش جهت ارزیابی و مقایسه تغییرات آناتومی کانال‌ها با روشها و فایل‌های مختلف مناسب می‌باشد، در حالی که ریشه دندانها تفاوت‌های بسیاری از نظر مورفولوژی و سختی عاج با هم داشته و به نظر می‌رسد، تنها جهت ارزیابی توانایی پاکسازی فایل‌ها و روش‌های مختلف آماده‌سازی کانال، مناسب باشند (۸، ۹).


هدف از مطالعه حاضر مقایسه یک سیستم جدید با مقطع عرضی مثلثی دارای sharp cutting edge به نام سیستم Race با یک سیستم با مقطع عرضی U شکل دارای Profile non aggressive radial landed flutes از نظر میزان حفظ آناتومی و طول کارکرد کانال و همچنین میزان بروز خطاهای حین درمان در کانال‌های مشابه‌سازی شده با خمیدگی شدید* (۴۵ درجه) بود.

روش بررسی


دو نوع ماده قابل دسترسی جهت ساختن بلوک‌های ریزینی، پلی‌استر و اپوکسی رزین بودند.

از هر یک از این دو جنس، ۵ نمونه ساخته شد؛ سپس ۳

* روش رایج برای اندازه‌گیری خمیدگی کانال که در اکثر مطالعات از آن استفاده می‌شود، روش اشنایدر است که مطابق این روش ریشه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- مستقیم (خمیدگی ۵ درجه یا کمتر) ۲- انحنای متوسط (خمیدگی بین ۱۰-۲۰ درجه) ۳- انحنای شدید (خمیدگی بین ۲۰-۷۰ درجه)

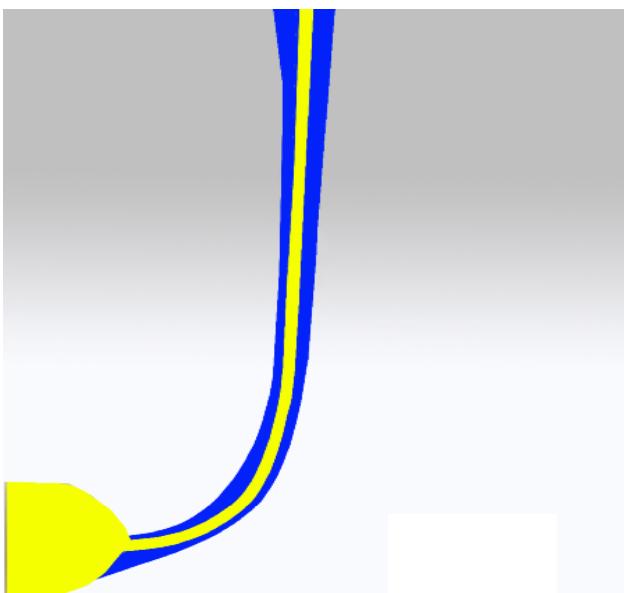

شکل ۱-آمادهسازی کanal در گروه Profile بدون ایجاد elbow و zip

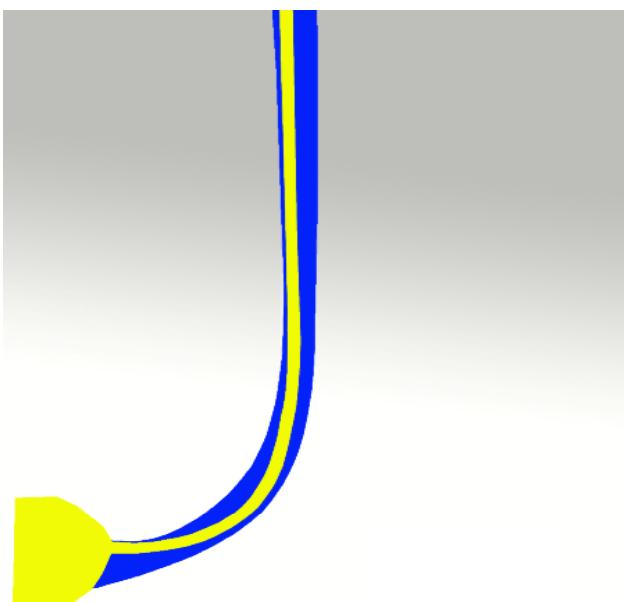

شکل ۲-آمادهسازی کanal در گروه Profile همراه با ایجاد elbow و zip

- ۱- مدخل کanal (A) -۲- نقطه میانی حد فاصل مدخل کanal و شروع خمیدگی کanal (B) -۳- نقطه شروع خمیدگی کanal (C) -۴- قله انحنا (D) -۵- نقطه پایان آمادهسازی کanal (E) (شکل ۵).

در هر بلوک محاسبه میزان جابه‌جایی (transportation)

- ۶- فایل شماره ۲۰ با تقارب .۰/۰۶
- ۷- فایل شماره ۲۵ با تقارب .۰/۰۴
- ۸- فایل شماره ۲۰ با تقارب .۰/۰۴ که تمام طول کارکرد را طی کرد.

مجددًا فایل شماره ۲۵ با تقارب .۰/۰۴ که جهت تکمیل آمادهسازی ناحیه اپیکال در تمام طول کارکرد به کار رفت.

کانالهای گروه دوم با فایل‌های سیستم Race به ترتیب زیر آماده شدند:

- ۱- فایل شماره ۴۰ با تقارب .۰/۱۰
- ۲- فایل شماره ۳۵ با تقارب .۰/۰۸
- ۳- فایل شماره ۱۵ با تقارب .۰/۰۲
- ۴- فایل شماره ۲۰ با تقارب .۰/۰۲
- ۵- فایل شماره ۲۵ با تقارب .۰/۰۲

جهت یکسان کردن آمادهسازی ناحیه اپیکال دو گروه، فایل شماره ۲۵ با تقارب .۰/۰۴ در تمام طول کارکرد استفاده شد. بعد از آمادهسازی، مجددًا طول کارکرد کانالها با همان روش تعیین طول کارکرد اولیه اندازه‌گیری شد و تغییرات آن ثبت گردید. سپس کانالها با اوزین رنگ‌آمیزی شده و عکسبرداری مجدد از آنها انجام شد.

تصاویر به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار Adobe photoshop 7.0 و با استفاده از شیارهای راهنمایی، روی هم قرار گرفتند. در نهایت ۴۰ تصویر سوپرایمپوز شده که دارای دو رنگ زرد و آبی بودند، به دست آمد که رنگ آبی نشان دهنده آناتومی کanal قبل از کار و رنگ زرد نشان دهنده آناتومی کanal پس از کاربرد وسایل بود (اشکال ۱-۴).

با استفاده از نرم افزار Catia، با بزرگنمایی ۲۹ برابر، تغییرات در دیواره داخلی و خارجی کانالها در پنج مقطع زیر اندازه‌گیری شد:


میزان جابه‌جایی کanal به طرف خارج (برحسب درصد)
 $\frac{C}{A+B+C}$

A: میزان جابه‌جایی دیواره داخلی کanal

B: قطر اولیه کanal

C: میزان جابه‌جایی دیواره خارجی کanal

جهت مقایسه دو گروه از میانگین جابه‌جایی در هر مقطع استفاده شد.

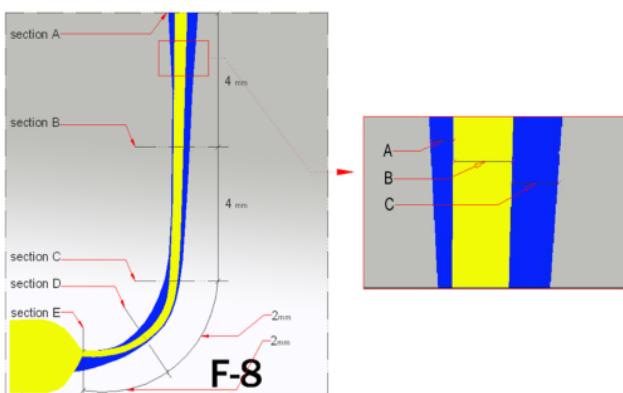

شکل ۵- پنج مقطع مورد بررسی تغییرات آناتومی کانالها

موارد zip[†]/ elbow[‡] در ناحیه اپیکال با مشاهده چشمی تمام عکسبرداری‌های سوپر ایمپوز شده دو گروه توسط ۳ نفر (دو نفر اندودنتیست و عملکننده) تعیین و مشخص گردید.

اطلاعات به کمک نرم افزار آماری SPSS 11.5 مورد پردازش قرار گرفت. به دلیل نرمال بودن داده‌های به دست آمده برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون t استفاده و $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.


یافته‌ها

۱- تغییرات طول کارکرد کanal


با کم کردن طول کارکرد بعد از آماده‌سازی از طول

[†]- Zip: عبارتست از یک ناحیه گشاد شدگی نامنظم که در اثر برداشته شدن زیاد رزین از قسمت خارجی کanal، نزدیک به انتهای کanal ایجاد می‌شود.

[‡]- Elbow: ناحیه باریکی است که در قسمت تاجی zip ایجاد می‌شود.

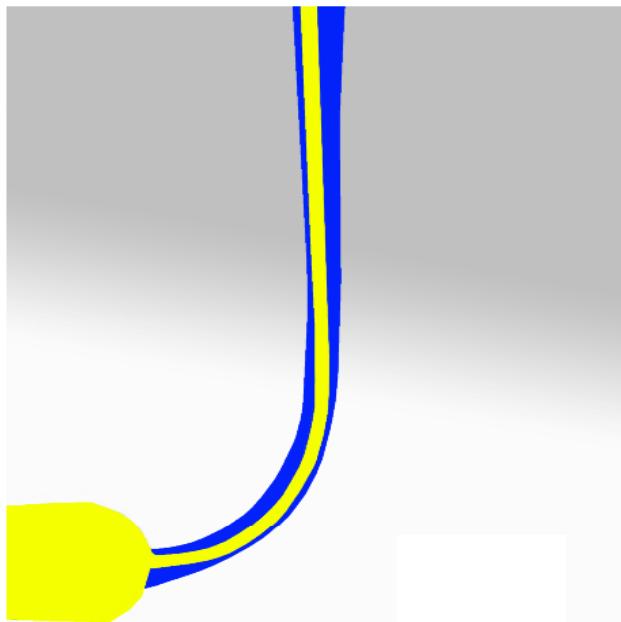

شکل ۳- آماده‌سازی کanal در گروه Race بدون ایجاد elbow و zip

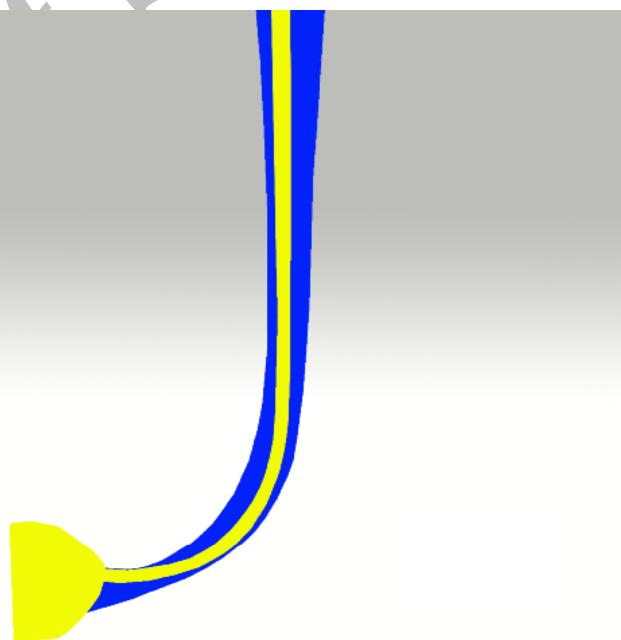

شکل ۴- آماده سازی کanal در گروه Race همراه با ایجاد elbow و zip

به طرف داخل یا خارج کanal در هر مقطع به صورت زیر انجام شد:

میزان جابه‌جایی کanal به طرف داخل (برحسب درصد)
 $\frac{A}{A+B+C}$

جدول ۱- مقایسه میانگین تغییر طول کارکرد کانال بعد از آماده‌سازی در دو گروه مورد آزمایش

P.Value	انحراف معیار	میانگین (برحسب mm)	گروه مورد آزمایش	طول کارکرد کانال
۰/۲۹۹	۰/۱۱۹	۱۲/۰۲	Profile	قبل از آماده سازی
	۰/۱۰۲	۱۲/۰۰	Race	
۰/۶۱۷	۰/۱۰۸	۱۱/۴۸	Profile	بعد از آماده‌سازی
	۰/۱۴۰	۱۱/۴۶	Race	
۰/۷۵۸	۰/۱۹۰	۰/۵۳۵	Profile	میزان تغییر
	۰/۰۷۵	۰/۵۴۰	Race	

آماری معنی‌دار نبود ($P > 0/05$) (جدول ۳).

جدول ۳- مقایسه میانگین جابه‌جایی کانال بطرف داخل و خارج در $\frac{1}{3}$ میانی کانال (مقاطع C و D)

P.Value	انحراف معیار	میانگین جابه‌جایی	گروه مورد آزمایش	محل جابه‌جایی	قطعه
۰/۳۱۱	۱۰/۸۳	۳۷/۱۸	Profile	دیواره	C
	۸/۸۰	۴۰/۰۸	Race	داخلی	
۰/۷۱۴	۷/۰۰	۱۹/۳۸	Profile	دیواره	
	۷/۰۵	۲۱/۷۹	Race	خارجی	
۰/۳۴۵	۹/۴۳	۴۲/۰۸	Profile	دیواره	D
	۱۱/۰۸	۳۹/۹۸	Race	داخلی	
۰/۱۳۰	۶/۵۵	۱۶/۱۸	Profile	دیواره	
	۹/۲۹	۲۰/۰۷	Race	خارجی	

در ناحیه آپیکال نیز هرچند سیستم Race جابه‌جایی بیشتری در هر دو دیواره داخلی و خارجی کانال ایجاد کرده بود، ولی اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت ($P > 0/05$). (جدول ۴).

جدول ۴- مقایسه میانگین جابه‌جایی کانال به طرف داخل و خارج در مقاطع E و F

P.Value	انحراف معیار	میانگین جابه‌جایی	گروه مورد آزمایش	محل جابه‌جایی	قطعه
۰/۶۷۷	۴/۳۳	۷/۸۳	Profile	دیواره داخلی	E
	۴/۷۱	۹/۳۹	Race		
۰/۳۱۳	۸/۰۶	۵۳/۷۵	Profile	دیواره خارجی	
	۱۱/۹۲	۵۶/۵۰	Race		

کارکرد قبل از آماده‌سازی، میزان تغییر طول کارکرد محاسبه شد. با توجه به جدول ۱ میزان تغییر طول کارکرد به صورت کاهش آن با میانگین $۰/۵$ میلیمتر در هر دو گروه بود که از نظر آماری بین دو گروه تفاوت قابل توجهی وجود نداشت ($P = 0/۷۵۸$).

۲- تغییرات آناتومی کانالها

مقایسه میانگین جابه‌جایی کانال به طرف داخل و خارج در $\frac{1}{3}$ تاجی نشان داد که اگرچه در سه سطح از چهار سطح مورد بررسی در این ناحیه، میانگین جابه‌جایی در گروه Race بیشتر از گروه Profile بود، ولی از نظر آماری تفاوت قابل توجهی بین دو گروه وجود نداشت ($P = 0/۳۵۳$). (جدول ۲).

جدول ۲- مقایسه میانگین جابه‌جایی کانال به طرف داخل و خارج در $\frac{1}{3}$ تاجی کانال (مقاطع A و B)

P.Value	انحراف معیار	میانگین جابه‌جایی	گروه مورد آزمایش	محل جابه‌جایی	قطعه
۰/۳۷۶	۸/۳۸	۲۸/۳۶	Profile	دیواره	A
	۷/۱۵	۲۷/۲۵	Race	داخلی	
۰/۳۵۳	۷/۸۲	۳۷/۴۴	Profile	دیواره	
	۶/۵۸	۴۲/۲۷	Race	خارجی	
۰/۱۰۱	۸/۹۷	۲۰/۰۴	Profile	دیواره	B
	۶/۹۸	۲۳/۵۸	Race	داخلی	
۰/۳۵۳	۹/۹۶	۳۷/۷۳	Profile	دیواره	
	۶/۳۶	۴۰/۵۱	Race	خارجی	

همچنین در $\frac{1}{3}$ میانی کانال اگرچه میانگین جابه‌جایی کانال به طرف داخل و خارج به جز یک سطح در گروه Race بیشتر از گروه Profile بود، ولی تفاوت بین دو گروه از نظر

فایل‌های سیستم Profile بیشتر است (۱۳).

از آن جایی که هنگام مقایسه توانایی شکل دهی سیستمهای مختلف و یا تأثیر آنها بر آناتومی اولیه کanal، داشتن قطر یکسان ناحیه اپیکال بعد از آماده‌سازی مهم است (۱۰، ۱۴)؛ بنابراین در مطالعه حاضر به دلیل آن که کanal‌های گروه Profile تا فایل شماره ۲۵ و تقارب ۴٪ آماده شده بودند، در گروه Race نیز از فایل شماره ۲۵ و تقارب ۴٪ جهت یکسان‌سازی قطر ناحیه اپیکال استفاده شد.

میانگین جابه‌جایی کanal در سطح مختلف نشان می‌دهد که در $\frac{1}{3}$ تاجی کanal (مقاطع A و B)، هر دو نوع فایل Profile و Race قسمتهای بیشتری از دیواره خارجی کanal را در مقایسه با دیواره داخلی برمی‌دارند؛ بنابراین ممکن است با استفاده از این فایل‌ها احتمال strip perforation در ناحیه Gates Glidden فور کا که در اثر استفاده نادرست از فرزهای flaring و یا با شماره‌های بالای فایل‌های دستی ایجاد می‌شود، کاهش یابد (۱۵).

در $\frac{1}{3}$ میانی کanal (مقاطع C و D) جابه‌جایی در دیواره داخلی کanal بیش از دیواره خارجی است. با توجه به وجود danger zone در دیواره داخلی این ناحیه، تأثیر کلینیکی این انحراف به طرف داخل نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ هر چند در مطالعه حاضر هیچ موردی از strip perforation در این ناحیه مشاهده نشد.

Caicedo و همکاران هم در مقایسه تأثیر فایل‌های K-file چرخشی Profile و فایل‌های Light speed با فایل‌های دستی ایجاد گردیدند (۱۶)؛ بنابراین مقادیر بیشتر میانگین جابه‌جایی دیواره داخلی در این ناحیه ممکن است به دلیل تبعیت فایل از خمیدگی کanal هنگام چرخش باشد و از نظر کلینیکی مشکلی

۳- میزان خطاهای حین درمان

در یک مورد فایل شماره ۲۵ سیستم Race با تقارب ۰/۰۴ در داخل کanal شکست. موارد ایجاد elbow zip در ناحیه اپیکال شامل ۴ مورد در گروه Race (۰/۲۰٪) و ۵ مورد در گروه Profile (۰/۲۵٪) بود. هیچ موردی از ledge^{*} و lateral perforation[†] یا stripping وجود نداشت.

بحث و نتیجه‌گیری

در مطالعه حاضر که از کanal‌های مشابه‌سازی شده با خمیدگی ۴۵ درجه در بلوک‌های پلی استفاده شد، کاهش طول کارکرد کanal بعد از آماده سازی در هر دو گروه Profile و Race به طور متوسط ۵/۰ میلیمتر بود که علت آن می‌تواند مستقیم شدن جزئی خمیدگی کanal بعد از گشاد شدن باشد. در مطالعه Hulsmann و همکاران کاهش طول کارکرد کanal بعد از آماده سازی با سیستم Profile در کanal‌هایی با خمیدگی ۲۸ درجه، ۰/۳۴ میلیمتر و در کanal‌هایی با خمیدگی ۳۵ درجه، ۰/۴۰ میلیمتر بود (۹). همچنین در مطالعات بعدی کاهش طول کارکرد کanal بعد از آماده سازی با سیستم Race در کanal‌هایی با خمیدگی ۲۸ درجه، ۰/۱۶ میلیمتر و در کanal‌هایی با خمیدگی ۳۵ درجه، ۰/۲۰ میلیمتر بود (۱۰، ۱۱). این مطالعات نشان می‌دهد هر چه خمیدگی کanal بیشتر باشد، کاهش طول کارکرد بیشتر می‌شود؛ بنابراین کاهش طول کارکرد در مطالعه حاضر به اندازه ۰/۵ میلیمتر با توجه به خمیدگی ۴۵ درجه کanal‌ها دور از انتظار نمی‌باشد. Bryant و همکاران نیز در مطالعه روی دو گروه کanal‌ها با خمیدگی ۲۰ درجه و ۴۰ درجه نتیجه گرفتند که در کanal‌هایی با خمیدگی بیشتر، تمایل به مستقیم شدن کanal با

*ledge: زمانی ایجاد می‌شود که رزین بطور نامنظم از قسمت خارجی کanal برداشته شود (ledge می‌تواند در هر جایی از کanal ایجاد شود).

[†]lateral perforation (stripping): زمانی است که در طول قسمت خارجی اینجا بطور واضح کanal جداگانه یا کاذبی ایجاد شود که با مسیر کanal اصلی یکی نیست.

داخلی و خارجی مقاطع مختلف کanal، آناتومی کanal را بهتر حفظ می‌کند.

Schafer و Valssis در دو مطالعه مختلف یکی در کانالهای ریشه دندانهای با خمیدگی بین ۲۵ تا ۳۵ درجه و دیگری در کانالهای مشابه‌سازی شده رزینی با خمیدگی ۲۸ و ۳۵ درجه نتیجه گرفتند که فایل‌های Race به طور قابل توجهی خمیدگی اولیه کanal را بهتر از فایل‌های Protaper حفظ می‌کند (۱۸، ۱۰).

میزان موارد zip/elbow در گروه Profile در مطالعه حاضر با خمیدگی ۴۵ درجه در کانالها، ۵ مورد بود (۲۵٪) که به میزان آن در مطالعه Bryant و همکاران (۲۴٪) در کانالهای با خمیدگی ۴۰ درجه شباهت داشت (۱۳). در گروه Race موارد zip/elbow شامل ۴ مورد (۰٪) بود که نسبت به موارد zip/elbow گزارش شده در مطالعه Ingle و Bakland و (۱۲٪) بیشتر بود (۱۲).

به نظر می‌رسد خمیدگی بیشتر کانالها در مطالعه حاضر (۴۵ درجه) باعث افزایش موارد zip/elbow نسبت به مطالعه قبلی که خمیدگی کانالها بین ۲۸ تا ۳۵ درجه بود، شده است. در مطالعه حاضر از دستگاه Endo IT Control استفاده گردید که torque-limited است و برای استفاده جهت سیستمهای چرخشی مختلف دارای torque، اختصاصی می‌باشد (۱۰). جهت کاهش میزان شکستن وسایل، از هر فایل تنها برای آماده کردن یک کanal استفاده شد که فقط یک مورد فایل شماره ۲۵ سیستم Race با تقارب ۰/۰۴٪ داخل کanal شکست.

تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به شماره قرارداد ۱۷۴۹ مورخ ۸۴/۰۴/۱ می‌باشد که بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه قدردانی می‌گردد.

ایجاد نکند. در ناحیه آپیکال (قطع E) هر دو نوع فایل به طور قابل توجهی به طرف دیواره خارجی کanal منحرف شده و مقادیر بیشتری از دیواره خارجی کanal را برداشتند. در مطالعه Ayar و همکاران هم در کانالهای مشابه‌سازی شده با خمیدگی ۲۰ و ۳۰ درجه، فایل‌های K3 و Profile در نیمه آپیکال مقادیر بیشتری از دیواره خارجی کanal را نسبت به دیواره داخلی برداشتند (۱۷).

Bryant و همکاران نیز در مطالعه خود با فایل‌های Profile مشاهده کردند که در ناحیه آپیکس، جابه‌جایی به میزان زیادی در دیواره خارجی کanal رخ داد و ناحیه آپیکال کانالهایی با خمیدگی ۴۰ درجه در مقایسه با کانالهای ۲۰ درجه عریض‌تر شده بودند (۱۳)؛ بنابراین ممکن است با افزایش خمیدگی کanal میزان جابه‌جایی دیواره خارجی در ناحیه آپیکال بیشتر شود.

اگرچه در هیچ یک از مقاطع مورد بررسی اختلاف آماری معنی‌داری در میزان جابه‌جایی دیواره داخلی و خارجی کanal بین دو گروه وجود نداشت، ولی در هشت سطح از ده سطح Race مورد بررسی میزان جابه‌جایی در گروه Profile بیش از توکانی شکل‌دهی فایل‌های دارای sharp cutting edge نظریر Race همانند توکانی پاکسازی آنها بهتر از فایل‌های دارای non aggressive radial landed flutes می‌باشد (۷).

با توجه به این که جابه‌جایی کanal در مقطع داخلی Race انحنا (قطع D) در گروه Profile بیشتر از Profile zip/elbow در گروه باشد، همچنین موارد بیشتر جابه‌جایی کanal به سمت خارج در ناحیه آپیکال است، می‌توان نتیجه گرفت، اگرچه در مقایسه با مقادیر Profile بیشتری از قسمتهای مختلف کanal را بر می‌دارد؛ ولی به دلیل ایجاد جابه‌جایی تقریباً یکنواخت در سطوح

منابع:

- 1- Weine F. Endodontic Therapy. 6thed. USA. Mosby; 2004. p. 164-166.
- 2- Ingle JI, Bakland LK. Endodontics .5thed. London. BC Decker Inc; 2002.p. 572-573.
- 3- Esposito PT, Cunningham CJ. A comparison of canal preparation with nickel-titanium and stainless steel instruments. *J Endod* 1995; 21(4): 173-6.
- 4- Tronsted L, Barnet F, Schwartzben L, Frasca P. Effectiveness and safety of a sonic vibratory endodontic instrument. *Endod Dent Traumatol* 1985; 1: 69-76.
- 5- Walia H, Brentley W, Gerstein H. An initial investigation of the bending and torsional properties of nitinol root canal files. *J Endod* 1988; 14: 346-51.
- 6- Mullaney TP. Instrumentation of finely curved canals. *Dent Clin North Am*. 1979; 23: 572-92.
- 7- Jeon IS, Spangberg LS, Yoon TC, Kazemi RB, Kum KY. Smear layer production by 3 rotary reamers with different cutting blade designs in straight root canals: a scanning electron microscopic study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radial & Endod*. 2003; 96: 601-7.
- 8- Paque F, Musch U, Hulsmann M. Comparison of root canal preparation using Race and Protaper rotary NiTi instruments. *Int Endod J* 2005; 38: 8-16.
- 9- Hulsmann M, Gressmann G, Schafer FS. A comparative study of root canal preparation using FlexMaster and HERO 642 rotary Ni-Ti instruments. *Int Endod J* 2003; 36(5): 358-66.
- 10- Schafer E, Valssis M. Comparative investigation of two rotary nickel- titanium instruments: Protaper versus Race. Part 1. Shaping ability in simulated curved canals. *Int Endod J* 2004; 37: 229-38.
- 11- Schafer E, Tepel J, Hoppe W. Properties of endodontic hand instruments used in rotary motion. Part 2. Instrumentation of curved canals. *J Endod* 1995; 21: 493-7.
- 12- Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 5th ed. London. BC Decker Inc. 2002; ch 14. p. 778-9.
- 13- Bryant ST, Thompson SA, Al Omari MAO, Dummer PTH. Shaping ability of Profile rotary nickel-titanium instruments with ISO sized tips in simulated root canals: part 2. *Int Endod J* 1998; 31: 282-9.
- 14- Bergmans L, Van Cleynenbreugel J, Beullens M, Wevers M, Van Meerbeek B, Lambrechts P. Progressive versus constant tapered shaft design using NiTi rotary instruments. *Int Endod J* 2003; 36: 288-95.
- 15- Walton RE, Torabinejad M. Principle and Practice of Endodontics. 3rd ed. Philadelphia. WB Saunders Co; 2002. p. 224-5.
- 16- Caicedo R, Linares L, Sanabria M. Effect of two rotary instruments on distal root of lower first molars. *J of Endod* 1996; 22: 208-9.
- 17- Ayar LR, Love RM. Shaping ability of Pro File and K3 rotary Ni-Ti instruments when used in a variable tip sequence in simulated root canals. *Int Endod J* 2004; 37: 593-601.
- 18- Schafer E, Valssis M. Comparative investigation of two rotary nickel- titanium instruments: Protaper versus Race. Part 1. Shaping ability in severely curved canals of extracted teeth. *Int Endod* 2004; 37: 239-48