

دانشور

پزشکی

بررسی رادیوگرافیکی تغییرات ابعادی کanal و حوادث در دندانهای مولر متعاقب استفاده از روش‌های

اینسترومتبیش دستی و چرخشی

نویسنده‌گان: دکتر کیامرث هنردار^۱، دکتر حسین لباف^{*} و دکتر محمدحسین نادرالوجود^۲

۱. استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

۲. دندانپزشک عمومی

Email: labaf324@yahoo.com

* نویسنده مسئول:

چکیده

مقدمه: اینسترومتبیش‌های استنتیس استیل، مدت‌ها به عنوان وسایل مورد استفاده در درمان ریشه دندان مطرح بوده‌اند. از آنجا که آماده‌سازی کanal به وسیله آن‌ها مشکل است، نسل جدیدی از وسایل نیکل تیتانیوم معرفی گردید.

هدف: هدف این مطالعه، مقایسه اینسترومتبیش‌های Ni-Ti دستی و سیستم چرخنده نیکل تیتانیوم FlexMaster در آماده‌سازی کanal است.

مواد و روش کار: دندانهای مولر اول یا دوم بالا یا پایین در ۵۰ بیمار انتخاب شد و به دو گروه ۲۵ تایی تقسیم گردید. پس از تهیه حفره دسترنسی و قرار دادن فایل شماره ۱۵ دستی نیکل تیتانیوم در داخل کanal‌ها، با استفاده از Endo-ray یک رادیوگرافی پری‌اپیکال از دندان مورد نظر تهیه شد.

در گروه I آماده‌سازی کanal به روش Crown-down و فایل‌های دستی K-flex نیکل تیتانیوم انجام شد که دوسوم کرونالی به وسیله دریل‌های گیتزرکلیدن استنتیس استیل آماده می‌شد. در گروه II اینسترومتبیش‌به وسیله سیستم چرخنده نیکل تیتانیوم FlexMaster و براساس توصیه‌های سازنده انجام شد. پس از اینسترومتبیش، با استفاده از Endo-ray یک رادیوگرافی پری‌اپیکال گرفته شد. تمام رادیوگرافی‌های اخذ شده با استفاده از دوربین دیجیتالی Fuji Film fine pix دارای لنز ماکرو ۵۰ و دیافراگم ۲/۸ وارد کامپیووتر شد. با استفاده از نرم‌افزارهای Adobe photo shop 7 مقدار زاویه ابتدایی و بعد از درمان کanal، تشکیل لج، تمایل دیوارهای داخلی و خارجی کanal، پروفوراسیون ریشه، وجود یا عدم فایل‌های شکسته مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: کanal‌ها در گروه II مرکزی‌تر بوده و نسبت به گروه I میزان کمتری از ترانسپورتیشن و لج را دارا بودند. در هیچ یک از گروه‌ها، پروفوراسیون دیده نشد و رابطه معناداری بین روش اینسترومتبیش و شکستگی وسایل ملاحظه نشد.

نتیجه‌گیری: در کل، سیستم چرخنده نیکل تیتانیوم FlexMaster می‌تواند انتخاب مناسبی برای آماده‌سازی کanal‌ها در درمان اندو باشد.

واژه‌های کلیدی: سیستم چرخنده نیکل تیتانیوم FlexMaster فایل دستی K-flex، ترانسپورتیشن، لج، پروفوراسیون، شکستگی اینسترومتبیش، مرکزیت کanal، نرم‌افزار کامپیووتری

دوماهنامه علمی - پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال پانزدهم - شماره ۷۴
اردیبهشت ۱۳۸۷

وصول:	۸۴/۱۲/۱۳
ارسال اصلاحات:	۸۵/۲/۹
دریافت اصلاحات:	۸۶/۸/۱۶
پذیرش:	۸۵/۲/۵

مقدمه

حين درمان، بر آن شدیم که تغییرات ابعادی کانال ریشه‌ها و حوادث را با استفاده از سیستم چرخشی و سیستم دستی که هر دو به روش Crown-down کانال Rیشه‌ها را آماده‌سازی می‌کنند، با هم مقایسه کنیم. در زمان اتمام این تحقیق، تحقیق مشابه‌ای بر اساس روش کاری و مواد بکار رفته ما، یافت نشده است.

در سال ۲۰۰۲ Lohmman D. Schafer E. قابلیت شکل دهنی اینسترومیشن‌های چرخشی نیکل تیتانیوم K-Flexofile در مقایسه با فایل‌های دستی Flex master استنلیس استیل را بررسی کردند [۱۱ و ۱۲]. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که اینسترومیشن‌های چرخشی Flex master در مقایسه با K-Flexofile های استنلیس استیل، هندسه کانال بهتری را نتیجه داده و بروز ترانسپورتیشن و انحراف کانال کم تراست.

در سال ۱۹۹۵ Glossen CR. و همکارانش آماده‌سازی کانال را با استفاده از فایل‌های دستی نیکل تیتانیوم، K-Flex فایل‌های چرخشی نیکل تیتانیوم و فایل‌های استنلیس استیل را مورد مقایسه قرار دادند [۱۳]. ایشان نتیجه گرفتند که اینسترومیشن‌های نیکل تیتانیوم چرخشی و اینسترومیشن دستی Ni-Ti به طور قابل توجهی موجب ترانسپورتیشن کمتر و حفظ بیشتر مرکزیت کانال می‌شود.

در سال ۲۰۰۰ Rhodes JS. و همکارانش شکل دهنی Ni-Ti flex کانال ریشه‌ها را با استفاده از فایل‌های دستی Forced balanced به روش و اینسترومیشن‌های پروفایل تیپرینگ ۰/۰۴ به روش Crown-down را مقایسه کردند [۱۴]. نتایج حاکی از آن بود که هر دو تکنیک، آماده‌سازی مرکزی و تیپری خوبی را ایجاد می‌کنند.

مواد و روش کار

از بین بیماران مراجعه کننده به بخش اندو دانشکده دندان‌پزشکی شاهد، ۵۰ بیمار بر اساس معیارهای ذیل، انتخاب و کار درمان برای دندان‌های مولر آنها انجام شد:

در یک مرور مختصر بر تاریخچه دندان‌پزشکی می‌توان نشانه‌هایی از پیشرفت روش‌های درمان ریشه یافت. یکی از اهداف اینسترومیشن کانال ریشه، پاک‌سازی (Cleaning) و شکل دهنی (Shaping) سیستم کانال تشکیل یک مخروط ممتد از قسمت تاجی حفره دسترسی تا سوراخ اپیکال است [۱ و ۲]. انجام این کار با وسایل استنلیس استیل متداول بخصوص در کانال‌های باریک و خمیده ریشه مشکل است [۳].

همچنین حفظ مسیر اصلی کانال مهم است و در کانال‌های خمیده، سخت تر به نظر می‌آید. مستقیم شدن بیش از حد کانال ریشه‌های خمیده در نواحی ثلث اپیکال، نتیجه خطاهای کارکردی است که ممکن است شانس موفقیت درمان را کاهش دهد [۴ و ۵].

فایل‌هایی با قابلیت انعطاف بالا از جنس نیکل تیتانیوم (Ni-Ti)، آثار خود در کم کردن مشکلات، در طی آماده‌سازی کانال‌های خمیده ریشه را به اثبات رسانده اند [۶ و ۷]. خصوصیات منحصر به فرد نیکل تیتانیوم امکان استفاده و همچنین پیشرفت وسایل چرخشی را باعث شده است. کوشش‌های زیادی با افزایش تیپرینگ وسایل جهت بالا بردن آثار برشی انجام شده است. وسایل چرخشی جدید نظیر پروفایل و فلکس Iso-sized ماستر با تیپرینگ ۰/۰۶ و ۰/۰۴ و ۰/۰۲ با نوک اخیراً تولید شده اند [۹].

والیا (Walia) و همکارانش گزارش دادند که فایل‌های ساخته شده از آلیاژ بیکل تیتانیوم دو تا سه برابر قابلیت ارتجاعی بیشتری در خمش‌ها و پیچش‌ها در مقایسه با طرح یکسان ساخته شده از استنلیس استیل را دارند [۱۰].

در حال حاضر اطلاعات کلینیکی یا آزمایشگاهی کمی برای قیاس توانایی شکل دهنی این اینسترومیشن‌ها در کانال‌های خمیده وجود دارد.

با عنایت به ادعاهای کارخانه ساخت فایل‌های چرخشی flex master از جنس Ni-Ti مبنی بر کیفیت بالای آماده‌سازی کانال و همچنین پایین بودن حوادث

(K-file Ni-Ti fiex / Densply
۳۰/Maillerfer) به روش کراون – داون تا فایل شماره ۳۰ آماده سازی شدند.

کلیشه های رادیوگرافی تهیه شده در مرحله First File که فایل دستی شماره ۱۵ نیکل تیتانیوم بود و در مرحله MAF (Master apical) که فایل دستی شماره ۳۰ نیکل تیتانیوم بود و توسط Endo-ray به روش موازی تحت شرایط کاملاً یکسان از لحاظ زاویه افقی و عمودی تهیه شده بود توسط دوربین دیجیتالی Fine Pix Fuji film لنز ماکرو ۵۰ با دیافراگم ۲/۸ تحت شرایط یکسان عکس برداری و تحت عنوان فایل های JPG ثبت و در حافظه کامپیوتrolوح فشرده (CD) ذخیره شدند. سپس، توسط نرم افزار Photoshop و Demo مورد بررسی و اطلاعات خام استخراج و برای پردازش در اختیار متخصص آمار قرار گرفت. نرم افزار Demo با بزرگنمایی ۲ برابر از سیستم سه خطی برای تعیین میزان انحنای کanal استفاده می کند. بدین صورت که ابتدا از محل سوراخ اپیکال خطی را شروع به رسم کردن در امتداد کanal ریشه می کنیم. با شروع انحنای کanal خط دوم از این نقطه شروع شده تا جایی که منطبق بر انحنای کanal باشد امتداد می دهیم، با زیاد شدن انحنای خط سوم از این نقطه شروع شده و تا مدخل کanal ادامه می یابد. سیستم سه خطی رسم شده توسط این نرم افزار، کمان کوچک تر تشکیل شده توسط این سه خط، از کل محیط دایره ۳۶۰ درجه را بر حسب درجه نشان می دهد. با کم کردن این زوایای به دست آمده از عدد ۱۸۰ (نیم صفحه) می توان به میزان انحراف کanal ریشه مطابق تعریف اشنايدر دست یافت و با تعیین درجات زوایای سیستم کanal ریشه قبل و بعد از آماده سازی و تفاصل بین این دو یافته، می توان به میزان تغییر زوایا دست یافت. نرم افزار Photoshop یک نرم افزار گرافیکی است که قابلیت سوپرایمپوز کردن کلیشه های رادیوگرافی قبل از آماده سازی (First File) و بعد از آماده سازی (MAF) را مهیا می سازد. با تطابق کامل و دقیق این دو کلیشه و تغییر اپسیتی (Opacity) کلیشه، تغییر انحراف در

- بیماری سیستمیک نداشته و حساسیت دارویی نداشته باشند.

- سن بیمار ۱۸ تا ۳۵ سال باشد.

- عادات مخرب اکلوژنی مثل دندان قروچه نداشته باشد.

- ریشه های دندان انتخاب شده فاقد تحلیل داخلی و یا خارجی بوده و همچنین کanal کلسیفیک نداشته باشد.

- بیمار در شرایطی باشد که امکان استفاده از Endo-ray وجود داشته باشد.

- طول ریشه بین ۱۶ تا ۲۴ میلی متر بوده و زاویه ریشه بر اساس روش اشنايدر ۱۵ تا ۴۵ درجه باشد.

- عدم وجود بیماری های پریودنتال.

تمام دندان های حائز شرایط، به طور یک در میان توسط یکی از دو روش چرخشی یا دستی آماده سازی شدند. تحت این شرایط بیمار هیچ گونه اطلاعی از نوع روش به کار گرفته شده در درمان ریشه دندان خود را نداشت و عمل کننده صرفاً به طور یک در میان و بدون اعمال نظر شخصی اقدام به درمان ریشه دندان وی می کرد. تحت این شرایط، انتخاب بیمار (نمونه) تحت عنوان «نمونه برداری کوریکسویه» (Single blind) انجام می شد. تعداد ۵۰ بیمار به صورت مساوی در هر گروه تقسیم شدند و هر دندان براساس فک بالا و یا پایین و شماره دندان در دو گروه مساوی قرار گرفتند. در نهایت تمام دندان ها تا حد امکان از لحاظ Configuration کanal ها و تعداد و شماره دندان به دو گروه مساوی تقسیم شدند.

دندان های گروه اول توسط سیستم چرخشی تیتانیوم flex master با تپرینگ ۰/۰۶ و ۰/۰۴ (flex master/Nickel-Titanium/VD/Germany) با استفاده از هندپیس NSK ژاپن که مخصوص این کار است و دارای سرعت چرخش ۳۰۰-rpm است، بر طبق توصیه کارخانه ساخت، به روش Crown-down تا فایل شماره ۳۰ آماده سازی شدند. دندان های گروه دوم توسط سیستم دستی با استفاده از دریل های چرخشی گیتس-گلیدن (Gatse-glidden / stainless-steel / Dentsply / Maillefe) و

۴. بین نوع روش و شکستگی فایل از نظر آماری ارتباطی وجود ندارد ($p=0/494 > 0/05$).
 ۵. بین زاویه اولیه ریشه و وجود لج در روش دستی از نظر آماری ارتباط وجود دارد ($p=0/05 < 0/005$).
 ۶. بین زاویه اولیه ریشه و ترانسپورتیشن در روش دستی از نظر آماری ارتباط وجود دارد ($p=0/019 < 0/005$).
 ۷. بین زاویه اولیه ریشه و ترانسپورتیشن در روش چرخشی از نظر آماری ارتباط وجود ندارد ($p=0/63 > 0/05$).
 ۸. بین زاویه اولیه ریشه و تمايل به دیواره در روش دستی از لحاظ آماری ارتباط وجود دارد ($p=0/007 < 0/05$).
 ۹. بین زاویه اولیه ریشه در روش چرخشی و تمايل به دیواره از لحاظ آماری ارتباط وجود ندارد ($p=0/75 > 0/05$).
 ۱۰. بین زاویه اولیه ریشه و شکستگی فایل در روش دستی، از نظر آماری ارتباط وجود ندارد ($p=0/424 > 0/05$).
 ۱۱. بین زاویه اولیه ریشه و شکستگی فایل در روش چرخشی، از نظر آماری ارتباط وجود دارد ($p=0/007 < 0/05$).
 ۱۲. میانگین تغییر زاویه در دو گروه دستی و چرخشی از نظر آماری دارای اختلاف معنادار است ($p=0/001 < 0/05$).
 ۱۳. بین تغییر اندازه زاویه ریشه و type (کلاس) کانال در روش دستی، از نظر آماری ارتباط وجود دارد ($p=0/007 < 0/05$).
 ۱۴. بین تغییر اندازه زاویه ریشه و type (کلاس) کانال در روش چرخشی اختلاف معناداری دیده نمی‌شود. ($p=0/09 > 0/05$).
- نمودارهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ مقایسه فراوانی نسبی اطلاعات را نشان می‌دهند.

دیواره‌های داخلی و خارجی بعد از آماده‌سازی کانال ریشه، احتمال ایجاد لج، بروز ترانسپورتیشن در ثلث اپیکال کانال را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات خام به دست می‌آید.


نتایج

در گروه چرخشی ۲۵ دندان مولر شامل ۷۵ کانال و در گروه دستی ۲۵ دندان مولر شامل ۷۵ کانال آماده‌سازی شدند. در گروه چرخشی تعداد ۶ عدد فایل و در گروه دستی تعداد ۳ عدد فایل در کانال‌ها شکسته شد که این کانال‌ها از مطالعه خارج شدند (گروه چرخشی شامل ۶۹ کانال و گروه دستی شامل ۷۲ کانال). در گروه دستی در ۶ کانال لج (بله) اتفاق افتاد و در گروه چرخشی عملاً لجی ایجاد نشد، در گروه دستی ۱۲ کانال تمايل به دیواره خارجی، ۱۷ کانال تمايل به دیواره داخلی و در ۴۳ کانال باقیمانده آماده‌سازی در مرکزیت کانال انجام شده بود. در صورتی که در گروه چرخشی ۱۳ کانال تمايل به دیواره خارجی، ۱۰ کانال تمايل به دیواره داخلی و در ۴۶ کانال باقیمانده آماده‌سازی در مرکزیت کانال انجام شده بود. در گروه دستی از کل ۷۲ کانال، در ۲۳ کانال ترانسپورتیشن در ثلث اپیکال کانال اتفاق افتاده ولی در گروه چرخشی از کل ۶۹ کانال فقط در سه کانال ترانسپورتیشن در ثلث اپیکال کانال اتفاق افتاده بود.

در هر دو گروه هیچگونه پرفوراسیون (سوراخ شدگی ریشه) اتفاق نیفتاده بود.


نتایج حاصل از آزمون‌های آماری کای-اسکوئر (chi-square) و تی-تست (T-Test) و آنالیز واریانس (ANOVA) نشان داده:

۱. بین نوع روش وجود ledge از نظر آماری ارتباط وجود دارد ($p=0/028 < 0/05$).
۲. بین نوع روش و ترانسپورتیشن از نظر آماری ارتباط وجود دارد ($p=0/05 < 0/05$).
۳. بین نوع روش و تمايل به دیواره کانال از نظر آماری ارتباطی وجود ندارد ($p=0/388 > 0/05$).

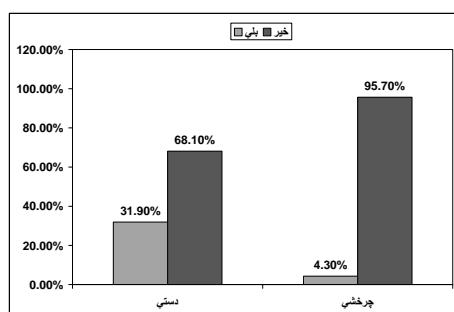

نوع روش

نمودار ۵: نمودار مقایسه‌ای فراوانی نسبی وجود ترانسپورتیشن در دو روش دستی و چرخشی

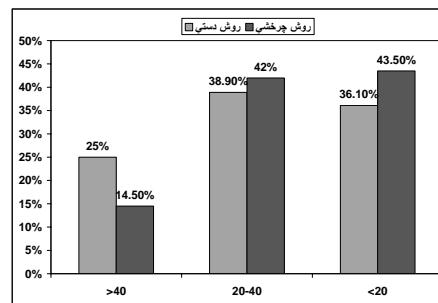

اندازه زاویه اولیه


نمودار ۱: نمودار مقایسه‌ای فراوانی نسبی میزان اندازه راوه اولیه کanal در دو روش دستی و چرخشی

بحث و نتیجه‌گیری

اینسترومانتی که قابلیت تعییت از مسیر کanal را داشته و با مرکزی قرار گرفتن در داخل کanal از ایجاد استرس‌های اضافی جلوگیری کند می‌تواند انتخابی مناسب جهت عمل اینسترومانتیشن باشد. با توجه به خصوصیات سیستم چرخشی نیکل تیتانیوم Flex master همانند نوک غیربرنده، سطوح برند پهن به جای یک لبه برنده در فلوت‌های فایل، همراه با قابلیت انعطاف‌پذیری و ارتقای پذیری آلیاژ نیکل تیتانیوم، انتظار آماده‌سازی کanal با حداقل میزان جابجایی مسیر وجود دارد که نتایج این مطالعه هم تأیید‌کننده این مسئله بود.


Matsumot و Tachibana کاربرد توموگرافی کامپیوتربی (CT) را در اندو در سال ۱۹۸۹ ارزیابی کردند [۱۵]. در حال حاضر توموگرافی کامپیوتربی کاربردهای مختلفی را در زمینه کار دندان‌پزشکی خصوصاً جراحی دهان و ایمپلنتولوژی پیدا کرده است. در درمان ریشه هم CT می‌تواند یک تصویر مناسب را از داخل سیستم کanal را ریشه ارائه دهد و امکان استفاده از اسکن دندان را قبل و بعد از اتمام عمل اینسترومانتیشن فراهم ساخته است.

با توجه به پیشرفت‌های قابل ملاحظه در زمینه ارزیابی اینسترومانتیشن سیستم کanal ریشه دندان، مقایسه اینسترومانتیشن قبل و بعد از عمل، با استفاده از ارزیابی دقیق کامپیوتربی، بررسی اسکن‌های تهیه شده عملی گشته است. در این مطالعه ما بر آن شدیم تا عمل مقایسه را به شیوه آنالیز کامپیوتربی انجام دهیم. با توجه به عدم

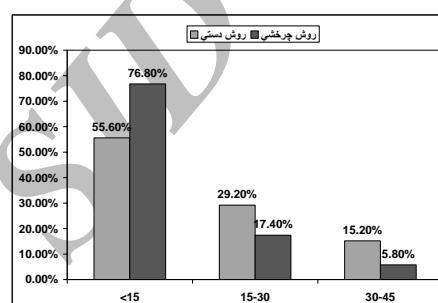


تغییر اندازه زاویه کanal

نمودار ۲: نمودار مقایسه‌ای فراوانی نسبی میزان تغییر اندازه زاویه کanal در دو روش دستی و چرخشی

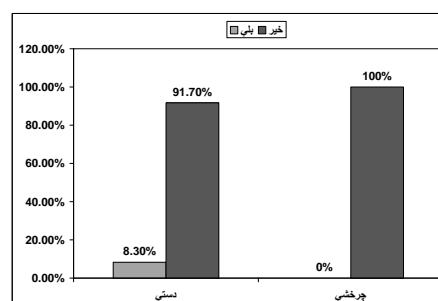

نوع روش

نمودار ۳: نمودار مقایسه‌ای فراوانی نسبی وجود لج (Ledge) در دو روش دستی و چرخشی

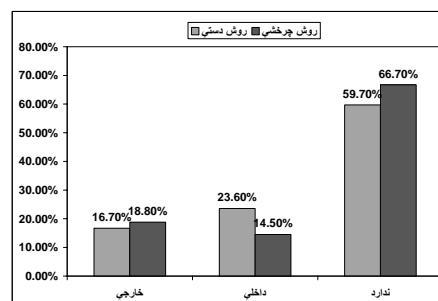

چگونگی تمایل به دیواره

نمودار ۴: نمودار مقایسه‌ای فراوانی نسبی چگونگی تمایل به دیواره در دو روش دستی و چرخشی

به دست آمده همانند مطالعه Lohmann D. و Schafer E. است.

در مطالعه Lohmann D. و Schafer E. این اشکال مشاهده می‌شود که در روش استفاده کردن از فایل Flex master تکنیک پاکسازی به روش کراون – داون بوده در حالی که در استفاده از K-Flexofile توسط روش حرکت reaming بوده و این مشخص نمی‌کند که تکنیک استفاده شده در فایل‌های K-Flexofile به صورت پاکسازی از ناحیه تاجی به نوک ریشه بوده یا بالعکس از نوک ریشه به طرف تاج بوده است. در عین حال مشکل دیگر، تعداد کانال‌های آماده‌سازی شده توسط دو روش است و مادر مطالعه خود با بالا بردن تعداد نمونه‌ها، سعی کرده‌ایم این نقیصه را رفع کنیم تا بتوانیم با استفاده از تست‌های ارزشمند‌آماری، نتایج قابل اطمینان‌تری ارائه کنیم. در ادامه، در مطالعه دیگری توسط Lohmann D. و Schafer E. در سال ۲۰۰۲ بر روی تأثیر پاکسازی و شکل‌دهی فایل Flex master و K-Flexofile در دندان‌های کشیده شده انسان [۱۲] فایل‌های Flex master نسبت به K-Flexofile توانستند به میزان بیشتری کرو اصلی را حفظ کنند. مطالعه ما نیز با توجه به این موضوع که از فایل Ni-Ti در هر گروه استفاده شده بود و همچنین روش پاکسازی در هر دو گروه (کراون – داون) یکسان بود، باز همین نتیجه حاصل گردید و مشابه با نتیجه این دو نفر بود.

در مطالعه Glossen CR. و همکارانش در سال ۱۹۹۵، بررسی روی فایل‌های دستی engine driven Ni-Ti و Ni-Ti engine driven نیز ترانسپورتیشن کمتر با فایل‌های engine driven نسبت به فایل‌های دستی و همچنین حفظ بیشتر مرکزیت کانال به صورت قابل توجهی معنادار بود. در این تحقیق از فایل‌های engine driven به روش quarter turn/pull که مشخص نشده پاکسازی از ناحیه تاجی به نوک ریشه است و یا بر عکس و از فایل‌های Ni-Ti از تکنیک Canal master استفاده شده که به آماده‌سازی از تاج به نوک ریشه است و این یکی از اشکالات مطالعه است. همچنین تعداد کم نمونه‌ها (۶۰

دسترسی به سیستم RVG (Radio visio-Graphy) که مستقیماً بتوان نگاره‌های رادیوگرافی را اسکن کرد، سعی بر آن شده که رادیوگرافی دندان به شیوه معمولی با استفاده از ray Endo قبل و بعد از اینسترومیشن تهیه و سپس از فیلم رادیوگرافی اسکن مربوطه تهیه و مقایسه بر روی اسکن‌ها انجام شد.

نرم‌افزارهای مورد استفاده ما تحت عنوان Demo و Photoshop ۷. است که از نرم‌افزار اول جهت اندازه‌گیری زوایای کانال‌های ریشه قبل و بعد از درمان استفاده شد و نرم‌افزار دوم، یک برنامه انطباقی گرافیکی است که با امکان سوپرایمپوز کردن نگاره‌های قبل و بعد از آماده‌سازی کانال‌ها، تمایل به سمت دیواره‌های داخلی یا خارجی کانال‌ها بعد از آماده‌سازی، بروز لج و ترانسپورتیشن ارزیابی شد. طبق بررسی مقالات در مطالعه Lohmann D. و Schafer E. در سال ۲۰۰۲ [۱۱] مشخص گردید که فایل‌های Flex master در مقایسه با استنليس استیل از نوع K-Flexofile در دو گروه کانال‌های مشابه با زوایای ۲۸ و ۳۵ درجه، فایل‌های Flex هندسه کانال بهتری را در مقایسه با فایل‌های K-Flexofile به وجود می‌آورد و همچنین در خصوص ترانسپورتیشن کانال و انحرافات دیواره‌های داخلی و خارجی کانال نیز فایل‌های Flex master به مرتب کمتر از فایل‌های K-Flexofile بود هر چند از لحاظ آماری اختلاف معناداری بین دو گروه در این مطالعه مشاهده نگردید، در مطالعه ما نیز از لحاظ شکل کانال در مقایسه با فایل‌های دستی Ni-Ti، فایل Flex master نمای هندسی بهتری را ایجاد کرد و نتایج به دست آمده از مطالعه ما، مشابه مطالعه Lohmann D. و Schafer E. بود.

در خصوص میزان ترانسپورتیشن و انحرافات کانال نیز مطالعه ما نشان دهنده کم تر بودن انحراف دیواره‌های خارجی و داخلی کانال توسط فایل‌های Flex master نسبت به Ni-Ti دستی بود و این که فایل‌های Flex master کانال‌های ریشه را با انحرافات کمتری نسبت به فایل‌های دستی Ni-Ti آماده‌سازی می‌کنند و این نتیجه

منابع

- Stephan Cohen., Richard C.Burns.“Path ways of the pulp”.7 th edition- Mosby 1998-P: (43-44), (226-232), (203-4), (248-51), (252).
- Schilder H. “Cleaning and shaping the root canal”. Dent clin North am 1974;18:269-96.
- Weine F.,Kelly R.,Lio P. “The effect of preparation procedures on the orginal canal shap and on apicalForamen shap ”. J Endodontic 1975;1:255-62
- Perez TA. The anticurvature filling concept Losangeles:CA: Univesity of southern Callifonia 1976.
- Pucci FM., Reig R. “Conductos radiculares” Buenos Aires:editoral medico - quirurgica 1944;11:289-95.
- Ceren TP.,adams JD., Saxena A. “ Nickel titanium instruments applications in andodontic”. Ishiyaku Euroamerica 1995:49-66.
- WU MK., Wesselink PR. “ Efficacy of three techniques in cleaning the apical portion of curved canals ”. Oral surg oral Med oral pathol 1995;79:492-96
- Zmener O., Banegas G. “Comparison of three instrumentation techniques in the preparation of simulated curved root canal ”. Int Endod J 1996;26:315-9.
- Kanavagh D.,Lumley PJ. “An invitro evaluation of canal preparation using profile 0.04 and 0.06 taper series instruments” Endod Dent traumatal 1998;14:10-24.
- Wilia H., Brantly WA., Gerstein. “An initial investigation on the bending and torsional propertiesof nitional root canal files”.J Endodontic 1688;14:346-51.
- Schafer E., Lohmann D. “Efficiency of rotary Ni-Ti flex master instruments compared with stainless_steel hand K-flexofile shaping ability in simulated curved canals ”. Part 1- Int Endod J 2002;35(6):505-13.
- Schafer E., Lohmann D. “Efficiency of rotary Ni-Ti flex master instruments comperd with stailess-steel hand K-flexofile – cleaning effectiveness and instrumentation results in severly curved roof canals of extracted teeth”.Part 2_ Int Endod J 2002;35(6):514-21.
- Glossen CR., et al. A comparison of root canal preparations using Ni-Ti hand, Ni-Ti engine – driven, and K-flex endodontic instruments. J Endod 1995; 21(3):146-51.
- Rhodes JS., et al. “A comparison of two Ni-Ti instruments techniques in teeth using microcomputed tomography ”. Int Endod J 2002;33(3):279-85.
- Tachibana H., Matsumoto K. “Application of x-ray comeputerized tomography in endodontics.” Endodo Dent traumatal 1990;6:16-20.
- دکتر اکبر فلاخ رستگار و دکتر مریم جاویدی. «مطالعه آزمایشگاهی مقایسه اینسترومنت دستی استنلیس استیل و سیستم چرخشی پروفایل نیکل -تیتانیوم در آماده سازی کanal» مجله دانشکده دندان پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال ۱۳۸۱ جلد ۲۶، شماره ۱۰، صفحه ۸۰-۷۳.
- دکتر شیخالاسلامی مهشید، قائمی. محمدرضا، جمالی نیا عادل، «مقایسه میزان تغییر خمیدگی و ترانسپورتیشن اپیکال در دو روش چرخشی پروفایل و روش دستی استپ - بک با فایل های نیکل - تیتانیوم» شماره ۱۳۷، دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال ۱۳۷۸.

کanal مزیالی مولرهای مندیبل کشیده شده انسان) از اشکالات دیگر مطالعه است و ما در تحقیق خودمان با یکی کردن روش هایی پاک سازی در گروه و افزایش تعداد نمونه ها به نتایج آماری اطمینان تری دست یافته ایم، به هر صورت نتایج به دست آمده ما با نتایج حاصل از تحقیق Glossen CR. و همکارانش مشابه است.

همچنین در مطالعه ای که توسط دکتر اکبر فلاخ رستگار و دکتر مریم جاویدی در سال ۱۳۸۱، آماده سازی کanalها توسط فایل های استنلیس استیل و پروفایل را درصد دندان تک کanal انجام دادند[۱۶]. میزان ترانسپورتیشن در سیستم چرخشی کمتر از استنلیس استیل مشاهده گردید. مطالعه ما نیز تأیید کننده این مطالعه بالا بوده است، هر چند که در بعضی موارد از قبیل روش پاک سازی، نوع فایل، تعداد دندانها و زاویه ریشه ها در دو مطالعه تفاوت داشت، اما مطالعه ما نیز به نتایج مشابهی دست یافت. همچنین در سال ۱۳۷۸ دکتر قائمی و دکتر جمالی نیا تغییر خمیدگی و ترانسپورتیشن اپیکالی را در کanal های مزیوباکال مولرهای اول و دوم مندیبل کشیده شده انسان در ۶۲ دندان با خمیدگی و متوسط ۱۱-۲۵ درجه را توسط پروفایل (به روش کراون - داون) و فایل های دستی Ni-Ti (به روش استپ - بک) مورد بررسی قرار دادند[۱۷]. ایشان نتیجه گرفتند که میزان تغییر خمیدگی و ترانسپورتیشن اپیکالی در روش چرخشی کمتر از روش دستی است با این وجود اختلاف معنادار نبود، نتایج به دست آمده از مطالعه ما نیز مشابه نتایج به دست آمده توسط دکتر قائمی و دکتر جمالی نیا بود. با عنایت به نتایج تحقیق ما و تحقیقات مشابه در این زمینه انتظار می رود، استفاده از اینسترومنت های چرخشی Flex master در درمان های کanal ریشه های دندان بسیار مؤثر باشد. کاربرد این وسایل در مقایسه با فایل های دستی در امر Ni-Ti آماده سازی کanal های ریشه دندانها توصیه می شود.