



## بررسی تغییرات درک گفتار با کاهش دادن تعداد کانالهای فعال در بیماران کاشت حلزون با ۲ پروتز

*Effect of Channel Number Decrease Performance in  
Two Groups of Implanted Patients with Nucleus 22 and Med-el*

Mohammad M Ghasemi, MD; Mohammad T. Shakeri PhD.; Nasrin Rasta. MD; Mohammad R Tele, BSc; Hamid Tayarani, MSc; Effet Darubord BCs.

ENT Department, Mashhad University of Medical Sciences

### Abstract

**Objective :** One of the main questions in the design of Cochlear Implants is "How many channels of stimulation are needed to achieve a high level of speech understanding?

Recently, some investigations have been carried out in which experiments were conducted with adults to provide an answer to this question. To reach 90% accuracy in quiet, 5 channels are necessary for more difficult sentences produced by multiple talkers (Loizou et al. 1999), and 8 or more channels are necessary for monosyllabic words (Dorman et al., in press).

**Material and method :** In our research we extend our observations on the number of channels necessary to reach high levels of word Recognition Scores (Without Lip-reading) to a group of 30 implanted patients using the Nucleus 22 and Med-el(Combi 40+) cochlear implant devices, who had at least six months of Auditory Verbal Training experience following implant surgery.

Simulating various numbers of channels was performed by reducing the number of active electrodes while the overall spectral band width was preserved. Five levels of active electrodes were simulated for nucleus devices, including: 22, 16, 12.8 and 4 electrodes. Three levels of active electrodes were simulated for Med-El devices including: 12, 8, 4 electrodes. Word recognition score was measured on ten bisyllabic words after each level.

**Result :** The results showed that word recognition scores decreased dramatically, as the number of electrodes was decreased from 12 to 8 and 4 electrodes (in nucleus device) and from 8 to 4 electrodes (in med-el devices). There was no significant difference in word recognition score as the number of electrodes was increased from 12 to 16 and 22 electrodes (in nucleus devices), and from 8 to 12 electrodes (in Med El devices).

**Conclusion :** Results indicate that if signal processors / electrode arrays could provide implanted patients with the equivalent of 8-12 functional channels of stimulation then the tasks of word recognition and language acquisition would be significantly facilitated.

**key words :** Cochlear implant, Channel number, Speech performance.

۱۲ و ۴ تحریک انجام شد. میزان تشخیص کلات با ۱۰ کلمه دوسیلابی در هر مرحله بررسی شد.

نتیجه: نتایج زیر به صورت کاهاش میزان درک کلمات با توجه به کاهاش الکترودها به ۱۲ و ۴ (در پروتز نوکلتوس) و کاهاش الکترودها از ۱۲ به ۸ و سپس ۴ الکترود (پروتز مدار) مشخص گردید. تغییرات معنی داری در میزان درک کلمات در زمانی که پروتز نوکلتوس ۲۲، ۲۲ و ۱۲ الکترود فعال بود و یا پروتز مدار ۱۲ و ۸ الکترود فعال داشت، ایجاد نشد.

نتیجه گیری: نتایج دلالت بر این دارد که اگر پردازشگر گفتار بتواند افراد کاشه شده را از طریق ۸ تا ۱۲ کانال فعال تحریک کند، پاسخ درک کلمات و فراگیری زبان به طور قابل توجهی آسان تر خواهد شد.

#### مقدمه

برای دستیابی به بهترین سطح درک گفتار در بیماران کاشه شده تعیین تعداد کانالهای فعال یکی از سؤالات پایه برای طرح ریزی هر رشته الکترودی می باشد. تحقیقات بسیاری برای تعیین تعداد کانالهای لازم برای دستیابی به بهترین درک گفتار در بالغین و کودکان انجام گرفته است. برخی تحقیقات هم برای تعیین حداقل تعداد کانال لازم برای رسیدن به بالاترین درک گفتار روی افراد با شناوی نرمال توسعه تقلیدی از پردازشگر گفتار انجام شده است. کرایتریاهای لازم برای مقایسه بین بیماران و افراد نرمال در این تحقیقات اولیه مشخص شده و اعلام گردیده که فاکتورهای متعددی روی چگونگی درک گفتار در یک بیمار دخالت دارد. این فاکتورهای را می توان به ۲ دسته تقسیم کرد.

این فاکتورها شامل A- فاکتورهای بیمار، B- فاکتورهای وسیله می باشند.

A- فاکتورهای مربوط به بیمار شامل: جمعیت نورونی باقیمانده، IQ، محرومیت شنیداری (حسی - عصبی) تکامل سیرهای شنیداری، طول مدت ناشنوایی، سن زمان کاشه، سطح زبانی قبیل از عمل، معلولیتهای دیگر، کرایتریای انتخاب بیمار قبل از عمل.

B- فاکتورهای مربوط به وسیله شامل: تعداد کانالها: عمق جایگذاری الکترود، زاویه چرخش رشته الکترودی دور مودیولوس، نحوه برنامه ریزی پردازشگر گفتار.

درین فاکتورهای وسیله عمق جایگذاری قویترین فاکتوری است که نقش مهم و برجسته ای در درگ گفتار دارد. در یک پروتز چند کاناله تعداد الکترودها یا جفت الکترودها متناسب با تعداد تمایزات بین فرکانسی است. روشن است که افزایش تعداد الکترودها تمایز فرکانسی را افزایش می دهد و درگ گفتار واضح تر و بهتر صورت می پذیرد (۲ و ۱).

#### عنوان مقاله:

پرسنی تغییرات درگ گفتار با کاهاش تعداد کانالهای فعال در بیماران کاشه حلزوں با ۲ پروتز

#### مؤلفین

۱. دکتر محمدمهدی قاسمی

(دانشیار گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس مرکز کاشه حلزوں شناوی خراسان)

۲. دکتر محمد تقی شاکری

(استادیار امار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

۳. دکتر سپیده راستا

(زبدهت گوش و حلق بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

۴. محمدرضا طالع

(شناوی شناس مرکز کاشه حلزوں شناوی خراسان)

۵. حمید طیرانی

(گفتار درمان مرکز کاشه حلزوں شناوی خراسان)

۶. علیت دارویز

(شناوی شناس مرکز کاشه حلزوں شناوی خراسان)

#### خلاصه

هدف: یکی از سؤالات اساسی در طراحی پروتز کاشه حلزوں شناوی این است که چند کانال قابل تحریک قادر است بیمار را به حداکثر دسترسی به درگ گفتار برساند اخیراً تحقیقات تحریبی در بالغین سعی نموده اند که این سؤال را پاسخ دهند. برای رسیدن به ۹۰٪ در محیط ساکت ۴ کانال برای جملات ساده مورد نیاز می باشد (دورمن سال ۱۹۹۷ و شانون ۱۹۹۵) پنج کانال برای درگ گفتار مشکلی که از صحبت چند نفر ایجاد می شود مورد نیاز است (لوینزو، ۱۹۹۹) ۸ کانال یا بیشتر برای درگ کلمات منوسیلاب لازم است (دورمن و همکارانش آماده برای چاپ).

مواد و روش ها: مطالعه ما با هدف مشخص کردن تعداد کانالهایی که جهت رسیدن به سطح بالایی از درگ گفتار (بدون لب خوانی) لازم است روی ۳۰ بیمار کاشه حلزوں با پروتزهای نوکلتوس ۲۲ کاناله و مدار ۴۰+ (COMBI) که حداقل ۶ ماه تربیت شنیداری - کلامی پس از کاشه داشتهند طرح ریزی شد.

تعداد مختلفی از کانالها تحریک شدند و تا مادامی که طیف کاملی از پنهانی باند وجود داشت کانالهای فعال کاهاش داده شد. ۵ نوبت الکترودهای فعال با تعداد کانالهای ۲۲، ۱۶، ۱۲، ۸ و ۴ برای پروتز نوکلتوس تحریک شد و ۳ نوبت نیز برای پروتز مدار با تعداد کانالهای

درک گفتار از مطالعه حذف شد.

در این مطالعه از آزمونهای مقایسه گروه همچون ANNOVA و TUKY استفاده شده است. با توجه به این که در تمامی موارد مطالعه عمق جایگذاری یکسان بود و تنها تفاوت هر مرحله با مرحله بعد فقط تعداد کانالهای فعال بود، هر شخص فقط با خودش مقایسه می شد لذا تمام فاکتورهای مربوط به بیمار یا پروتز که روی درک گفتار اثر گذارند از مطالعه حذف می شدند.

تنها متغیر مؤثر در مطالعه تعداد کانالها می باشد که متغیر مستقل و نتیجه آزمون گفتاری متغیر وابسته می باشد.

معیار اندازه گیری درک گفتار بازشناسی کلمات دوسیلابی بود. - گروه 22 Nucleus شامل ۵ مرحله بود:

- مرحله اول: تمام ۲۲ کanal فعال بودند.
- مرحله دوم: فقط ۱۶ کanal فعال بودند.
- مرحله سوم: تنها ۱۲ کanal از ۲۲ کanal فعال بودند.
- مرحله چهارم: ۸ کanal فعال بودند.
- مرحله پنجم: ۴ کanal فعال بودند.

- گروه Med-el شامل ۳ مرحله بود:

- مرحله اول: تمام ۱۲ کanal فعال بودند.
- مرحله دوم: فقط ۸ کanal فعال بودند.
- مرحله سوم: تنها ۴ کanal فعال بودند.

در این مطالعه از گرافی استنورث برای تأیید جایگذاری کامل رشته الکتروودی داخل حلزون استفاده شد.

آنالیز داده‌ها با نرم افزار SPSS انجام گرفته است.

## نتایج

این مطالعه نشان داد که کاهش تعداد کانالها تا یک حد مشخص درک گفتار را کاهش نمی دهد، اما پس از آن حد، کاهش قابل توجه در درک گفتار با کاهش تعداد کانالها در تمام بیماران و در هر دو گروه ایجاد می شود. میانگین نمرات درک گفتار در گروه 22 Nucleus به ترتیب عبارت بودند از: مرحله ۱: ۱/۸۴/۲۵٪، مرحله ۲: ۲/۷۹/۲۵٪، مرحله ۳: ۳/۷۶/۷۵٪، مرحله ۴: ۴/۵۱٪، مرحله ۵: ۱۱/۷٪ (نمودار - ۱)

میانگین نمرات در گروه Med-el عبارت بودند از:

مرحله ۱: ۱/۷۷/۲٪، مرحله ۲: ۲/۷۳/۸٪، مرحله ۳: ۴۰٪ (نمودار - ۲). در گروه Nucleus تفاوت معنی دار بین نتایج مرحله ۱ و ۲ (۱ و ۵)، (۲ و ۴)، (۲ و ۵)، (۳ و ۴)، (۴ و ۵) وجود دارد ( $p < 0.001$ ). نمرات میانگین درک گفتار در مرحله ۲۲، ۱۶ و ۱۲ کanalه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

**جدول ۱** جدول میانگین نتایج درک گفتار در حالت‌های مختلف تعداد کانال در پروتزهای Med-el و Nucleus.


Channel number	4	8	12	16	22
nucleus	18.70%	51%	76.57%	79.25%	84.25%
Med-el	40%	73.8%	77.2%		

مراحل تفکیک آمپلیتود (Amplitude resolution steps) و سرعت تحریک (Stimulus Rate) ۲ پارامتر عمده اثر گذار در درک گفتار در یک پروتز چند کanalه هستند (۷ و ۸). آزمونهای گفتاری که درک گفتار را اندازه گیری می کنند متعددند. آزمون بازشناسی جمله آنقدر ساده است که با استفاده از آن نمی توان بی برد بیمار از چند کanal برای تمایز فرکانسی استفاده می کند. بنابراین درک گفتار واقعی بیمار را نشان نمی دهد. برای این منظور بازشناسی کلمات مونو سیلاب یا دو سیلابی مناسب ترند (۱). در سالهای اخیر برای هر نوع پروتز بیشتر از یک نوع استراتژی پردازش گفتار مورد استفاده قرار گرفته که مطلوبتر بوده است. درک گفتار با یک برنامه ثابت پردازش گفتار در یک پروتز چند کanal به یک خط مماس یا کفه (asymptote level) می رسد که تعداد کانالها برای رسیدن به این سطح در مورد مصوبات ها، واکه ها، مونو سیلاب، دو سیلاب و جمله فرق دارد و افزایش تعداد کانالها بیشتر از این سطح تغییری در درک گفتار ایجاد نمی کند (۱ و ۲).


## مواد و روشها

۲۰ بیمار با 22 Nucleus و ۱۰ بیمار با Med-el (COMBI 40+) این مطالعه انتخاب شدند که معیارهای انتخاب برای کاشت در هر دو گروه یکسان بود. تمام آنها حداقل ۶ ماه تحت تربیت شنیداری - کلامی پس از کاشت قرار داشتند. جایگذاری رشته الکتروودی در همه بیماران دو گروه کامل بود و تمامی کانالها فعال بودند. لازم به ذکر است که پروتز 22 Nucleus دارای ۲۲ کanal و پروتز (۱) Med-el دارای ۱۲ کanal فعال می باشد.

متوسط سن در گروه 22 Nucleus ۷/۷ (سال  $\pm 2/4$  = انحراف معیار) و در گروه (۱) Med-el ۷ سال (سال  $\pm 2/3$  = انحراف معیار) بود. کاهش تعداد کانالها با خاموش کردن برخی از کانالها که شامل ۴ مرحله برای 22 Nucleus و ۲ مرحله برای گروه (۱) Med-el بود انجام شد. در تمامی مراحل کاهش تعداد، عمق کامل جایگذاری حفظ می شد و خاموش شدن الکتروودها به صورت پراکنده صورت می گرفت تا اثری بر روی عمق جایگذاری نداشته باشد. بنابراین اثر عمق جایگذاری روی

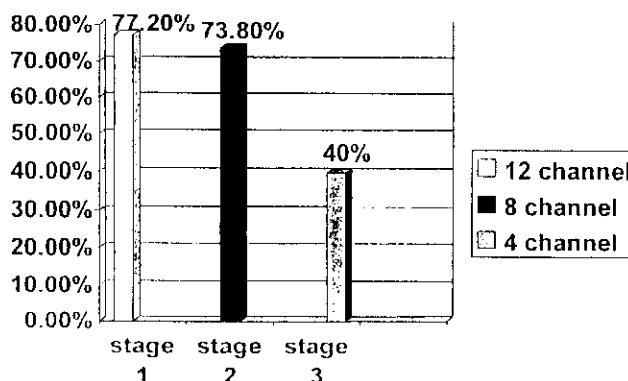

نمودار ۲ مقایسه اثر تعداد کانالهای فعال در پروتز COMBI40+(+) روی نتایج درک گفتار به صورت درصد پاسخهای صحیح به کلمات دوسیلابی.

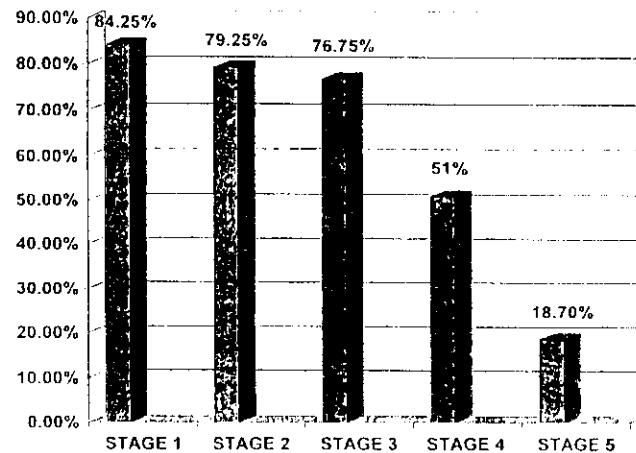

نمودار ۱ مقایسه اثر تعداد کانالهای فعال در پروتز Nucleus روی نتایج درک گفتار به صورت درصد پاسخهای صحیح به کلمات دوسیلابی.

Faulkner و همکاران در یک مطالعه روی افراد با شنوایی نرمال در محیط با Noise متوسط نشان دادند که خط مماس درک گفتار برای مصوتها، واکه‌ها و جمله‌های کانال بود و افزایش تعداد کانالها بیشتر از ۸ عدد هیچ تفاوتی در آزمون شونده ایجاد نکرد (۶). با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات فوق و مقایسه آن با نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که عدد ۱۲-۸ تقریباً یک عدد ثابت برای رسیدن به بهترین سطح مطلوب درک گفتار می‌باشد که در مطالعه‌ها روی کودکان با متوسط سن ۷ سال در هر دو گروه نیز به این رقم رسیده‌ایم.

نکته جالب توجهی که در مقایسه بین دو گروه Nucleus و Med-el وجود دارد تفاوت ۴ کانال برای رسیدن به سطح مماس است.

تفاوت بارزی در درک کلمات بین مراحل ۸ کاناله و ۴ کاناله در این دو گروه وجود دارد که تفاوت در مراحل ۸ کاناله از لحاظ آماری معنی‌دار است ( $p < 0.05$ ) اما بین مراحل ۴ کاناله معنی‌دار نیست.

تجوییه این تفاوت را می‌توان در عمق تربون جایگذاری الکترود Med-el نسبت به Nucleus دانست، چرا که عمق جایگذاری در Med-el ۲۱<sup>mm</sup> و در Nucleus ۱۷<sup>mm</sup> می‌باشد که ۱۴<sup>mm</sup> کمتر است.

بنابراین با توجه به مطالعی که در مقاله قبل در مورد اثر عمق جایگذاری ارائه شد مکان الکترودها در پروتز Med-el به ناحیه فرکانسی آناتومیک مربوط به خود در حلزون نزدیکتر بوده و تمایز فرکانسی بهتر صورت می‌گیرد لذا پروتز Med-el با ۸ الکترود سطح یکسانی از درک گفتار را معادل ۱۲ الکترود در پروتز Nucleus ایجاد می‌کند (نمودار -۳).

### نتیجه‌گیری


نتایج نشانگر این است که در کودکان کاشت شده برای رسیدن به خط

در حالی که بین این مراحل و مراحل ۸ و ۴ کاناله تفاوت معنی‌داری در درک کلمات دوسیلابی وجود داشت همچنین بین مرحله ۸ و ۴ کاناله هم تفاوت معنی‌دار بود. بنابراین خط مماس یا کافه در درک کلمات دوسیلابی در پروتز Nucleus مرحله ۱۲ کاناله می‌باشد که کاهش بیشتر از این تعداد باعث کاهش معنی‌دار در درک گفتار می‌شود. در گروه Med-el تفاوت معنی‌داری بین درک گفتار کلمات دوسیلابی در مراحل ۱۲ و ۸ کاناله وجود نداشت اما بین این مراحل و مرحله ۴ کاناله تفاوت معنی‌داری بود پس خط مماس (asymptote) در درک کلمات دوسیلابی در پروتز Med-el مرحله ۸ کاناله می‌باشد.

### بحث

تابه حال هیچ تحقیقی در مورد خط مماس یا همان asymptote در درک کلمات دوسیلابی روی بچه‌های کاشت شده انجام نشده است. در تحقیقات Dorman و Iozou روی افراد با شنوایی نرمال و بیماران کاشت حلزون نشان داده‌اند پردازشگر گفتار با ۸ کانال می‌تواند درک گفتار معادل با پردازشگرهای با تعداد کانالهای بیشتر در افراد کاشت شده ایجاد کند (۳).

در مطالعه دیگری از همین متخصصین روی افراد با شنوایی نرمال ۸ کانال برای درک مصوت‌ها ۴ و ۵ کانال برای درک جملات لازم داشته شده است. به خاطر تفاوت‌های تکاملی زبان آموزی بین ناشنواستان بالغ و کودک برای رسیدن به asymptote level یا خط مماس در درک گفتار، در تعداد کانالهای لازم تفاوت وجود دارد. در یک مطالعه اطفال ۴ کانال بیشتر از بالغین برای رسیدن به ۸۰-۹۰٪ از بازشناسی کلمات نیاز دارند و ۸-۱۲ الکترود (کانال) برای رسیدن به این منظور مناسب دانسته شده است (۴).

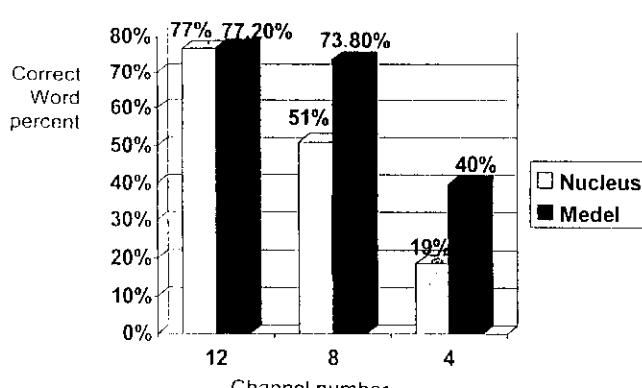

**نمودار ۳ مقایسه میانگین نتایج درک گفتار در حالت‌های ۱۲ کانال، ۸ کانال و ۴ کانال در پروتز Med-el با Nucleus**

مماض در درک گفتار (حداقل برای درک کلمات دوسیلابی) بسته به نوع پروتز ۱۲-۸-۴ کانال لازم است که در این مطالعه برای پروتز ۸ Med-el ۲۲ کانال و برای پروتز ۱۲ Nucleus ۱۲ کانال می‌باشد. کاهش تعداد کانالها از ۱۲ در Nucleus و از ۱۲ تا ۸ در el-Med تفاوت معنی‌داری در درک کلمات ایجاد نکرد اما کاهش بیشتر از این مقادیر تفاوت قابل ملاحظه و ناگهانی در درک کلمات ایجاد می‌کرد. در پروتز ۸ Med-el به خاطر عمق جایگذاری بیشتر با تعداد کانالهای کمتر از پروتز Nucleus قادر به رسیدن به خط مماض در درک کلمات می‌باشیم.

## Reference

1. Dorman Michel. F "speech perception by adults" in "cochlear implants" Walstman Susan. B, Cohen Noel. (3230324).
2. Dorman Michel. F, Loizou Phillip. c"speech intelligibility as a function of the number channels of stimulation for normal-hearing listeners and patient with cochlear implants" 1997. the Am. J otology (18: s113-s114).
3. Dorman. M, Loizou. P, Kemp. L, Kirk. K. "word recognition by children listening to speech processed into small number of channels" (1999. www. utdallas. edu/ loizou/cimplants/children. html)
4. Dorman Michel. F "speech perception by adults" in" cochlear implants" Walstman Susan. B, Cohen Noel. (321-322).
5. Dorman. M.F, Loizou. P, Rainey. D. "speech intelligibility as a function of the number of channel of stimulation for signal processors using sine wave and noise-band out puts" PMID: 9348698 [Pub med].
6. Faulkner. A, Rosen. S, Wilkinson. L "Effect of the number of channels ad speech-to-noise ratio on rate of connected discourse tracking through a simulated cochlear implant spech processor" Ear & Hearing 2001; 22; (431-438).
7. Kiefer. Jan, Von Ilberg. CHristoph, Rupprecht. Vittoria, Haber. Egenery, Baumgartner. W, Gstoettner. W, Forgasi K, Stephan. K. "optimized speech understanding with the speech coding strategy in cochlear implants: the effect of variations stimulus rate and number of channels" in" cochlear implants" Waltsman Susan. B, Cohen Noel L. (339-340).
8. Loizou. P, Dorman. M, Tu. Z "On the number of channels needed to understand speech" 1999. www. utdallas. edu/ loizou/cimplants / channels. pdf.