

## ابداع روش فلوریمتری برای گیرنده‌های فاکتور رشد عصب انسان جهت شناسائی بیماریهای دژنراتیو مغز و اعصاب

دکتر ابوالفضل نظریان \*

### خلاصه:

عامل رشد عصب NGF (Nerve Growth Factor) نقش اساسی در رشد، تکامل و حفظ حیات سلولهای عصبی بویژه نرونهاي حسی (گیرنده درد) و نرونهاي سمپاتیک در سیستم محیطي و نرونهاي کولینرژیک در ناحیه فوربرین در سیستم مرکزی دارد. فعالیت بیولوژیکی NGF طی برهم کنش اختصاصی با نواحی خارج سلولی دو گروه از گیرنده‌های ویژه NGFR (NGFR) آغاز می‌گردد. تولید گیرنده‌های رشد عصب در دژنراسیون‌های عصبی از قبیل آنزايمر، پارکینسون و اسکلروز افزایش می‌یابد و بخش خارج سلولی گیرنده‌های رشد عصب بصورت محلول (T-NGFR) در آمده و در مایعات بیولوژیک مانند ادرار انتشار می‌یابد که در مقایسه با افراد سالم مقدار قابل توجهی دارد، لذا سنجش T-NGFR مایعات بیولوژیک می‌تواند بعنوان شاخص در تعیین روند دژنراسیون عصبی بکار گرفته شود.

در این بررسی شیوه جدیدی با ابداع فلوریمتری هموژن (۲)، مقادیر فوق العاده پایین را در ادرار (T-NGFR) با سهولت، سرعت و دقت زیادی اندازه‌گیری می‌نماید.

NGF خالص شده از غدد تحت فکی موش با فلورسین نشان دار گردیده سپس بر علیه NGF نشان شده خالص (F-NGF) یک آتنی بادی در خرگوش تهیه شده است که اصطلاحاً آتنی فلورسین نام دارد.

به محض برهم کنش F-NGF با آتنی فلورسین در سرم خرگوش فلورسانس F-NGF عمدهاً فرونشانده می‌شود. اما چنانچه مقداری از نمونه ادرار بیمار در مخلوط مورد آزمایش افزوده شود، از خاموش شدن فلورسانس ممانعت بعمل می‌آورد. این پدیده اتصال F-NGF را با T-NGFR در ادرار بیمار اثبات می‌کند که آتنی فلورسین قابلیت پیوند به این کمپلکس را ندارد بطوریکه با سنجش نتایج فلورسانس در مخلوط مورد آزمایش مقدار T-NGFR در ادرار قابل محاسبه می‌باشد و برخلاف روش‌های متداول نیازی به جدا سازی وجود ندارد.

در نتیجه با بکارگیری F-NGF و آتنی فلورسین مقدار T-NGFR در ادرار بیماران بدست آمده و در مقایسه با نمونه ادرار فرد سالم روند دژنراسیون عصبی در مراحل اولیه بیماری بدست می‌آید. این روش به لحاظ کیفی و حساسیت نیز ارزیابی شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، فاکتور رشد عصب، گیرنده‌های محلول، فلوریمتری

\* متخصص بیوشیمی بالینی، عضو هیأت علمی بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی استان زنجان

[www.SID.ir](http://www.SID.ir)

**مقدمه :**

موجود در ادرار می‌توانند بطور اختصاصی به F-NGF متصل گردیده و از واکنش آنتی بادی به آن ممانعت نمایند و فلورسانس را افزایش دهند، چون افزایش فلورسانس با میزان T-NGFR در نمونه ادرار مورد آزمایش مناسب است، لذا گیرنده‌های محلول بطور غیر مستقیم اندازه‌گیری می‌شوند. روش فلوریمتری که بر اساس ممانعت از کوئینچ فلورسانس در مورد پروتئینهای دیگر خون مانند سرم آلبومن توسط Nargessi et al (۹) انجام شده بود؛ برای اولین بار برای گیرنده‌های NGF طراحی شد. پایداری آنتی فلورسین (Ant-F) و F-NGF در طول آزمایش ثابت بوده، قابلیت تکرار پذیری و درصد اطمینان این روش بسیار خوب بود. ویژگی اتصال F-NGF با Ant-F و T-NGFR بوسیله روش ژل دیفیوژن نیز مورد تأیید قرار گرفت (۱۰).

**مواد و روشها :****مواد مهم :**

7SNGF, FITC (Flourescein Isothiocyanate Acrylamid, bis - acrylamide , Freunds adjuvant (complete and incomplete) Tween-80 , Tris (Hydroxy methyaminomethan) , DEAE Cell , Sephadexes (G25-100, 200)

(از شرکت‌های سیگما و واتمن )

**روش‌ها :**

۱ - خالص سازی فاکتور رشد عصب 7S-NGF مطابق روش Varon (۱۱) از غدد بزاقی موش نر در طی سه مرحله کروماتوگرافی توسط بافر ۰.۵ مولار

فاکتور رشد عصب NGF برای رشد، تکامل و حیات نرونی‌های حسی، سمپاتیک و کولینرژیک ضرورت دارد (۱). NGF در سلولهای هدف دارای دو نوع گیرنده (TrkA, P75) می‌باشد (۲ و ۳)، که علیرغم تفاوت‌های ساختمانی و میل ترکبی (Kd) هر دو به NGF متصل می‌شوند و طبق فرضیات و مدل‌های ارائه شده برای انتقال بهینه پیام NGF، همراهی و هماهنگی آنها اهمیت بسیار دارد (۴).

تولید NGF و گیرنده‌های آن در دوران جنینی و تکامل در سطح بالائی قرار داشته که علت آن هم وابستگی نرونها در سیستم عصبی مرکزی و محیطی به این فاکتور رشد می‌باشد (۵)، ولی در سنین بلوغ تولید NGF و گیرنده‌هایش در سطح پائین نگهداری می‌گردد. صدمات وارده به نرونها در بیماریهای تروندزیراتیو سنتز مجدد آنها را تحریک کرده روند انتشار گیرنده‌ها بصورت محلول T-NGFR بطرور قابل توجهی افزایش می‌باید (۶ و ۷). طبق تحقیقات محلول سازی گیرنده‌ها در اثر پروتئازهای معینی صورت می‌گیرد و توسط مهار کننده‌های آنزیمی می‌توان از آن ممانعت کرده و از سیر تخریب نرونها جلوگیری کرد (۸). لذا به نظر می‌رسد گیرنده‌های محلول، شاخص بسیار خوبی در تشخیص بیماریهای نروندزیراتیو محسوب می‌شوند که با توجه به ترشح مقدار زیادی از آنها در مایعات بیولوژیک (ادران) بخوبی قابل تشخیص می‌باشند.

در این تحقیق با ابداع روش فلوریمتری فاکتور رشد عصب پس از خالص سازی بوسیله فلورسین نشاندار شده (F-NGF) در غلظت نانو گرم قابل اندازه‌گیری می‌باشد، یک آنتی بادی بر علیه F-NGF تولید گردیده فلورسانس آن را کوئینچ می‌نماید. گیرنده‌های محلول

F-NGF با Ant-F ممانعت می‌کند. چندین غلظت از نمونه ادرار که با روش کروماتوگرافی تعویض یونی، بطور نسبی خالص و تغليظ گردیده بود مدتی قبل از افزودن Ant-F به مخلوط آزمایش وارد گردید. درصدهای فلورسانس بر اساس میزان T-NGFR موجود در ادرار محاسبه گردید.

۶- ایمونو دیفیوژن: ویژگی اتصال F-NGF با Ant-F و T-NGFR در محیط نیمه جامد آگاروز٪۱ بدرو صورت یک بعدی و دو بعدی انجام گردید (۱۰، ۱۳).

۷- الکتروفورز SDS-PAGE: فراکشن‌های NGF پس از خالص سازی، با نمونه استاندارد (sigma) در الکتروفورز SDS-PAGE مطابق روش Lammeli (۱۴) در مقایسه با سرم آلبومین انجام شد.

۸- تشخیص بیماری نرو دژ نراتیو: تعداد ۴۰ نفر از بیماران نرو دژ نراتیو، افراد ظاهرآ سالم (نرو دژ نراتیو مشکوک) و افراد سالم در دو گروه سنی پائین و بالاتر از ۶۰ سال از زنان و مردان با روش ممانعت از کوئینج فلورسانس آزمایش و میانگین غلظت گیرنده‌های محلول آنها تعیین شدند.

۹- آزمونهای کسترن کیفی: دقت آزمایشات فلوریمتری در یک روز و روزهای متواتی، میزان ویژگی، حساسیت، کارائی، تکرار پذیری و محدوده اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفتند.

#### نتایج:

G-25 F-NGF پس از ژل فیلتراسیون با سفادکس ۰.۰۵۰M PH=۷.۴ در طی نتوء Elute شده توسط تریس ۲۸۰nm موج از نظر فلورسانس در EM=۵۱۵ nm و جذب طول

تریس ۷/۴ PH= انجام گردید، نحوه استخراج خالص سازی ۷S-NGF بطور خلاصه در شکل (۱) نشان داده است.


۲- نشاندار کردن ۷S-NGF مطابق روش Nargessi et al (۹) با اتصال فلورسانین به نسبت (۱:۱) به NGF بمدت یک شب انکوباسیون در سرد خانه انجام شد و خالص سازی F-NGF از FITC مازاد با دو بار ژل فیلتراسیون با سفادکس ۰.۲۵G انجام گردید، نمودار (۱).

۳- تهیه آنتی بادی پلی کلونال (Ant-F) Freund's F-NGF ۱/۵(mg/ml) کامل بصورت امولسیون زیر پوستی در خرگوش نر مطابق روش Landon et al (۱۲) تزریق شد. تزریق‌های یادآوری شده (Boosts)، به ترتیب با غلظت ۰/۸۵ mg/ml و ۰/۴ و ۰/۰ به حجم برابر آجوانات ناکامل در فواصل یکماهه صورت گرفت، ۱۰ روز پس از آخرین تزریق، تیتر آنتی بادی در سرم خرگوش ایمن در مقایسه با خرگوش غیر ایمن (کنترل) با فلوریمتری معین شد. (نمودار ۲).

۴- فلوریمتری: خصوصیات فلوریمتری برای واکنش مناسب F-NGF با Ant-F از نظر نوع بافر، PH، زمان انکوباسیون و غلظت‌های F-NGF و Ant-F در بافرهای تریس، بیکربنات، استات حاوی Tween-۸۰ و ۰/۱۵۳M، کلوروسدیم انجام شد Perkin Elmer LS3، USA در طی ۴۹۵nm موجهای EX=۴۹۵nm، EM=۵۱۵، نتایج مشاهده می‌شود.

۵- ممانعت از کوئینج فلورسانس بوسیله T-NGFR: نمونه ادرار حاوی T-NGFR از واکنش

## 7S - NGFpreparation Procedures

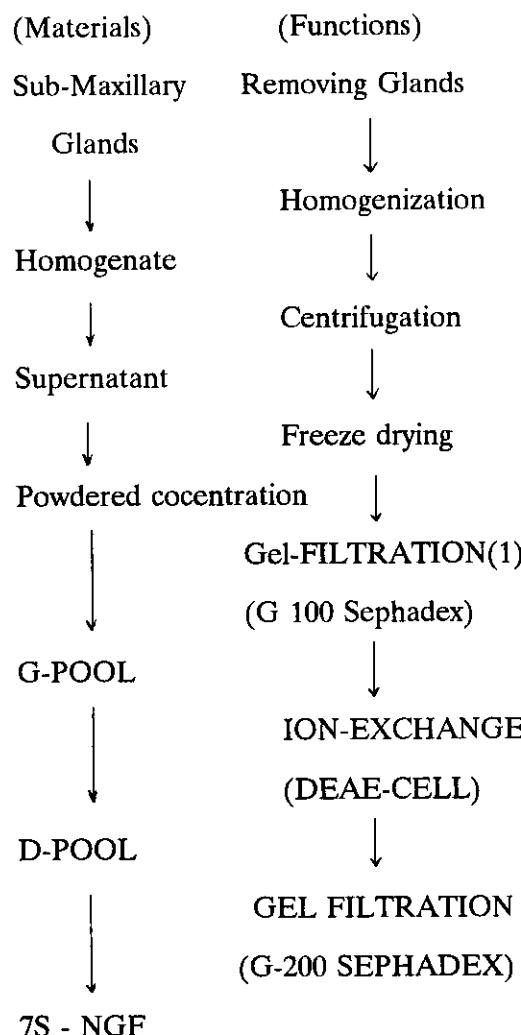

شکل شماره ۱:

نحوه استخراج و خالص سازی 7S-NGF.

بحث:

ارائه روش فلوریمتری برای اندازه‌گیری T-NGFR در بیماران نرودژنراتیو راه یابی به تشخیص سریع و آسان این بیماران در مقایسه با روش‌های پرخرج و طولانی می‌باشد. نمونه‌گیری از بیماران با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. در این تحقیق پایداری فلورسانس F-NGF از نظر حساسیت فلورسین بعنوان هاپتن متصل شده به فاکتور رشد طی شش ماه آزمایش‌های مداوم دارای میانگین فلورسانس

شدن NGF بوسیله فلورسین می‌باشد.


قابلیت کوئینچ فلورسانس سرم خرگوش ایمن شده حاوی Ant-F در رقت ۱/۲۰۰ می‌تواند ۵۰ درصد از فلورسانس F-NGF را کوئینچ نماید نمودار (۲). شرایط مطلوب برای فلوریمتری در بافرهای pH ۰.۰۶ Acetate , Bicarbonate Tris و ۸/۵ و ۵/۲۵ در مدت انکوباسیون ۱ دقیقه در دمای آزمایشگاه در نمودار (۳) مشاهده می‌شود. غلظت مطلوب برای F-NGF در فلوریمتری در نمودار (۴) ارائه شده است .

مانعنت از کوئینچ F-NGF بوسیله T-NGFR مسهمترین آزمایش در این تحقیق بود در نمودار (۵) مشاهده می‌شود که با افزایش حجم ادرار یا بعبارت دیگر افزایش میزان T-NGFR، فلورسانس متناسبًا زیاد شده است .

الگوی الکتروفورز 7S-NGF، فراکشن‌های مراحل مختلف کروماتوگرافی، آلبومین خالص و 7S-NGF استاندارد (سیگما)، تفاوت تحرک الکتروفورزی و زیر واحدهای پروتئینی را در نمونه‌های مربوطه در شکل (۲) نشان داده شده است .


بیماران نرودژنراتیو در مقایسه با افراد کنترل در دو گروه پائین و بالاتر از ۶۰ سال مورد مقایسه قرار گرفتند.

میانگین غلظت T-NGFR در بیماران نرودژنراتیو پیشرفتی بیش از (ng/ml) ۴۰۰ و در بیماران ابتدائی حدود (ng/ml) ۳۰۰ و در افراد سالم کمتر از ۲۰۰ است و از لحاظ جنسی در زنان و مردان اختلاف معنی داری مشاهده نمی‌شود  $P < 0.05$  که در نمودار شماره ۶ ارائه گردیده است.

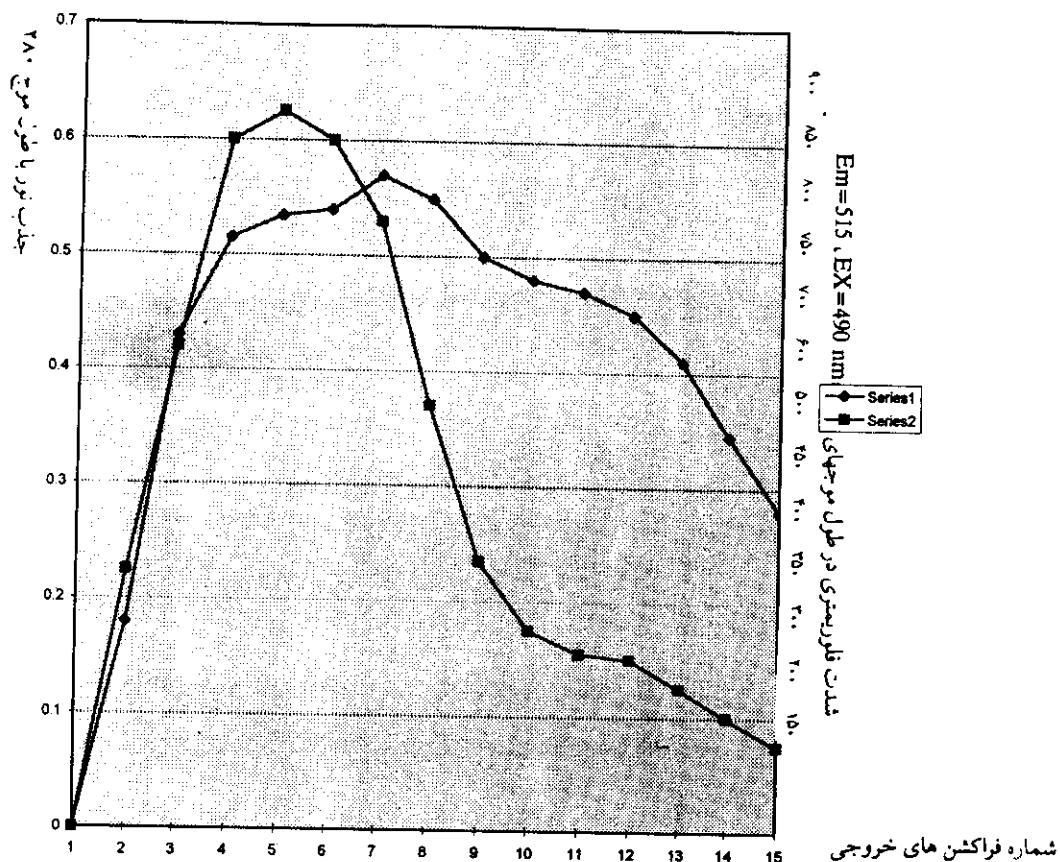


نمودار شماره ۱: کروماتوگرافی با G-25، برای خالص سازی FITC-F-NGF از U.V

فلورسانس ۲

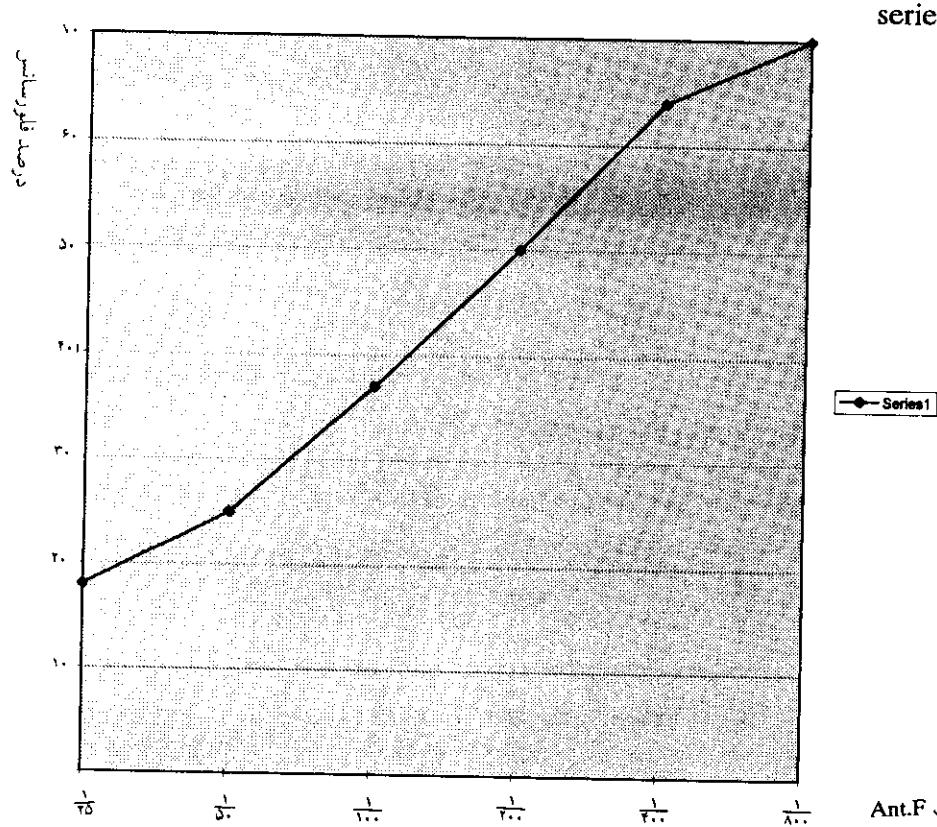


نمودار شماره ۲: انتخاب رقت مناسب از F-Ant (آنتی فلورسین) جهت بکارگیری در آزمایش فلوریمتری

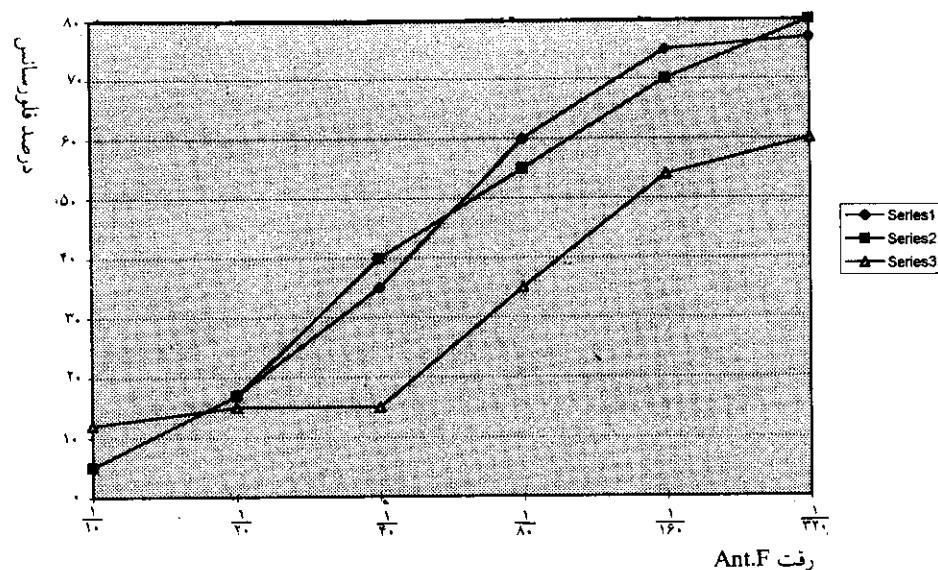


نمودار شماره ۳: تیتراسیون آنتی فلورسین در بافرهای مختلف

PH = 5.28 بافر series 3      PH= 8.5 بافر بیکربنات series 2      PH=7.4 بافر series 1

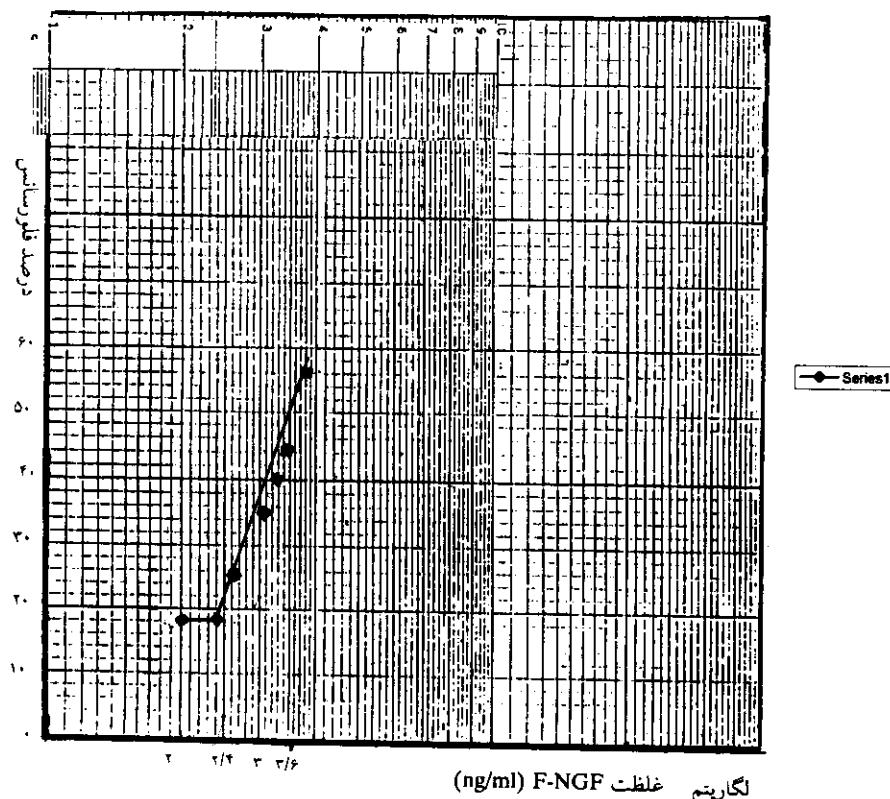


نمودار شماره ۴: تعیین غلظت مناسب F-NGF تغییرات فلورسانس پس از ۱۰ دقیقه انکوباسیون در حرارت

آزمایشگاه در ۳ میلی لیتر بافر تریس در رقت ثابت ۱/۶۰ F-NGF و لگاریتم غلظت‌های

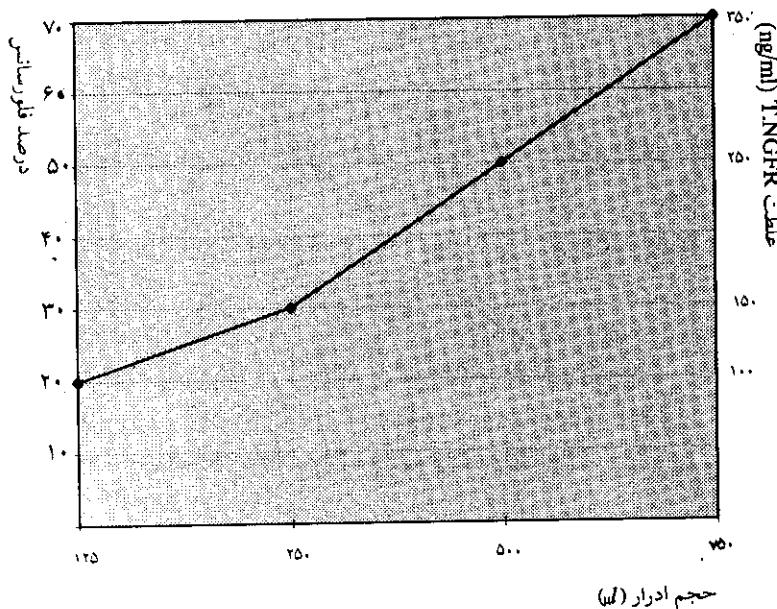


نمودار شماره ۵: انتخاب حجم نمونه ادرار حجم‌های ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ میکرو لیتر از بیماران و شاهد با سه تکرار ؛ با افزایش گیرنده‌های محلول، ممانتع بیشتری از کوئینچ فلورسانس صورت گرفته که غلظت آنها را نشان می‌دهد.


شکل شماره ۲: الکتروفورز (SDS-PAGE) NGF در روند خالص سازی  
در ۱۵٪ ژل پلی آکریلامید ناپیوسته مطابق روش Laemmli (146)

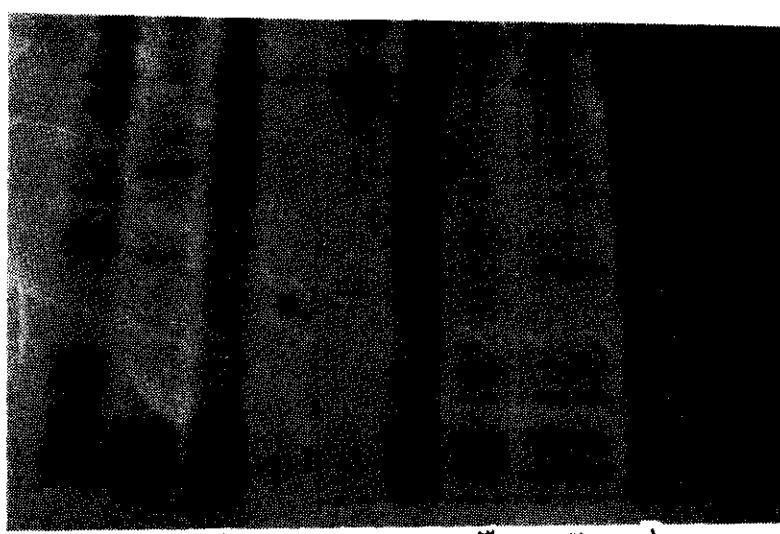

- 1 - G\_100 pool
  - 2 - 7S-NGF خالص شده
  - 3 - 7S-NGF خریداری شده از سیگما
  - 4 - فراکشن ۱۰۰ - G
  - 5 - سرم آلبومین گاوی (BSA) خالص
  - 6 - F-NGF
  - 7 - DEAE-pool (Nacl) ۰/۰۸ مolar
  - 8 - فراکشن D در اثر ۰/۳ مolar Nacl
  - 9 - سوب حاصله پس از سانتریفیوژ
- هموزن غدد بزاقی

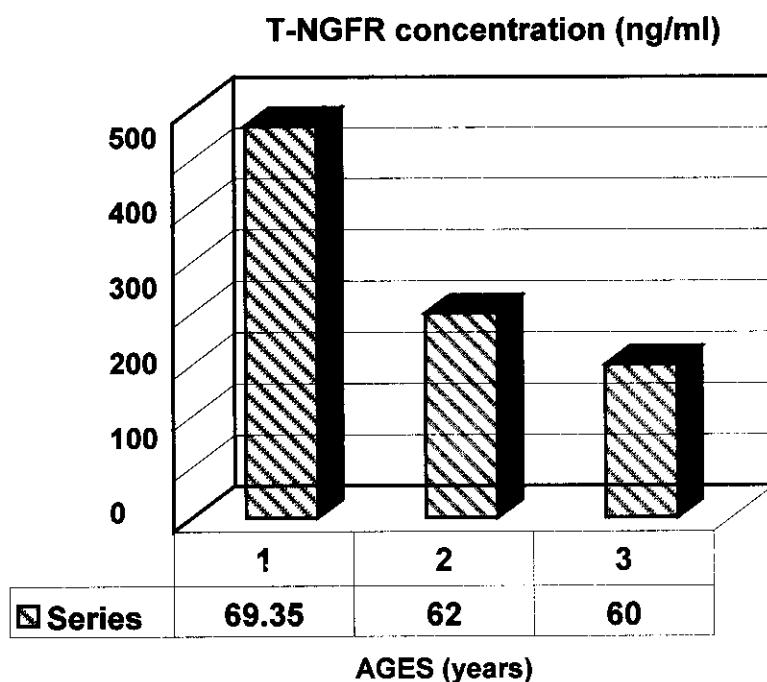


نمودار شماره ۶ : مقایسه غلظت گیرنده‌های محلول در نمونه‌های مختلف بیماران ظاهرآ سالم (مشکوک) : Series 2  
 بیماران نرودژنراتیو : Series 1  
 افراد سالم (کنترل) : Series 3

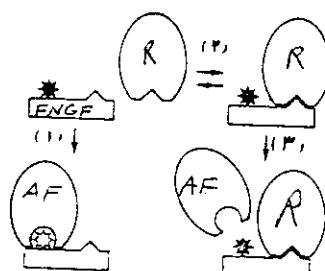

R : T-NGFR

AF: Ant . F

- شکل شماره ۳: شمای ساده از کنش متقابل آنتی فلورسین و گیرنده محلول با آنتی ژن نشاندار F-NGF
- ۱) واکنش آنتی فلورسین با آنتی نشاندار منجر به کوئینج می‌گردد.
  - ۲) کنش گیرنده محلول با آنتی ژن نشاندار تأثیری در فلورسانس ندارد.
  - ۳) پس از اتصال گیرنده محلول با آنتی نشاندار از کنش آنتی فلورسین ممانعت بعمل می‌آید.

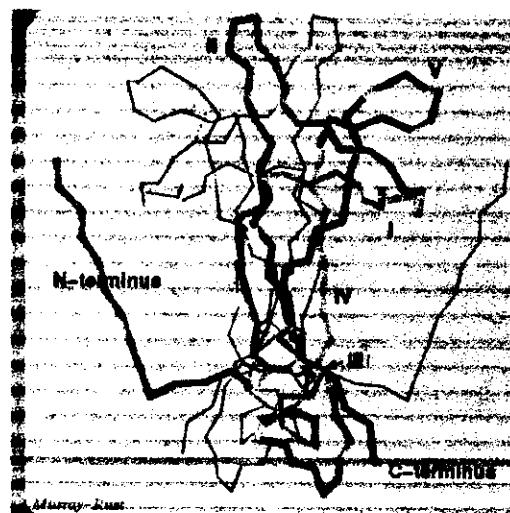

شکل شماره ۴: تصویر فضائی پروتومرهای آنتی پارال NGF

SHFA در شکل (۳) ارائه گردیده است. مداخله آنتی فلورسین با گیرنده محلول از نظر اتصال با F-NGF با مطالعات ساختمان مولکولی (۱۵)، آشکار گردیده است. پروتومرهای آنتی پارال NGF که به صورت دیمر از زنجیره‌های متعدد B-sheet تشکیل شده‌اند، دارای لوپ‌های قابل دسترس می‌باشند، این لوپ‌ها دارای توالی‌های متغیر و خاص از اسیدهای آمینه در نروتروفین‌ها می‌باشند و بعنوان مکانهای ویژه اتصالی با گیرندهای محلول گزارش شده‌اند، شکل (۴). یکی از لوپ‌های مهم در NGF سه توالی LYS 95, LYS 34, LYS 32 است. اسیدهای آمینه بارداری که برای اتصال با T-NGFR اختصاص دارند و در عین حال در معرض اتصال با فلورسین قرار گرفته‌اند، T-NGFR بعلت کوچکی مولکول نمی‌تواند فلورسانس آنها را بپوشاند و به لحاظ ممانعت فضائی از ورود Ant-F-NGF جلوگیری می‌کند، اما در F-NGF های آزاد، این آنتی بادی قابلیت اتصال و پوشاندن فلورسانس را دارد.

دقت (Precision): اندازه‌گیری نمونه‌های مختلف در

$59 \pm 12$  در غلظت (ng/ml) بود و از طرف دیگر Ant-F قابلیت کوئینج نسبتاً ثابتی در طول آزمایشات با میانگین  $46/37 \pm 5$  در رقت  $1/200$  بود. نمونه ادرار صحبتگاهی در حجم ۵/۰ میلی لیتری برای آزمایش ممانعت از کوئینج مناسب بود.

روش مایک فن فلوریمتری هموژن متولی Sequential Homogenous Fluoroimmuno Assay (SHFA) است که پس از واکنش T-NGFR با F-NGF یک کمپلکس متصل تشکیل می‌گردد که Ant-F را نمی‌پذیرد و Ant-F-NGF (آزاد) متصل شود و با این عمل باقیمانده F-NGF (آزاد) متصل شود و با این عمل فلورسانس F-NGF های آزاد را حذف می‌کند، لذا در این روش به مرحله جدا سازی نیاز نمی‌باشد و با اندازه‌گیری مخلوط هموژن، مقدار گیرنده‌های محلول در نمونه‌های ادرار قابل سنجش می‌باشد در حالیکه در روش‌های متداول مرحله وقت گیر جدا سازی، اجتناب ناپذیر است. از نکات منفی این روش، دخالت فلورسانس ادرار است که با استفاده از محلول شاهد از نمونه ادرار بر طرف می‌گردد. نمایش ساده‌ای از روش

- 4 - Hantzopoulos , P.A (1994) , J.Biol . Chem . 270:1230-1235.
- 5 - Katoh - Sembal, R (1989), J. Neurochem. 52: 1557-1565.
- 6 - Muffson, E. J & Kordower, J.H. (1992) , P . N.A.S (USA), 89: 569-573.
- 7 - Distefano , P.S. & Glagettam , D.M .(1991) , Ann . Neurol .29:23-20.
- 8 - Distefano , P.S.& Chelsa , D.M. (1993) , J.Neuroscii . 13:2405-2414.
- 9 - Nargessi , RD. & Landon , J.(1979) , J. Immunol. Methods , 26: 307-313.
- 10 - Watts , G.F. & Bennett , J.E. (1986) , Cln. Chem. 32 : 1544-1548.
- 11 - Varon , S., Nomura, J.& Shooter , E. M. (1967), Biochem . 6: 2202-2209.
- 12 - Landon , J . & Moffat , A.C. (1976) , Analyst , 101 : 225-243.
- 13 - Ochterlony , Q (1949) , Acta, Path. Microbiol. 26: 507 - 516 .
- 14 - Lammeli , U.K.(1970), Nature, 227: 680-685.
- 15 - Kruttgen, A. & Heymach, J.V.(1997) , J.Biol. Chem . 272: 29222-29228.

یک روز ( inter assay ) با  $CV\% = 3-6/5$  و در روزهای مختلف ( inter assay ) با  $CV\% = 2-7$  بود. تفاوت واریانس‌ها دارای  $P > 0.05$  و معنی دار نمی‌باشد. حساسیت آزمایش  $93/75\%$  با ویژگی  $85\%$  و کارائی  $90\%$  است. با توجه به حساسیت فوق العاده روش فلوریمتری در مقایسه با اسپکتروفوتومتری و استفاده از واکنش ایمنی تا غلظت ( ng/ml ) از ۱۰۰ در نمونه قابل اندازه‌گیری می‌باشد. T-NGFR

#### سپاسگزاری :

بودجه این پروژه تحقیقی توسط معاونت پژوهشی دانشکده علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأمین گردیده و با همکاری صمیمانه دست اندکاران این دانشکده بویژه گروه بیوشیمی بالینی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر مصری پور به شمر رسیده است، که بدینوسیله از کلیه عزیزان و سروران سپاسگزاری می‌گردد.

#### کتابنامه :

- 1 - Greene , L.A. & Shooter E.M. (1980), Ann . Biochem , 3 ; 353-362.
- 2 - Mahadeo , D. & Kaplan, T. (1994) , J. Biol. Chem. 269: 6884-6890.
- 3 - Schatteman, G. C & Langer , T . (1993) , Somatosens , Mol . Res , 10: 415-425.