

مقایسه‌ی دو روش مولکولی PCR و LAMP در تشخیص سالمونلا

ابوبکر مرادی^۱، دکتر علی کرمی^۲، دکتر علی حق‌نظری^۳، زینب احمدی^۴، دکتر رحیم سروری‌زنجانی^۵، سیده مهری جوادی^۶

نویسنده‌ی مسؤول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی Karami@bmsu.ac.ir

پذیرش: ۸۷/۲/۲۸ دریافت: ۸۷/۲/۱۶

چکیده

زمینه و هدف: روش‌های مختلفی جهت تشخیص سالمونلا وجود دارد. اما روش‌هایی که بر پایه‌ی ژنوم و DNA هستند، تکنیک‌های بهتری جهت تشخیص می‌باشند. PCR روشی سریع و حساس است و به علت کارایی بالا به طور گستردگی در تشخیص سریع پاتوژن‌ها به کار گرفته می‌شود. اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد (استفاده از دستگاه‌های مربوطه زمان و هزینه زیادی را می‌طلبد)، به همین دلیل جهت رفع این مشکلات روشی به کار گرفته شد که معایب روش‌های مبتنی بر PCR را به حداقل برساند.

روش بررسی: در این بررسی از روش تکثیر هم دمایی وابسته به حلقه (LAMP) استفاده شد و با PCR مورد مقایسه قرار گرفت. برای مقایسه‌ی PCR و LAMP از ۷ سویه‌ی مختلف سالمونلا استفاده شد. برای انجام PCR از دستگاه ترموسایکلر استفاده شد اما در روش LAMP بدون نیاز به دستگاه گران قیمت ترموسایکلر و تنها با استفاده از یک بلوك دمایی ساده و ارزان، ساخت داخل کشور تشخیص انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو روش LAMP و PCR به طور اختصاصی قادر به شناسائی سالمونلا می‌باشند. روش LAMP برخلاف PCR همچنین روش ۱۰۰ LAMP ۱۰۰ برابر حساس‌تر از PCR معمولی است. بر اساس نتایج این تحقیق در روش LAMP در عرض کمتر از ۹۰ دقیقه تشخیص انجام شد ولی در PCR معمولی تشخیص بیش از ۳ ساعت به طول انجامید. مزیت دیگر این روش عدم وابستگی به چرخه‌های دمایی و دستگاه ترموسایکلر بود.

نتیجه‌گیری: روش LAMP در مقایسه با PCR تقریباً ۳ برابر سریع‌تر، ۱۰۰ برابر دقیق‌تر، ۱۰ برابر ارزان‌تر است که می‌تواند کاربرد گستردگی‌های در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، پژوهشی قانونی، کشاورزی، تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های کوچک و سیار داشته باشد و جهت مطالعات همه گیرشناسی، تشخیص و شناسایی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سالمونلا، ایزوترمال، PCR، LAMP، DNA

۱- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه زنجان، عضو گروه بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی زنجان

۲- دکترای تخصصی بیولوژی مولکولی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

۳- دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

۴- کارشناس ارشد سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

۵- دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) و دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۶- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه زنجان، عضو گروه بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی زنجان

مقدمه

تأیید نتیجه‌ی مثبت نیاز دارد (۵). از دیگر روش‌ها می‌توان به روش‌های سرولوژیک، تکنیک‌های الکتریکی و آنالیز نشانگرهای اسیدهای نوکلئیک اشاره نمود، اما هنوز مشکلات بسیاری در رابطه با حساسیت و اختصاصیت این روش‌ها وجود دارد و زمان آنالیز بسته به حساسیت سیستم تشخیصی از چند ساعت تا چندین روز متفاوت است و به علت مشکلات تکنیکی، سختی کار و زمان زیاد جهت تشخیص این روش‌ها عمومیت چندانی نیافرته‌اند (۶). روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز یا PCR که در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه دانشمندان علوم زیستی قرار گرفته است، روشی سریع و حساس می‌باشد که قادر است تعداد نسخه‌ی اندکی از DNA هدف را تا سطحی که توسط ژل الکتروفورز قابل تشخیص باشد تکثیر نماید، به علت کارایی بالا و قدرت زیاد PCR این روش در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای در تشخیص سالمونلا به کار گرفته شده است، گرچه این روش دارای مزایای بسیاری است اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد که می‌توان به موارد نمود: استفاده از چرخه‌های حرارتی جهت تکثیر (۳۰ تا ۴۰ چرخه)، استفاده از دستگاه ترموسایکلر که گران است روش‌های آشکارسازی و تشخیص محصول PCR که عمدتاً با مشکلاتی نظیر استفاده از مواد سمی و خطرناک مثل برومیداتیدیدم همراه است، اشاره نمود. این محدودیت‌ها موجب گردیده تا این روش تنها در آزمایشگاه‌های مجهر که دارای افراد متخصص است به کار گرفته شود و در مکان‌هایی که امکان به کارگیری وسایل مجهر آزمایشگاهی وجود ندارد و همچنین در مناطق دور افتاده و محروم که نیاز به تشخیص عوامل میکروبی از جمله سالمونلا جهت جلوگیری از خسارات شدید است نتوان از این روش استفاده نمود (۶-۸). بنابراین نیاز به روشهای ساده‌تر با کارایی بالاتر است که علاوه بر انجام آن در آزمایشگاه‌های مجهر بتوان آن را در آزمایشگاه‌های عادی و کوچک حتی توسط افراد غیر متخصص نیز انجام داد. روش

سالمونلاها دسته‌ی بزرگی از باسیل‌های گرم منفی می‌باشند که از نظر مورفو‌لوژی شبیه سایر باکتری‌های خانواده انتروباکتریا سه هستند. اکثر گونه‌ها متحرک و دارای تاژک پریتریش هستند. این باکتری‌ها بی‌هوایی اختیاری می‌باشند و در طیف وسیعی از دما (۷ تا ۴۲ درجه‌ی سانتی‌گراد) و pH ۴ تا ۸ قادر به رشد می‌باشند. اما بهترین دما جهت رشد، ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد و pH ۷ می‌باشد. این باکتری‌ها مقاوم به سرما و خشکی بوده، قادر به رشد در دمای کمتر از ۴ درجه‌ی سانتی‌گراد و تحمل pH پایین‌تر از ۴ نیز می‌باشند. سالمونلاها به حرارت حساس بوده، در دمای ۷۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و بالاتر از بین می‌روند (۱-۳).

سالمونلاها عمدتاً از راه دهان وارد بدن شده، در روده جایی که بیماری‌زایی خود را شروع می‌کنند، جایگزین می‌شوند. بیماری حاصل از سالمونلا دارای سه حالت اصلی است که شامل تب روده‌ای (تیفوئید)، باکتریمی و آنتروکولیت است و هر یک باعث بروز عوارض متعددی می‌شود که می‌توان به تب، سردرد، کندي ضربان قلب، استفراغ، اسهال، ازدياد حجم کبد و طحال، تورم کيسه صفراء، زخم و ضایعات مفصلی اشاره نمود. به گزارش سازمان جهانی بهداشت ۱۶ تا ۳۳ میلیون مورد بیمار و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار مرگ سالیانه یک معضل بزرگ بهداشتی در جهان بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما می‌باشد (۴). از این رو تشخیص به موقع و درست این باکتری در مواد غذایی و افراد مشکوک به آلودگی ضروری به نظر می‌رسد. روش‌های تشخیصی متعددی جهت شناسائی این باکتری وجود دارد که به هر یک اشاره می‌شود. تشخیص توسط کشت، که شامل کشت در محیط‌های غیرانتخابی غنی‌شده و در ادامه کشت در محیط‌های انتخابی است و سپس کلونی‌های مشکوک از نظر بیوشیمیایی مورد تأیید قرار می‌گیرند، تکمیل این تست نیاز به سه تا چهار روز زمان برای حصول نتیجه‌ی منفی و به بیش از هفت روز برای

پیچیدگی طراحی پرایمرهای چندگانه برای تکثیر هر ناحیه‌ی ژنی جدید و انتخاب نواحی مناسب در توالی ژنی مورد نظر جهت طراحی مناسب و کارآمد پرایمرها، ایجاد محصول پیچیده حاصل از تکثیر DNA که ساختارهایی مثل گل کلم در اندازه‌های مختلف را ایجاد می‌نماید، که راه را برای استفاده از روش‌های مبتنی بر هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک مانند Microarray با مشکل مواجه می‌نماید (۱۴)، از محدودیت‌های آن است. با توجه به محدودیت‌های فوق الذکر باید هنگام استفاده از این روش به این موارد توجه نمود تا نتیجه‌ی مطلوب حاصل گردد. مزایای LAMP باعث گردیده که به عنوان روشی سریع و دقیق در تشخیص پاتوزن‌ها از جمله سالمونلا به کار رود و به ایجاد روش‌های تشخیصی سیار و سریع در مناطقی که امکان استفاده از آزمایشگاه‌های روتین وجود ندارد منجر گردد. در این مطالعه هر دو روش PCR و LAMP برای تشخیص سالمونلا به کار گرفته شد و نشان داده شد که روش LAMP نسبت به PCR آسان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر است.

روش بررسی

در این تحقیق از ۷ سویه‌ی مختلف سالمونولا (سالمونولا تیفی، سالمونولا پاراتیفی A، سالمونولا پاراتیفی B، سالمونولا پاراتیفی C، سالمونولا ایتریتیدیس، سالمونولا اینفتیس، سالمونولا هاوانا) استفاده شد. جهت استاندارد نمودن آزمایش، سویه‌های استاندارد سالمونولا و سایر انتروباکتری‌ها از آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت تهیه شدند. نمونه‌ها به شکل لیوفلیزه در لوله‌های مخصوص دریافت گردیدند. مواد شیمیایی از شرکت مرک، بافر Mg_{Cl}₂، نوکلئوتیدها و آنزیم Taq از شرکت‌های داخلی (سینا ژن) و آنزیم Bst پلیمراز نیز از شرکت بیولب [BioLab(New England)] تهیه گردید. در PCR از دستگاه مستر سایکلر Mastercycler gradient ساخت شرکت اپندروف آلمان، جهت چرخه‌های حرارتی

جدیدی به نام تکثیر هم دمای DNA وابسته به حلقه Loop- Mediated Isothermal Amplification of DNA (LAMP) توسط نوتومی و همکاران در سال ۲۰۰۰ معرفی گردید که واجد این مشخصات است. در این روش DNA با اختصاصیت، کارایی و سرعت بالا در یک دما تکثیر می‌شود. در این روش از ۴ پرایمر (دو پرایمر داخلی و دو پرایمر خارجی) استفاده می‌شود، که در مجموع ۶ ناحیه‌ی ژنی از DNA هدف را مورد شناسایی قرار می‌دهد و طی فرآیندی دنباله‌دار و با تشکیل نواحی سنجاق سری در دمای ۶۵°C درجه‌ی سانتی‌گراد و استفاده از یک آنزیم DNA پلیمراز مقاوم به حرارت تکثیر می‌یابد (۹). در روش LAMP کل واکنش تکثیر تحت شرایط تک دمایی به شکل پیوسته انجام می‌پذیرد. روش LAMP نیاز به مرحله‌ی واسرشت‌سازی (Denaturation) اسید نوکلئیک دو رشته‌ای به تک رشته‌ای برای شروع واکنش پلیمریزاسیون ندارد. حتی بدون واسرشت‌سازی اولیه واکنش به راحتی انجام می‌پذیرد. کارایی تکثیر در این روش، فوق العاده بالاست. زیرا در اینجا هیچ زمانی جهت تغییر دما از دست نمی‌رود و واکنش در دمای ۲۰°C بهینه‌ی فعالیت آنزیم به شکل پیوسته انجام می‌گیرد و ۲۵ میلی‌گرم از DNA هدف در ۲۵ میکرولیتر از مخلوط واکنش در عرض ۳۰ تا ۶۰ دقیقه تکثیر می‌یابد. روش LAMP قادر است که ژن هدف را با کارایی بسیار بالا به وسیله‌ی طراحی ۴ پرایمر که ۶ ناحیه‌ی توالی هدف را شناسایی می‌نمایند، تکثیر نماید. هزینه‌ی کلی با این روش، بسیار کاهش می‌یابد، زیرا روش LAMP نیاز به مواد شیمیایی ویژه یا دستگاه‌های گران قیمت آزمایشگاهی ندارد. محصولات تکثیر شده دارای ساختار مرکبی از توالی‌های متناوب (Alternately repeats) معکوس (Inverted repeats) تکراری (Repeats) از توالی هدف (Target) هدف (Sequence) روی همان رشته می‌باشند (۱۰-۱۳). پر واضح است که LAMP نیز همانند سایر روش‌ها دارای محدودیت‌هایی است که به آنها اشاره می‌شود.

۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد زیر صفر نگهداری شدند.
انجام PCR بر روی نمونه‌های استاندارد: واکنش PCR جهت تکثیر ژنوم سالمونلا در حجم ۲۵ میکرولیتر انجام گرفت. هر واکنش شامل ۱۴ میکرولیتر آب مقطر تزریقی، ۲/۵ میکرولیتر بافر X^{۱۰}، ۳ میکرولیتر از هر پرایمر، ۲/۵ واحد آنزیم *Taq* پلیمراز، ۲۵ mM cl₂Mg (25 dNTP mix (100 mM each) ۰/۲ میلی مولار، ۰/۲ میلی مولار) و سپس ۱ میکرولیتر از نمونه‌های ژنومی استخراج شده به لوله‌های حاوی ترکیبات فوق اضافه شد و در دستگاه مستر سایکلر (Master cycler) اپندروف که دارای ویژگی بررسی گرایدیان دمایی است قرار گرفت و طبق برنامه‌ی زیر PCR انجام شد. مرحله‌ی اول ۱ دقیقه در دمای ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد و سپس ۳۰ چرخه شامل سه مرحله ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه، ۵۷ درجه‌ی سانتی‌گراد ۱ دقیقه، ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد ۱ دقیقه و مرحله‌ی نهایی در ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد برای ۵ دقیقه قرار گرفت. برای سهولت کار در تمام آزمایشات Master mix تهیه شد. پس از خاتمه‌ی برنامه، مقدار ۳ تا ۵ میکرولیتر از محصول با ۱ تا ۲ میکرولیتر از بافر مخصوص نمونه‌گذاری مخلوط شده و در ژل آگارز ۱٪ قرار داده شد. پس از قرار دادن مارکر مولکولی، الکتروفورز در ولتاژ ۸۰ به مدت ۴۵ دقیقه انجام شد. پس از خاتمه الکتروفورز، ژل در محلول حاوی برومیداتیدیوم (۰/۵ تا ۱ میکروگرم در میلی لیتر) رنگ آمیزی و پس از شست و شو در بافر، بر روی دستگاه ماوراء بنتفشن بررسی و عکس‌برداری شد.

انجام LAMP بر روی نمونه‌های استاندارد: واکنش LAMP جهت تکثیر ژنوم سالمونلا در حجم ۲۵ میکرولیتر انجام گرفت. هر واکنش شامل ۱۱/۵ میکرولیتر آب مقطر تزریقی، ۲/۵ میکرولیتر بافر X^{۱۰}، ۲ میکرولیتر از پرایمرهای داخلی (F3,B3)، ۰/۵ میکرولیتر از پرایمرهای خارجی (FIP,BIP)، واحد آنزیم *Bst* پلیمراز، Betaine با غلضت نهایی ۸

استفاده شد و از یک بلوك حرارتی ساخت شرکت کیا ژن، جهت انجام واکنش LAMP استفاده شد. از دستگاه الکتروفورز افقی کوچک (ساخت شرکت پایا پژوهش مشهد) و منبع تغذیه آن با بافر ۱٪ TBE جهت الکتروفورز استفاده شد. جهت بررسی ژل از دستگاه یووی‌داک (UVIdoc) ساخت شرکت UViec (انگلیس) استفاده شد و از مارکر مولکولی ۱۰۰ جفت باز شرکت فرمتاز شامل ۱۱ باند ۸۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ (باند ضخیم‌تر)، ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰ و ۹۰۰ و ۱۰۳۰ جفت باز استفاده شد.

کشت و استخراج DNA: از نمونه‌های تهیه شده به میزان ۵۰ میکرولیتر در ۱/۵ سی سی محیط کشت مایع LB کشت داده شد و به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد گرمانه‌گذاری شدند. بعد از گذشت این زمان تمام نمونه‌ها رشد کردند و DNA سالمونلاهای کشت داده شده به روش استاندارد فنل کلروفرم (۱۵ و ۱۶) استخراج شد.

آغازگرهای PCR: در انجام تست PCR از آغازگرهایی (پرایمر) استفاده شد که توسط کرمی و همکاران (۱۷ و ۱۸) جهت تشخیص مولکولی سالمونلا طراحی شده بودند. توالی پرایمرها در جدول ۱ ذکر شده است. پرایمرهای دریافتی بر اساس غلظت ذکر شده توسط شرکت سازنده‌ی پرایمر، در آب مقطر تزریقی با غلظت ۱۰۰ پیکو مول تهیه شدند و سپس با رقت ۲۰ پیکومول تهیه و جهت استفاده در ۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد زیر صفر نگهداری شدند.

پرایمرهای LAMP: در انجام تست LAMP از پرایمرهایی استفاده شد که توسط میدا و همکاران و نیز هراکودو و همکاران (۱۸ و ۱۹) جهت تشخیص مولکولی سالمونلا طراحی شده بودند (شکل ۱). توالی پرایمرها در جدول ۲ نشان داده شده است. پرایمرهای دریافتی بر اساس غلظت ذکر شده توسط شرکت سازنده‌ی پرایمر، در آب مقطر تزریقی با غلظت ۱۰۰ پیکومول تهیه شده، سپس با رقت ۲۰ پیکومول تهیه و جهت استفاده در

میکرولیتر از محصول با ۱ تا ۲ میکرولیتر از بافر مخصوص نمونه‌گذاری مخلوط شده و در ژل آگارز ۲٪ قرار داده شد. پس از قرار دادن مارکر مولکولی، الکتروفورز در ولتاژ ۸۵ به مدت ۴۵ دقیقه انجام شد. پس از خاتمه الکتروفورز، ژل در محلول حاوی برومید اتیدیوم (۰/۵٪) تا ۱ میکروگرم در میلی‌لیتر) رنگ‌آمیزی و پس از شستشو در بافر، بر روی دستگاه ماوراء بنسخ بررسی و عکسبرداری شد.


۰/۴ میلی‌مول، ۰/۲ میلی‌مول dNTP mix و سپس ۳ میکرولیتر از نمونه‌های ژنومی استخراج شده به لوله‌های حاوی ترکیبات فوق اضافه شد و در دستگاه ترموبلاک (Thermo Block) قرار گرفت و طبق برنامه‌ی زیر واکنش LAMP انجام شد، مرحله‌ی اول ۶۰ دقیقه در ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد و در مرحله‌ی دوم ۱۰ دقیقه در ۸۲ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گرفت. پس از خاتمه‌ی برنامه مقدار ۳ تا ۵

جدول ۱: توالی آغازگرهای استفاده شده برای واکنش PCR

ردیف	نام آغازگر	توالی	اندازه (bp) در PCR	اندازه (bp) محصول تولیده شده (bp) در
۱	S۳	5'-CTTGCTATGGAAGACATAACGAACC -3'	۲۵۸	۲۵
	S۴	5'-CGTCTCCCATCAAAAGCTCCATAGA -3'		۲۴
۳	S۱۲	5'- GTATTGTTGATTAATGAGATCCG-3'	۳۷۳	۲۳
	S۱۳	5'- ATATTACGCACGGAAACACGTT-3'		۲۲

جدول ۲: توالی آغازگرهای استفاده شده برای واکنش LAMP

ردیف	نام آغازگر	نوع	طول	توالی
۱	FIP	Forward-inner (5^0 -F1C-TTTT-F2- 3^0)	46nt(F1C, 22nt; F2, 20nt)	5'-GACGGCTGGTACTGATCGATAGTTTTCA ACGTTTCCTGCGG -3'
۲	BIP	Backward-inner (5^0 -B1C-AAAA-B2- 3^0)	45nt(B1C, 21nt; B2, 20nt)	5'-CCGGTGAAATTATGCCACACAAAACCCA CCGCCAGG -3'
۳	F3	Forward outer	22nt	5'-GGCGATATTGGTGTITATGGGG -3'
۴	B3	Backward outer	20nt	5'-AACGATAAACTGGACCACGG -3'

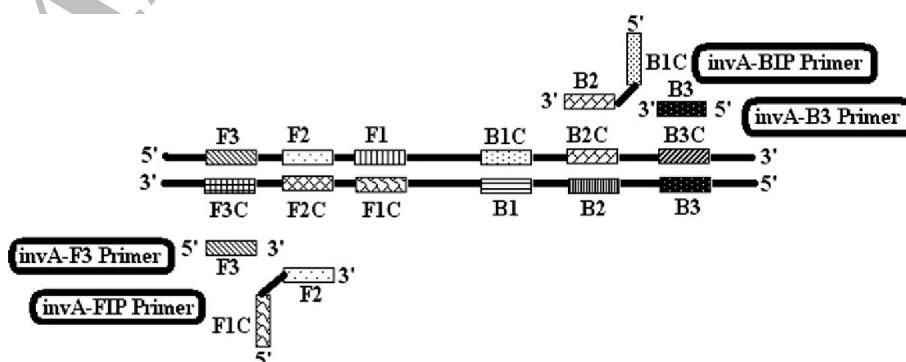


شکل ۱: پرایمرهای طراحی شده از ژن invA برای انجام واکنش LAMP

یافته‌ها

S12-S13 که بر اساس ژن *invA* طراحی شده مانند دیگر سویه‌ها باند ۳۷۳ را ایجاد کردند، اما با پرایمرهای S3-S4 هیچ باندی تولید نکردند. در حالی که این پرایمرها در دیگر سویه‌ها باند ۲۵۸ جفت باز را تولید نمودند (شکل ۲).

چنانکه در شکل ۲ دیده می‌شود نتیجه‌ی بررسی نمونه‌ها با دو جفت پرایمر و انجام PCR معمولی، دو باند به اندازه‌های ۳۷۳ و ۲۵۸ جفت باز مشاهده گردید، سالمونلا اینفنتیس و سالمونلا هاوانا با پرایمرهای

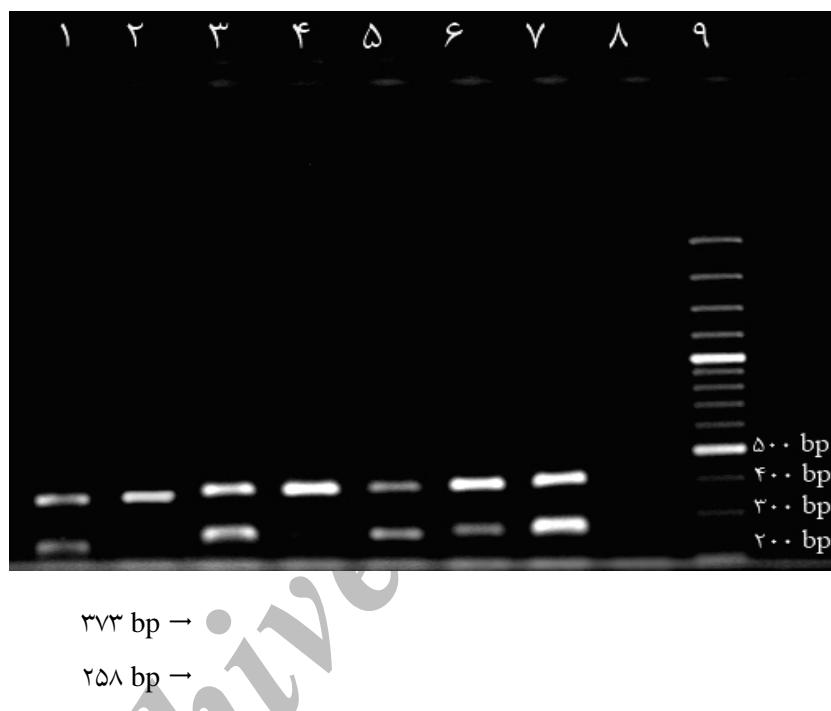

شکل ۲: الکتروفوروز محصول PCR برای ژن *invA* با استفاده از پرایمرهای S12-S13 و S4-S3


- ۱- سالمونلا تیفی، ۲- سالمونلا اینفنتیس، ۳- سالمونلا اینترتیدیس، ۴- سالمونلا هاوانا، ۵- سالمونلا پاراتیفی A
- ۶- سالمونلا پاراتیفی B، ۷- سالمونلا پاراتیفی C، ۸- کنترل منفی (بدون DNA) و ۹- مارکر مولکولی

بود هیچ باندی قابل رویت نبود. بعد از بهینه نمودن دمای واکنش بهترین نتیجه در دمای ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد بدست آمد زیرا در این دما میزان تکثیر DNA افزایش می‌یابد، برای مشخص کردن زمان واکنش LAMP زمان‌های مختلفی (۳۰، ۴۵ و ۶۰) به کار برد. در ۳۰ دقیقه، محصولی تولید نشد. در ۴۵ دقیقه، محصول اندکی تولید شد و در ۶۰ دقیقه، میزان محصولات به حد اکثر رسید (جزئیات نشان داده نشده است). بنابراین واکنش

بعد از انجام PCR واکنش LAMP انجام شد. جهت بهینه نمودن شرایط واکنش LAMP از ژنوم سالمونلا تیفی استفاده شد. بعد از انجام بهینه سازی‌های لازم واکنش انجام شد و باندهای متعدد نردهای شکلی با اندازه ۲۴۱bp به بالا مشاهده شدند، اما تا ۶۰۰bp نیز باندها قابل مشاهده بودند و باندهای بزرگ‌تر به علت غلظت بالای ژل قابل مشاهده نبودند. ایجاد این باندها دلالت بر انجام واکنش اختصاصی داشت. در کنترل منفی که فاقد DNA الگو

واکنش به مدت ۱۰ دقیقه در ۸۲ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داده شد.

LAMP در ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۶۰ دقیقه بهینه‌سازی شد و برای خاتمه‌ی واکنش نیز مخلوط

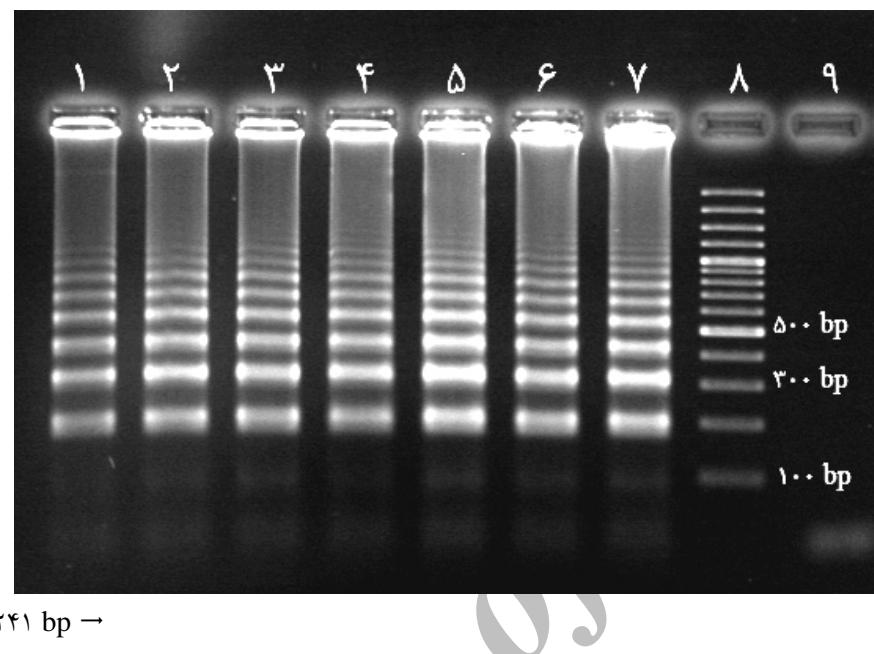

$241\text{ bp} \rightarrow$


شکل ۳: انجام واکنش LAMP با سویه‌های مختلف سالمونولا بعد از بهینه سازی شرایط واکنش.

- ۱- سالمونولا تیفی، ۲- سالمونولا اینفتیس، ۳- سالمونولا اینترپتیدیس، ۴- سالمونولا هاوانا، ۵- سالمونولا پاراتیفی A
- ۶- سالمونولا پاراتیفی B، ۷- سالمونولا پاراتیفی C، ۸- کنترل منفی (بدون DNA) و ۹- مارکر مولکولی

این روش می‌توان حساسیت PCR و LAMP را تعیین نمود. همانطور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، PCR تا رقت 2×10^2 (کپی در میلی‌لیتر) از ژنوم سالمونولا تیفی قادر به ایجاد باند بود و پس از آن در رقت‌های کمتر ژنوم هیچ باندی مشاهده نشد. ولی در LAMP تا رقت ۲-۱۰ (کپی در میلی‌لیتر) از ژنوم سالمونولا تیفی باند مشاهده می‌شود. بنابراین گزارش می‌شود که روش LAMP نسبت به PCR معمولی در تشخیص سالمونولا تا ۱۰۰ برابر حساس‌تر است (۲۲).

مقایسه‌ی LAMP و PCR: در LAMP تنها ژن *invA* در اندازه‌های مختلف از ۲۴۱ bp به بالا تکثیر می‌یابد ولی در PCR برای هر جفت پرایمر تنها یک باند مشاهده می‌گردد. برای پرایمرهای S3 و S4 باند ۲۵۸ bp و پرایمرهای S12 و S13 باند ۳۷۷ bp مشاهده می‌شود. در LAMP پرایمرهای طراحی شده تنها قادر به تکثیر ژن *invA* هستند و با این پرایمرها تنها سالمونولا از دیگر جنس‌های باکتریایی تشخیص داده می‌شود.

مقایسه‌ی حساسیت LAMP با PCR (Sensitivity): برای تعیین حساسیت، رقت‌های مختلفی از ژنوم تهیه شد و با آن PCR و LAMP انجام شد. غلظت اولیه‌ی ژنوم 2×10^6 (کپی در میلی‌لیتر) بود. بنابراین از این ژنوم اولیه اقدام به رقیق‌سازی (Serial Dilution) از رقت 10^{-1} تا 10^{-7} شد. با

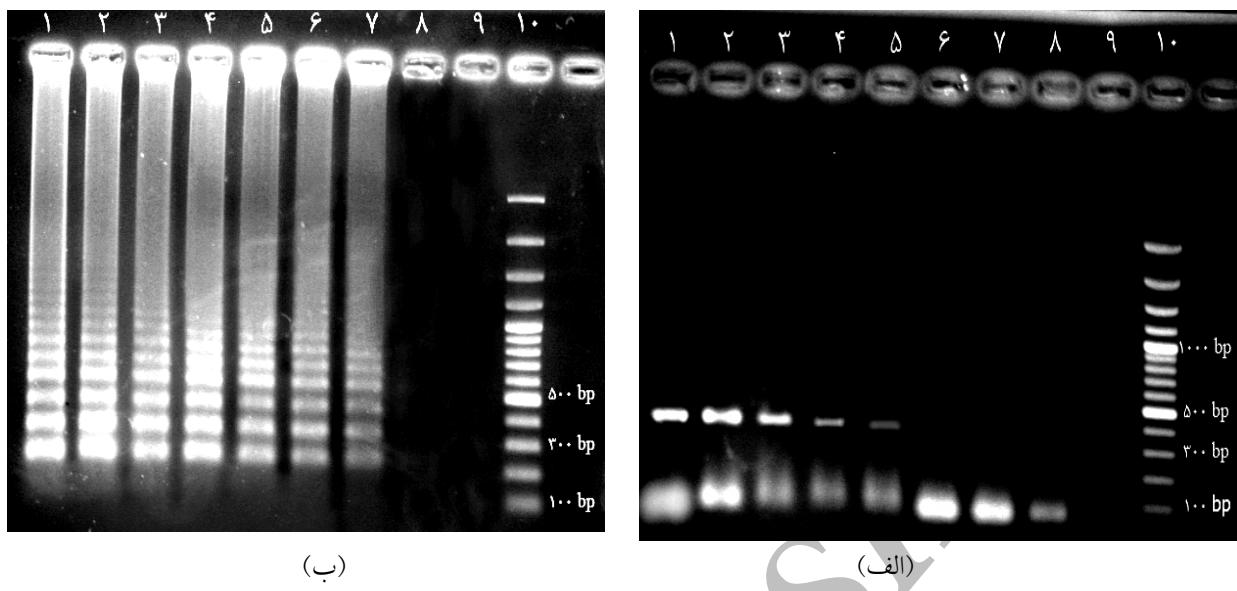

شکل ۴: مقایسه‌ی حساسیت (PCR Sensitivity) (شکل الف: در PCR باند اختصاصی ۳۷۳ bp مشاهده می‌شود) با LAMP (شکل ب: در با ژنوم اختصاصی سالمونلا الکترو نردنی مشاهده می‌شود).

- ۱- کنترل مثبت (ژنوم سالمونلا تیفی)، ۲- رقت $^{+10}$ از ژنوم سالمونلا تیفی، ۳- رقت $^{-10}$ از ژنوم سالمونلا تیفی، ۴- رقت $^{-3}$ از ژنوم سالمونلا تیفی، ۵- رقت $^{-4}$ از ژنوم سالمونلا تیفی، ۶- رقت $^{-5}$ از ژنوم سالمونلا تیفی، ۷- رقت $^{-6}$ از ژنوم سالمونلا تیفی، ۸- رقت $^{-7}$ از ژنوم سالمونلا تیفی، ۹- کنترل منفی (فاقد DNA ژنومی) و ۱۰- مارکر مولکولی.

سریع تر و مقرن به صرفه تری است. محققین جهت تشخیص مولکولی سالمونلا پرایمرهای مختلفی را بر اساس ردیف ژن‌های شناخته شده، *fiC-dT fiC-a invB invA* و *spvC int-flom prt tyv* طراحی و بررسی نموده‌اند (۲۶). در روش LAMP برای تشخیص سریع سالمونلا از دو جفت پرایمیر طراحی شده بر اساس ژن *invA* که قادر به شناسایی انواع سالمونلا می‌باشد استفاده شد و تشخیص بسیار سریع و دقیق انجام گرفت (۲۰-۲۱).

این روش نسبت به دیگر روش‌های مولکولی دارای مزایای بسیاری است که به آنها اشاره می‌شود.

LAMP قادر است DNA را با کارایی بالا تحت شرایط شرایط تک دمایی (Isothermal) تکثیر نماید و تشخیص را می‌توان با تعداد اندک DNA شروع نمود، LAMP حتی قادر

بحث

روش‌های متداول تشخیص سالمونلا نیازمند زمان طولانی است که فاقد کارایی لازم جهت تشخیص سریع این باکتری می‌باشد (۱۵). از روش PCR معمولی جهت تشخیص، شناسایی و تفیک سالمونلا از سایر انتروباکتریاسه‌ها استفاده شده است که این روش نیازمند دستگاه گران قیمت ترموسایکلر و چرخه‌های حرارتی و روش‌های پر زحمت آشکارسازی است (۱۱). بررسی روش‌های فوق سریع موسوم به روش Real-time PCR در تشخیص سریع سالمونلا نشان داده است که می‌تواند کارایی مناسبی داشته باشد ولیکن دستگاه استفاده شده بسیار گران قیمت است (۲۱). بنابراین جهت مرتفع نمودن مشکلات روش PCR از روش جدید LAMP استفاده شد. LAMP روش تشخیصی

کوتاه گردید، جهت انجام این کار فاکتورهای مؤثر در واکنش از قبیل آنزیم، dNTP، پرایمرها، بتائین، DNA الگو و زمان انجام واکنش بهینه‌سازی شدند که نسبت به تلاش‌هایی که جهت کوتاه نمودن زمان تشخیص باکتری‌های بیماری‌زا از جمله سالمونلا که با دستگاه‌های متداول PCR صورت گرفته است، قابل توجه می‌باشد (۲۶). برای اولین بار هراکودو و LAMP همکاران اقدام به تشخیص سالمونلا به روش LAMP نمودند. زمان لازم برای تشخیص را بعد از انجام الکتروفورز، ۹۰ دقیقه گزارش نمودند. طبق یافته‌های این محققان حساسیت تست LAMP بسیار بالاتر از PCR بود. این مطالعه نشان داد که تست LAMP می‌تواند برای تشخیص سریع سالمونلا با حساسیت بالا بکار رود. بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق برای حساسیت تست LAMP با نتایج این محققان انطباق دارد (۱۹). وانگ و همکاران اقدام به تشخیص سالمونلا با روش LAMP در بقایای مواد غذایی نمودند، آنها زمان ۶۰ دقیقه را گزارش نمودند. حساسیت LAMP بر اساس این تحقیق ۱۰ برابر بیشتر از PCR اعلام شد. آنها نشان دادند که استفاده از ژن *invA* جهت طراحی پرایمر در تشخیص سالمونلا دارای اختصاصیت بالایی است و سویه‌های دیگر باکتریایی با استفاده از این آغازگرها قابل تشخیص نیستند. البته این آغازگرها قادر به تشخیص سویه‌های مختلف سالمونلا از یکدیگر نیستند. نتایج ما با نتایج این محققان نیازنطیاب دارد (۲۰). آکامورا و همکاران اقدام به تشخیص سروتاپهای مختلفی از سالمونلا با روش LAMP در جوچه نمودند. آنها در LAMP نتیجه‌ی نهایی را در عرض ۶۰ دقیقه در دمای ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد بدست آوردنده، در حالی که در PCR بعد از ۱۲۰ دقیقه به نتیجه رسیدند. همچنین حساسیت LAMP را 10^3 CFU/ml و حساسیت PCR را 10^9 CFU/ml گزارش نمودند. این محققان برای کوتاه کردن زمان واکنش LAMP از آغازگرهای حلقوی استفاده نموده‌اند و در کمتر از نصف زمان معمول

است DNA را در کمتر از ۶ کپی در مخلوط واکنش شناسایی نماید. محصولات واکنش مخلوطی از DNA های ساختار سنجاق سر با اندازه‌های متفاوت و ساختارهای گل کلم مانند با حلقه‌های متعدد که از اتصال بین توالی‌های معکوس تکراری از توالی هدف را ایجاد می‌نمایند، که حتی در زیر میکروسکوپ نوری به راحتی قابل مشاهده‌اند، و امکان تشخیص انتخابی را فراهم می‌نمایند. LAMP بسیار اختصاصی عمل می‌کند زیرا با ۴ پرایمر قادر است که ۶ ناحیه‌ی ثُنی از توالی هدف را در آغاز واکنش و ۴ ناحیه را در طی واکنش اصلی LAMP مورد شناسایی قرار دهد. روش LAMP ساده و انجام آن آسان است، و تنها نیاز به پرایمر، DNA پلیمراز و مخلوط واکنش دارد و نیازی به ترمومایکلر ندارد و واکنش در حمام آب گرم یا بلوک‌های حرارتی قابل انجام است. بهو سیله ترکیب با آنزیم نسخه برداری معکوس، LAMP قادر است توالی‌های RNA را با کارایی بالا تکثیر نماید (۹). امکان آشکار سازی نتیجه‌ی نهایی واکنش بر اساس کدر شدن محیط عمل واکنش که به واسطه‌ی آزاد شدن پیررو فسفات از dNTPها و ترکیب آنها با یون‌های منیزیم در حین واکنش ایجاد می‌گردد و امکان آنالیز نتایج را آسان می‌نماید که این مورد در بین تمام روش‌های ملکولی تکثیر DNA بی‌نظر است (۱۰). عدم نیاز به واسرشت نمودن DNA اولیه و حتی عدم نیاز به استخراج DNA اولیه از برخی نمونه‌های بیولوژیک (مانند محیط کشت مایع) می‌باشد (۲۴). امکان آشکارسازی محصول نهایی با استفاده از تکنیک هیبریداسیون با پروب‌های فلورسانس نیز وجود دارد (۲۵). مقایسه‌ی نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه نشان داد که استفاده از پرایمرهایی که بر اساس ژن *invA* طراحی شده‌اند، کارایی بالایی در تشخیص سالمونلا به روش LAMP دارند، زیرا این ژن از ژن‌های مهم مسئول تهاجم باکتری به سلول‌های اپیتلیال است. در این تحقیق با بهینه سازی‌های انجام شده در طی واکنش LAMP زمان نهایی تشخیص نسبت به PCR بسیار

گردید. بنابراین پیشنهاد می‌گردد روش ایزوترمال LAMP به عنوان روش تشخیص مولکولی سریع‌تر، دقیق‌تر و ارزان‌تر در مقایسه‌ی با PCR با کاربرد گسترده در آزمایشگاه‌های تشخیصی پزشکی، پژوهشی قانونی، کشاورزی و تحقیقاتی و حتی آزمایشگاه‌های کوچک و سیار بکار برد.

تشکر و قدر دانی

از مسئولین محترم مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) که در طول انجام این تحقیق حمایت و پشتیبانی فراوانی را مبذول داشتند و همچنین مسئولین محترم دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه زنجان نیز بخاطر همکاری‌های و مساعدت‌های لازم کمال تشکر به عمل می‌آید.

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج این تحقیق روش هم دمایی LAMP در مقایسه با PCR برای تشخیص سالمونلا تیفی و انواع دیگر عوامل عفونی سریع‌تر، ارزان‌تر و اختصاصی‌تر بود. مزیت دیگر این روش عدم وابستگی به چرخه‌های دمایی و دستگاه گران قیمت حرارتی (ترموسایکلر) بوده که به جای آن از یک بستره حرارتی بسیار ساده و ارزان، ساخت داخل کشور استفاده

منابع

- 1- Zahraei T, Salmonella. Tehran: Tehran university publications; 1999.
- 2- Collier L, Balows A, Sussman M. Topley and wilsons microbiology and microbial infections. London: Arnold; 1998.
- 3- Soltani MJ, Shahhosseiny MH, shahbazzadeh D, et al. Selective Amplification of prt, tyl and inv A Genes by multiplex PCR for rapid detection of salmonella typhi, *Iranian Biomed J*. 2005; 9: 135-8.
- 4- Abhyankar A. Salmonellosis and its laboratory diagnosis 2002; Available from: URL: <http://www.Geoities.Com/avinash abhyankar/>
- 5- Moore P. PCR: replicating success. *Nature*. 2005; 435: 235-8.
- 6- Hoofnar J, Ahrens P, and Radstrom P. Automated 5' nuclease PCR assay for

- identification of *Salmonella enterica*. *J Clin Microbiol*. 2000; 38: 3429-35.
- 7- Figueroa-Bossi N, Bossi L. Inducible prophages contribute to *Salmonella* virulence in mice. *Mol Microbiol*. 1999; 33: 167-76.
- 8- Kumar A, Arora V, Bashamboo A, Ali S. Detection of *Salmonella typhi* by polymerase chain reaction: implications in diagnosis of typhoid fever. *Infect Genet and Evol*. 2002; 2: 107-10.
- 9- Notomi T, Okayama H, Masubuchi H, et al. Loop-mediated isothermal amplification of DNA. *Nucleic Acids Res*. 2000; 28: e63.
- 10- Mori Y, Magamine K, Tomita N, Notomi T. Detection of loop-mediated isothermal amplification reaction by turbidity derived from magnesium pyrophosphate formation. *Biochem Biophys Res Commun*. 2001; 289: 150-4.

- 11- Nagamine K, Hase T, Notomi T. Accelerated reaction by loop-mediated isothermal amplification using loop primers. *Mol Cell Probes*. 2001; 16: 223-9.
- 12- Nagamine K, Kuzuhara Y. Isolation of single-stranded DNA from Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) products. *Biochem Biophys Res Commun*. 2002; 290: 1195-8.
- 13- Demidov VV. A new use for old stuff: DNA hairpins in DNA amplification. *Trends in Biotechnol*. 2002; 20: 189-90.
- 14- Kochl S, Niederstatter H, Parson W. DNA extraction and quantitation of forensic samples using the phenol-chloroform method and real-time PCR. *Methods Mol Biol*. 2005; 297:13-30.
- 15- Boom R, Sol CJ, Salimans MM, et al. Rapid and simple method for purification of nucleic acids. *J Clin Microbiol*. 1990; 28: 495-503.
- 16- karami A, Ranjbar R, Ahmadi Z, Safari Z. Rapid detection of different serovars of *Salmonella enterica* by multiplex PCR. *Iranian J Publ Health*. 2007; 36: 38-42.
- 17- Karami A, Morrovati S, Ahmadi Z, Safari Z, khililpour A. Development of an ultra rapid and simple multiplex polymerase chain reaction technique for detection of *Salmonella typhi*. *Saudi Med J*. 2006; 27: 1134-8.
- 18- Maeda H, Kokeguchi S, Fujimoto C, et al. Detection of periodontal pathogen *Porphyromonas gingivalis* by loop-mediated isothermal amplification method. *FEMS Immunol Med Microbiol*. 2005; 43: 233-239.
- 19- Hara-Kudo Y, Kumagai S, Masuda T, et al. Detection of *Salmonella enteritidis* in shell and liquid eggs using enrichment and plating. *Int J Food Microbiol*. 2001; 64: 395-9.
- 20- Wang L, Lei S, MJ A, Yuhuan G, Lin L. Specific and rapid detection of foodborne *Salmonella* by loop-mediated isothermal amplification method. *Food Research International*. 2007; 41: 69-74.
- 21- Doran JL, Collinson SK, Burian J, Sarlos G, Todd EC, Munro CK. DNA-based diagnostic tests for *Salmonella* species targeting agfA, the structural gene for thin, aggregative fimbriae, *J Clin Microbiol*. 1993; 31:2263-73.
- 22- Hirose K, Itoh KI, Nakajima H, et al. Selective Amplification of tyv (rfbE), prt (rfbS), viaB and fliC genes by multiplex PCR for identification of *Salmonella enterica* serovars Typhi and Paratyphi A. *J Clin Microbiol*. 2002; 40:633-6.
- 23- Kaneko H, Kawana T, Fukushima E, Suzutani T. Tolerance of loop-mediated isothermal amplification to a culture medium and biological substances. *J Biochem Biophys Methods*. 2007; 70: 499-501.
- 24- Nagamine K, Watanabe K, Ohtsuka K, Hase T, Notomi T. Loop-mediated isothermal amplification reaction using a nondenatured template. *Clin Chem*. 2001; 47: 1742-3.
- 25- Mori Y, Hirano T, Notomi T. Sequence specific visual detection of LAMP reactions by addition of cationic polymers. *BMC Biotechnol*. 2006; 6: 3.

- 26- Massi MN, Shirakawa T, Gotoh A, Bishnu A, Hatta M, Kawabata M. Rapid diagnosis of typhoid fever by PCR assay using one pair of primers from flagellin gene of *Salmonella typhi*. *J Infect Chemother.* 2003; 9:233-7.
- 27- Okamura M, Ohba Y, Kikuchi S, et al. Loopmediated isothermal amplification for the rapid, sensitive, and specific detection of the O9 group of *Salmonella* in chickens. *Vet Microbiol.* 2008; 132: 197-204.

Archive of SID

Comparison of the PCR and LAMP Techniques in the Diagnosis of *Salmonella* Infection

Moradi A¹, Karami A², Hagh Nazari A³, Ahmadi Z⁴, Soroori Zanjani R², Javadi SM¹

¹Zanjan University, Group of Biotechnology, Zanjan, Iran

²Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³Zanjan University, Faculty of Agricultural Sciences, Zanjan, Iran

⁴Molecular Biology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Corresponding Author: Karami A, Molecular Biology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Email: Karami@bmsu.ac.ir

Received: 5 May 2008 **Accepted:** 18 May 2009

Background and Objective: There are several techniques for the diagnosing of salmonella infectious. Several molecular methods such as PCR and hybridization assay have recently been used for the detection of this bacterium. However, these methods require precision instruments for amplification and complex procedures, which are the major obstacles to the widespread use of these methods in relatively small scale clinical laboratories, clinics and the filed laboratories. Recently, a new, rapid and sensitive technique called loop-mediated isothermal amplification (LAMP) was developed.

Materials and Methods: In this study we used 7 different strains of salmonella to compare the PCR with LAMP method. For PCR test we used thermocycler, but The LAMP reaction can be conducted under isothermal conditions by using only one type of enzyme and four primers recognizing six distinct regions. The most important merit of this method is that no denaturation of the DNA template is required, so, technique is simple and no need to thermocycler machine and several temperatures cycles.

Results: Conventional PCR method for the detection of *Salmonella* with standard thermocylcer takes 3 hrs but, with LAMP method we were able to amplify and detect the salmonella in very simple thermal block made in IRAN. After Optimization of the process it was possible to rapidly detect and identify *Salmonella typhi* bacteria within 90 minutes. This method was also 100 times more sensitive comparing to the PCR method.

Conclusion: According to the results, comparing LAMP isothermal amplification method for detection and identification of Salmonella with conventional PCR we have been able to determine the simplicity, speed (3 times) and the superior sensitivity(100 times) of the LAMP to PCR method. This Method is more simple, faster and cheaper (10 times). Another advantage is independence to cycle's temperature and thermo-cycling and replacement with one thermo block which is very simple, inexpensive and made in inside the country.

Key words: *Salmonella*, Isothermal, PCR, DNA, LAMP