

ساخت دستگاه اندازه‌گیری بیلی روین از طریق پوست در نوزادان

دکتر حمید آموزگار^{*}؛ دکتر مازیار رستگار^۲

۱. متخصص کودکان، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲. دستیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت: ۸۵/۷/۱۷؛ بازنگری نهایی: ۱۵/۱۲/۸۵؛ پذیرش: ۲۱/۲/۸۶

خلاصه

هدف: تخمین زده می‌شود که حدود ۵۰٪ نوزادان دچار زردی می‌شوند و تنها ۶٪ از آنها به زردی قابل توجه که نیازمند بررسی و اقدامات درمانی است، مبتلا می‌گردند. در این تحقیق اقدام به تهیه ایکتیومتری براساس رنگ پوست نوزادان در شیراز گردید تا بتوان از آن به عنوان یک وسیله غیر تهاجمی جهت غربالگری نوزادان مبتلا به زردی استفاده نمود.

روش مطالعه: در این مطالعه مقطعی ۹۲ نوزاد که به علت زردی به اسکرین نوزادان بیمارستان نمازی شیراز مراجعه کرده بودند توسط دستگاه ساخته شده مورد عکسبرداری از پوست پیشانی قرار گرفتند. با استفاده از پراکنندگی طول موج‌های زرد و میزان بیلی روین، طول موج زرد مطابق با صدک ۹۵ بیلی روین‌های ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۰٪ جهت تهیه ایکتیومتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس ۹ نوزاد زرد شده توسط ایکتیومتر ساخته شده بررسی شدند تا حساسیت و ویژگی دستگاه مشخص گردد.

یافته‌ها: حساسیت و ویژگی ایکتیومتر ۹۴٪ و ۵۵٪ و به همین ترتیب ارزش اخباری مثبت ۸۵٪ و ارزش اخباری منفی ۹۴٪ و میزان صحت (accuracy) آن نیز ۸۷٪ محاسبه گردید.

نتیجه‌گیری: براساس این مطالعه می‌توانیم در جمعیت شیراز و اغلب نقاط ایران که همین ترکیب جمعیتی و رنگ پوستی را دارند از ایکتیومتر تهیه شده به عنوان یک وسیله غربالگری در جهت کاهش موارد خون گیری نوزاد زرد شده استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی:

بیلی روین بالا؛ زردی نوزادی؛ اندازه‌گیری بیلی روین از طریق پوست؛ غربالگری نوزادان؛ ایکتیومتر

در حال حاضر تصمیم‌گیری برای لازم بودن یا نبودن خون‌گیری از یک نوزاد زرد شده بر اساس قضاآوت دیداری و مشاهده‌ای است که به صورت نظری (غیر عینی) بوده و اغلب با هر شدت از زردی نوزاد حتی در مقدارهای کم انجام می‌شود. بنابراین وجود یک وسیله غیر تهاجمی برای معین کردن مواردی را که احتیاج به خون‌گیری ندارد، بسیار مورد احتیاج است. هم اکنون دو نوع وسیله غیر تهاجمی با عنوان‌های بیلی-روین‌متر (jaundicemeter) و ایکتیومتر در دسترس می‌باشد و لی از آنچایی که این وسایل ساخت کشورهایی هستند که رنگ پوست جمعیت آنها با ایران تفاوت می‌کند و از طرفی آزمایشگاه‌های تعیین کننده مقدار بیلی روین سرم خون با هم اختلاف دارند، طراحی و ساخت ایکتیومتر که از لحاظ هزینه مقرر و به

مقدمه

تخمین زده می‌شود حدود ۵۰ تا ۶۵ درصد از نوزادان در نهایت از لحاظ مشاهده‌ای زرد می‌شوند ولی در حدود ۶٪ آنها هیبریلی روینیمی قابل توجه (بیش از ۱۲۹ میلیگرم در دسی لیتر) پیدا می‌کنند که احتیاج به اقدامات درمانی و تشخیصی دارند.^[۱] بنابراین تعداد قابل توجهی از نوزادان که به علت زردی از آنها نمونه خون گرفته می‌شود نیازی به انجام این عمل ندارند. نمونه‌گیری خون که از پاشنه پای نوزاد انجام می‌شود می‌تواند صدمات و عفونت بافت نرم و استخوان، درد نوزاد، نگرانی و اضطراب والدین، هزینه‌ها و زمانهای صرف شده اضافه و سختی کار پزشکان و پیراپزشکان را به همراه داشته باشد.^[۲]

* مسئول مقاله:

دوربین دیجیتال Benq 1500 که درون یک جعبه به ابعاد ۶×۷×۶/۲ cm کانوئی دوربین طراحی و ساخته شده بود) تعییه شده بود، گرفته می‌شد (شکل ۱). نور فلاش دوربین چنان تنظیم شده بود که تصویری با طول موجی مطابق واقعیت رنگ پوست ایجاد کند. این تصاویر مورد بررسی و آنالیز کامپیوتری قرار گرفت که این پردازش توسط نرم افزار Corel draw انجام شد (شکل ۲). به این ترتیب که ابتدا تصاویر گرفته شده توسط دوربین به فرمت CMYK تبدیل گردید در این فرمت Cyan نشان دهنده yellow (فیروزه‌ای)، Magenta M (قرمز) y معادل (زرد) K یا black معرف تیرگی عکس می‌باشد. در سیستم‌های دیجیتالی هر تصویر به نقاطی تبدیل می‌گردد که هر نقطه براساس CMYK تعریف می‌گردد. از هر تصویر میانگین، میانه و انحراف معیار میزان طیف نور (طول موج زرد) آن مشخص می‌شود و میانگین زردی عکس که عددی بین ۰-۲۵۵ بود توسط نرم افزار Corel draw معین می‌شد.

این فرایند در ۹۲ مورد مطالعه قرار گرفت. هیچ کدام از نوزادان سابقه فتورابی نداشتند هم‌مان با گرفتن عکس از نوزاد نمونه گیری خون از کف پا (پاشنه) جهت اندازه گیری بیلی‌روビین سرم خون نیز در هر نوزاد انجام می‌شد. میزان و مقدار Merk, TOITU BL200 هیستوگرام (که در نرم افزار Corel draw موجود بود) به

صرفه‌تر از بیلی‌روبینومتر باشد در جمعیت ایران با توجه به رنگ پوست جمعیت خاص خود لازم می‌نماید. علاوه بر اینکه بکارگیری این وسیله از هزینه‌های غیرضروری تعیین بیلی‌روبین سرم خون از طریق آزمایشگاه جلوگیری می‌کند و در زمان نیز صرفه‌جویی می‌شود. لازم به ذکر است قیمت ایکترومتر تقریباً ۳۰ دلار می‌باشد که در حدود یک صدم قیمت بیلی‌روبینومتر می‌باشد و این در حالیست که دقت هر دو ابزار برای غربالگری در زردی نوزاد یکسان است. به کارگیری این وسیله در مراکزی که امکان اندازه‌گیری بیلی‌روبین سرم خون را ندارند؛ همانند مراکز بهداشتی درمانی روستایی خانه‌های بهداشت از تعداد ارجاع‌های غیرضروری به مراکز بالاتر می‌کاهد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه در نوزادان مراجعه کننده به بخش غربالگری نوزادان بیمارستان نمازی شیراز انجام شد در این مطالعه مقطعی، نوزادانی که با زردی به اتفاقات نوزادان مراجعه می‌کردند مورد بررسی قرار گرفتند به این ترتیب که از هر نوزاد ۲ عکس از قسمت پیشانی نوزاد در حالی که پوست به وسیله یک شیشه فشرده (blanching) شده بود، گرفته شد. با تحت فشار دادن پوست به وسیله شیشه نور قرمز پوست که حاصل رنگ مویرگ‌های پوستی آن می‌باشد حذف می‌شود. عکس‌ها از طریق




شکل ۱- دستگاه مخصوص عکسبرداری از پوست نوزادان زرد شده بیمارستان نمازی شیراز ۸۴-۱۳۸۳



شکل ۲- هیستوگرام نرم افزار *Corel draw* در حال نمایش طیف طول موج نور زرد، میانه، میانگین، انحراف معیار طول موجهای نور زرد تصویر پوست نوزاد زرد شده می‌باشد (تصویر کوچک سمت چپ رنگ پوست عکسبرداری شده می‌باشد).

منحنی پراکندگی طبیعی در تمامی نوارهای زرد است آورده‌یم. طول موج نور زرد منطبق بر صدک ۹۵ و ۵۰ بیلروبین‌های mg/dl ، $5mg/dl$ ، $10mg/dl$ ، $15mg/dl$ ، $20mg/dl$ را بدست آورده‌یم. و از طریق این طول موج‌های معین شده نوارهای زرد (۴ عدد) برای هر کدام از صدک‌ها بدست آمد که با استفاده از نوارهای زرد منطبق بر پلاستیکی شفاف جایگزین شد) ایکترومتر تهیه گردید. سپس با

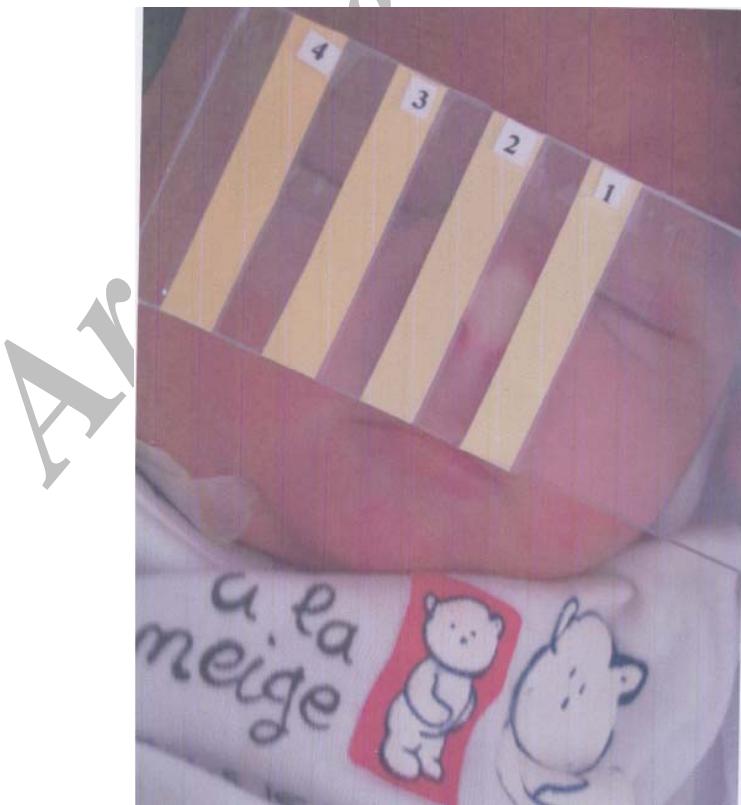

شکل ۳- تصویری از ایکترومتر تهیه شده در این مطالعه برای سنجش زردی نوزادان

Archive of SID

برای تشخیص زردی‌های قابل توجه که احتیاج به بررسی و ارزیابی دقیق دارند) $55/2\%$ معین شد. همچنین حساسیت (sensitivity) دستگاه ایکترومتر (ق fert تشخیص موارد مثبت زردی‌های غیرقابل توجه که احتیاج به خون‌گیری ندارند) $94/7\%$ محاسبه شد. ارزش اخباری مثبت (Positive predictive value) برابر با 85% و ارزش اخباری منفی (Negative predictive value) برابر با 94% معین شد (مثبت کاذب 15% و منفی کاذب 5%) و میزان صحت (accuracy) این تست نیز 87% محاسبه گردید.

بحث

این مطالعه بر این هدف استوار بوده است که با توجه به رنگ پوست نوزادان منطقه شیراز، بتوان وسیله‌ای را فراهم کرد که بتواند به عنوان غربالگری زردی نوزادان مورد استفاده قرار گیرد و به خانواده‌ها، پزشکان و متخصصین در تشخیص و اداره (Management) زردی نوزادان کمک کند. به کارگیری این وسیله که به عنوان ایکترومتر شناخته می‌شود در سایر تحقیقات نوزادان یک وسیله غربالگری مقرن به صرفه برای زردی نوزادان مورد تأیید قرار گرفته بود.^[۱۴-۲] هدف این مطالعه بر این اساس استوار بوده است که بتواند زردی‌های کم خطر نوزادان را شناسایی کند.

شوماخر و همکاران دریافتند که با حساسیت 82% و ویژگی 72% می‌توان میزان بیلی رویین نوزاد را غربالگری کرد.^[۱] آنها از لحاظ آمای متوجه رابطه معنی‌داری بین درجه ایکترومتر و عدد بیلی رویین سرم شدند ($r=0.63$) که در مطالعه ما $r=0.64$ بدست آمد که آنرا به صورت زیر بیان کردند.^[۹]

عدد ایکترومتر =

$4/72 + (\text{بیلی رویین سرم بر اساس واحد mol/lit}) \cdot 0/07$

دکتر نیک نفس در یک مطالعه بالینی، آینده نگر مقطعی در کرمان به رابطه خطی معنی‌داری (ضریب همبستگی 85%) و خطای معیار $0/004$ بین میزان اندازه گیری ایکترومتر و بیلی رویین سرم پی برد. و اندازه گیری بیلی رویین از طریق ایکترومتر را با حساسیت 95% و ویژگی 84% به عنوان یک روش مناسب برای غربالگری زردی نوزادان ایرانی (با ارزش اخباری مثبت 85% و ارزش اخباری منفی 94%) معرفی کرد.^[۲] تفاوت مهم این مطالعه با مطالعه انجام شده در کرمان این است که در کرمان از ایکترومتری به صورت آمده (تجاری) استفاده شده بود که در کشورهای غرب، رنگ پوست سفیدتر ساخته شده بود. تفاوت دیگر این بود که او برای مطالعه خود عدد $14/01$ را به عنوان یک نقطه عطف (Cut off point) غربالگری خود انتخاب کرد و هدف اصلی او شناسایی موارد زردی قابل توجه بود.^[۳]

قرار دادن ایکترومتر روی بینی نوزادان زرد شده و با وارد کردن کمی فشار و تحکیمه پوست از عروق موبیگی میزان زردی پوست که در بین نوارهای زرد نمایان می‌شد و یکی از نوارهای زرد که از لحاظ شدت زردی با آن مطابقت و مشابهت زیادتری داشت انتخاب می‌شد (شکل ۳).

بعد از تهیه ایکترومتر، این وسیله در گروه نوزادان زرد شده مراجعه کننده به اتفاقات مورد ارزیابی بالینی قرار گرفت تا میزان صحبت غربالگری بررسی شود؛ در این مرحله از مطالعه طبق مشاوره آماری حداقل 200 نوزاد جهت بررسی لازم بود، لذا 209 نوزاد که بهترتب در روزهای مختلف جهت بررسی زردی مراجعه نموده بودند توسط 6 نفر از کارورزان پزشکی، که در ابتداء به آنها آموزش لازم در مورد چگونگی استفاده از ایکترومتر داده بود، مورد بررسی قرار گرفتند و در هر یک از نوزادان علاوه بر اندازه-گیری بیلی رویین توتال سرم با به کارگیری ایکترومتر تخمینی از شدت زردی نوزاد انجام گردید.

این مطالعه هم در روز و هم در نور لامپ انجام شد و در این قسمت مطالعه محدودیتی از لحاظ ترم (term) بودن نوزاد یا نارس (preterm) بودن وجود نداشت. نتایج به کمک نرم افزار SPSS ویراست $13/5$ مورد بررسی آماری قرار گرفت و مقادیر به صورت میانگین (انحراف معیار) بیان گردید. از آزمون‌های همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون جهت مقایسه طول موج‌ها و ایجاد معادله مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها

در این مطالعه یک رابطه تعریف شده بین مقدار بیلی رویین سرم و طول موج نور زرد بدست آمده از پوست نوزاد بدست آورده‌یم؛ این رابطه براساس معادله زیر قابل بیان است:

$$TSB = 36 - 0.35(M) + 0.001(M^2) \quad [r=0.645]$$

در این رابطه M میانگین طول موج زرد پوست نوزاد و بیلی رویین سرم تام (Total Serum Bilirubin) می‌باشد. این رابطه ریاضی بیان می‌کند که از طیف نور 140 نانومتر به بالا میزان ارتباط بیلی رویین سرم با طول موج نور زرد حالت مستقیم دارد (میزان همبستگی پیرسون در این مطالعه $0/64$ بود).

با توجه به اینکه از هر نوزاد دو عکس گرفته شده بود تفاوت دو عکس گرفته شده از هر نوزاد از لحاظ طول موج نور زرد نیز از 209 لحاظ آماری معنی‌دار نبود. هنگام به کارگیری ایکترومتر در نوزاد زرد شده و تطبیق اعداد (درجه) ایکترومتر با بیلی رویین سرم نوزادان نتایج زیر حاصل شد:

میانگین درجه بیلی رویین سرم برای نوار 1 ، 8 mg/dl ، نوار 2 ، 11 mg/dl ، نوار 3 ، 15 mg/dl و نوار 4 ، 17 mg/dl و $17/5$ ، $13/3$ ، $10/5$ ، $17/6$ بود. صدک 95% برای آنها به ترتیب $14/01$ ، $14/01$ ، $14/01$ ، $14/01$ و $14/01$ بود. بنابراین ویژگی (specificity) ایکترومتر (C fert) این وسیله

شدن پوست کندر از مقدار سرعت افزایش درجه بیلی روین سرم می‌باشد بنابراین در ۳۶ ساعت اول تولد می‌باشد با احتیاط انجام شود.

- به کارگیری ایکترومتر در زیر نور لامپ مهتابی در ۲۶ درصد موارد عدد بیشتری از درجه ایکترومتر از حد آنچه در نور طبیعی روز مشاهده می‌گردد گزارش می‌کند.
- به کارگیری فوتوراپی به علت کاهش مقدار بیلی روین اولیه پوست باعث اختلال در انجام ایکترومتر می‌شود و درجه ایکترومتر عددی کمتر از آنچه بیلی روین سرم می‌باشد را تخمین می‌زند.
- ایکترومتر یک تست نظری (Subjective) است بنابراین به تجربه و دقت فرد تست کننده وابسته است^[۱].
- بالته بهتر است این مطالعه در سطح وسیع تر در نژادهای مختلف ایرانی با رنگ پوست مختلف، نوزادان نارس، در شرایط بیلی روین‌های بسیار بالا، بعد از فوتوراپی و همچنین دقت تخمین بیلی روین توسط والدین مورد آزمایش قرار گیرد.

نتیجه گیری

به کارگیری ایکترومتر در این منطقه می‌تواند ما را در کاهش هزینه‌های زمان‌های صرف شده، اضطراب والدین، درد نوزادان، آسیب بافتی و عفونت پای نوزادان، سختی نمونه گیری از نوزادان و تعداد نمونه گیری از نوزادان مراجعه کننده به پزشکان به علت زردی، یاری کند. اگرچه این وسیله براساس جمعیت این منطقه طراحی و ساخته شده است ولی با توجه به یکسان بودن و نبودن تفاوت از لحاظ ترکیب جمیعتی اغلب نقاط و شهرهای دیگر ایران می‌توان از این ایکترومتر در اغلب مناطق دیگر ایران نیز استفاده کرد. بخصوص در مناطقی چون خانه‌های بهداشت که امکانات اندازه گیری بیلی روین سرم خون از طریق نمونه گیری خون وجود ندارد که خود می‌تواند مراجعات بی مورد به مراکز بالاتر بهداشتی درمانی را کاهش دهد.

سپاسگزاری

این طرح با پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شماره طرح ۲۷۲۲ (۲۰۱۴) انجام گرفته است. این طرح در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی با شماره (۳۴۵۹۶) به ثبت رسیده است.

گوپتا و همکاران در هند (در هندوستان درجه تیرگی پوست از جمعیت ایران زیادتر است) نشان دادند که رابطه بین درجه اندازه گیری زردی نوزاد از طریق ایکترومتر و روش اندازه گیری خون، قابل توجه می‌باشد (۹۹/۰=۳۰)^[۲] و نشان دادند که در گروه‌های مختلف حساسیت و ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی بالایی دارد.^[۱]

این مطالعه و مطالعه‌ای که در نژادهای تیره پوست مثل نوزادان عربستان توسط کرار و حبیب انجام گرفت این مسئله را مورد تایید قرار دادند.^[۴] از طرفی در زردپستان چینی نیز این تحقیقات توسط بین و جو و نیز فوک انجام شده است.^[۱] و این در حالی است که مطالعاتی که بر روی سفید پوستان اروپایی (دانمارکی و ایرلندی ...) انجام گرفته بود صحت این غربالگری را در گروه‌های با رنگ پوست تیره نامعلوم بیان کردند. به صورت کلی در مطالعات انجام شده ضریب همبستگی بین بیلی-روبین اندازه گیری شده از طریق پوست و از طریق سرم بین ۹۳ الی ۹۳ درصد گزارش شده است.^[۴] با این وجود به کارگیری ایکترومتر به عنوان وسیله‌ای برای تعیین میزان دقیق بیلی روین سرم اثبات و مطرح نشده است و این به خاطر وجود فاکتورهای است که می‌تواند رنگ پوست و قضاوت در مورد تخمین عدد ایکترومتر را دچار اختلال کند (از قبیل میزان هماتوکریت خون میزان پیگمانت پوست وجود اکیموزیس پوستی و...) ولی این فاکتورها محدودیتی را از لحاظ نقش غربالگری این وسیله، ایجاد نمی‌کند.^[۱]

بریسکو و همکاران بیان کردند که با توجه به اختلاف رنگ پوست جمعیت‌های مختلف و نیز انواع مختلف ایکترومتر که در هر کشوری ممکن است به یک صورت تهیه شود، می‌بایست بر اساس تحقیق یک حد معین از مقدار بیلی روین را برای غربالگری قرار داد و این در ماهیت قضیه که ایکترومتر به عنوان یک وسیله غربالگر می‌تواند در جمعیت‌های مختلف ایقاع نقش کند خللی وارد نمی‌کند.^[۱]

بدون استفاده از ایکترومتر تصمیم در جهت گرفتن نمونه خون برای ارزیابی بیلی روین خون براساس مشاهده و تخمین چشمی و نظری یا سلیقه‌ای انجام می‌شود که می‌تواند همراه با اشتباهاتی قابل توجه باشد. علاوه بر این، مطالعات مختلف در مورد کاهش میزان عفونت و درد و هزینه به نتایج مشابه رسیده‌اند.^[۱] بنابراین با توجه به بالا بودن قابلیت پذیرش، تکرار پذیری آزمون، دارا بودن صحت و قابلیت اعتماد ایکترومتر در شناسایی زردی‌های کم خطر، می‌توان کرد که ایکترومتر می‌تواند وسیله خوبی در جهت گرفتن نمونه از زردی نوزاد باشد.

با این حال به کارگیری ایکترومتر در مواردی، دارای محدودیت‌هایی است^[۱] که به آن اشاره می‌کنیم:

- هنگامی که همولیز شدید وجود دارد مقدار تخمین ایکترومتر از مقدار واقعی کمتر می‌باشد چرا که سرعت زرد

Making a Transcutaneus Icterometer in Neonates

Hamid Amoozgar^{*1}, MD; Maziar Rastegar², MD

1. Pediatrician, Department of Pediatrics, Shiraz University of Medical Sciences, IR Iran
2. Resident in Pediatrics, Shiraz University of Medical Sciences, IR Iran

Received: 06/10/06; Revised: 04/03/07; Accepted: 10/05/07

Abstract

Objective: Approximately 50% of newborn develop jaundice, however only 6% of them have significant hyperbilirubinemia that need more evaluation. Actually, most of sampling (50-90%) for detection of hyperbilirubinemia is not necessary and cause some problems such as infection, tissue injury, pain, discomfort, wasting time and money. So non-invasive methods is desirable to decrease unnecessary sampling.

Material & Methods: This study performed on neonates who referred to Shiraz University of Medical Science affiliated Nemazee hospital neonatal emergency room due to jaundice. Initially 92 neonates were selected. After taking digital images and calculating mean and 95 percentile yellow wave's lengths of forehead skin and detection of total serum bilirubin, the correlation between wave's lengths and serum total bilirubin were determined. 95 percentile of skin yellow wave lengths that determined bilirubin level of 5, 10, 15 and 20 mg/dl were used for making 4 yellow strips of the icterometer. This icterometer was used for screening of 209 neonates who referred for evaluation of jaundice.

Findings: Using icterometer in evaluation of 209 neonates with jaundice demonstrated sensitivity 94.7%, specificity 55.2%, positive predictive value of 85%, negative predictive value of 95% and accuracy 87%.

Conclusion: This Icterometer can be applied as a screening tool in neonatal hyperbilirubinemia to detect less significant degree of hyperbilirubinemia that doesn't need sampling in Shiraz and even other regions of Iran with the same skin color.

Key Words: Hyperbilirubinemia; Neonatal jaundice; Transcutaneus bilirubinometry; Neonatal screening; Icterometer

REFERENCES

1. Ashima, M, James R, David K. Neonatal hyperbilirubinemia. In: Taeusch H, Ballard R, Gleason C(eds). Avery's diseases of the newborn. 8th ed. Philadelphia: Elsevier-Saunders. 2005; Pp:1226-53.
2. Stoll B, Kleigman R. Jaundice and hyperbilirubinemia in the newborn. In: Behrman R, Kliegman R, Jenson H(eds). Nelson text book of pediatric. 17th ed. Philadelphia: Saunders. 2004; Pp:592-9.
3. Niknafs P. Effectiveness of transcutaneus bilirubinometry to Screening of significant hyperbilirubinemia in city of Kerman. J Kerman Med Uni (Persian). 1996;3(3):109-14.
4. Jian D, David M, John K. Transcutaneus bilirubinometry: its role in the Assessment of neonatal jaundice. Clin Biochemist. 1997;30(1):1-9.
5. Merritt K, Coulter D. Application of the Gosset icterometer to screen for clinically Significant hyperbilirubinemia in premature infant. Perinatol. 1994;14(1):58-65.

* Correspondence Author;

Address: Department of Pediatrics, Namazee Hospital, Shiraz, IR Iran

E-mail: E-mail: amozgah@sums.ac.ir

6. Jeffrey M, Kring BE. Transcutaneous Bilirubinometry. Decreases the need for Serum bilirubin Measurement and Saves money. *Pediatr.* 1997;99(4):599-600.
7. Peterson J, Okorodudu AO, Mohammad AA, et al. Association of transcutaneous bilirubin testing in hospital with decreased readmission rate for hyperbilirubinemia. *Clin chem.* 2005;51(3):540-4.
8. Donzelli G, Pratesi S. Transcutaneous Bilirubinometry in healthy preterm newborns. *Clin Biochem.* 2000;33(6):505-8.
9. Schumacher RE, Thornberry JM, Gutcher GR. Transcutaneous bilirubinometry: a comparison of old and new method. *Pediatr.* 1985;76(1):10-14.
10. Maisels MJ, Kring E. Transcutaneous bilirubinometry decreases the need for Serum bilirubin measurement and saves money. *Pediatr.* 1997;99(4):599-601.
11. Movrison R, Wilkinson D. An evaluation of the icterometer. *Pediatr.* 1962;29(5):740-2.
12. Gupta P, Kumari S, Lal U. Icterometer a useful Screening tool for neonatal Jaundice. *Indian Pediatr.* 1991;28(5):473-6.
13. Dai J, Parry DM, Krahn J. Clinical impact of transcutaneus bilirubinometry as an adjunctive screen for hyperbilirubinemia. *Clin Biochem.* 1996;29(6):581-6.
14. Briscoe L, Clark S, Yoxall CW. Can transcutaneus bilirubinometry reduce the need for blood tests in jaundice full term babies? *Arch Dis Childhood Fetal Neonatal.* 2002;86: F190-2.