

## طیف‌نگاری ساختار DNA به کمک رنگدانه‌های مصنوعی با استفاده از نور LED

سید میلاد هاشمی، سمیه سلمانی و محمدحسین مجلس آرا\*

دریافت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ / پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

\*مسئول مکاتبات: majlesara@khu.ac.ir

**چکیده.** واضح است که دستگاه‌های تشخیص غلظت DNA در زمینه‌های ژنتیک و زیستی و بیوتکنولوژی کاربرد زیادی دارند. بر این اساس، تعدادی دستگاه مشابه با نور لیزر طراحی شده است که معایب آن قیمت بالا و استفاده از مقادیر قابل ملاحظه از نمونه می‌باشد. دستگاه طراحی شده با نور LED کار می‌کند که هزینه ساخت این دستگاه را بسیار ارزان‌تر می‌کند. مقادیر DNA استفاده شده در این دستگاه بسیار کم و در حدود چند میکرولیتر می‌باشد و اندازه‌گیری سریع و کوچک و قابل حمل بودن آن نیز از امتیازات این دستگاه می‌باشد. داده‌های خروجی از این دستگاه به صورت ولتاژ بر حسب زمان و تبدیل فوریه آن، یعنی تبدیل فرکانسی ثبت می‌شود. از نمودارهای فرکانسی بدست آمده می‌توان با استفاده از قانون بیرلامبرت به غلظت نسبی DNA و سنجش ویروس‌ها و اندازه‌گیری میزان آسیب به DNA و کاربردهای بسیار دیگر پی برد. با استفاده از این دستگاه، غلظت DNAهای رنگ شده با سه رنگینه مختلف توسط دستگاه فلورومتر اندازه‌گیری شد.

**واژه‌های کلیدی.** رنگدانه، فلورومتر، فرکانس، غلظت DNA

## DNA structure spectroscopy by synthetic pigments using LED lighting

Seyed Milad Hashemi, Somayeh Salmani and Mohammad Hossein Majles Ara\*

Received 08.07.2015 / Accepted 09.03.2016

Photonic Lab, Faculty of Physics, Kharazmi University, Tehran, Iran

\*Correspondent author: majlesara@khu.ac.ir

**Abstract.** It is clear that DNA concentration and biological detection devices have many applications in the fields of genetics and biotechnology. For this goal, some similar devices have been designed working with the laser light which the disadvantages of them are high prices and the use of significant amounts of sample volume. But this designed device which works with LED light has very cheap manufacturing cost. The amounts of DNA used in this device are very low, about a few micro-liters and measurement of small, fast and portable it is also the advantages of these devices. The Data recorded as voltage versus time and the Fourier transform the frequency domain. From the frequency curve, by using the Byrlambrt it is possible to obtain the relative concentrations of DNA, viruses and assays measuring DNA damage and many other applications. By use of this device, the concentration of DNA colored with three different pigments was measured.

**Keywords.** pigments, flurometer, frequency, concentration, DNA

## مقدمه

در این پژوهش از سه نوع رنگدانه سایبر گرین برای رنگ آمیزی DNA استفاده شده است که این رنگدانه از رنگدانه های مصنوعی است که به رنگ سبز می باشد و دارای وزن مولکولی  $g\ mol^{-1}$  ۵۰۹ و ۷۳ و فرمول شیمیایی  $C_{32}H_{37}N_4S^+$  است. همچنین سایبر گرین حداکثر جذب در طول موج ۴۹۰ نانومتر و حداکثر انتشار در طول موج ۵۲۰ نانومتر را دارد. نمونه های آماده شده عبارتند از: ۱- DNA رنگ آمیزی شده با مولکول رنگ سایبر گرین از نوع ۵۸ که از سلول های گیاهی استخراج شده است که دارای ضربیب مولار ۰/۲. و غلظت ۴۴۰ میکرومولار می باشد؛ ۲- DNA رنگ آمیزی شده با مولکول رنگ سایبر گرین از نوع d6 که از سلول های گیاهی استخراج شده است که دارای ضربیب مولار ۰/۲. و غلظت ۱۸۴ میکرومولار می باشد؛ ۳- DNA رنگ آمیزی شده با مولکول رنگ سایبر گرین از نوع مولوئیکا که دارای ضربیب مولار ۰/۲. و غلظت ۲۱۲ میکرومولار می باشد.

## چیدمان آزمایشگاهی

فلورومتر مبتنی بر LED دارای چهار بخش اصلی می باشد: ۱- سیستم انتشار نور (LED و مدار کنترل)؛ ۲- آشکارساز نور سیستم (فلیتر و فوتودیود و مدار تقویت کننده و مبدل آنالوگ به دیجیتال)؛ ۳- سیستم ارسال اطلاعات (مدار کنترل، آی سی DAQ و مبدل سریال به USB)؛ ۴- سیستم پردازش سیگنال الکترونیکی که در شکل ۱ نشان داده شده است.

در سال های اخیر، تعیین غلظت DNA در بررسی های زیستی بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است & (Alberti, Mergny, 2003)، برهمن مین مینا، دستگاه های اندازه گیری لیزری در سال های اخیر طراحی و ساخته شده اند که بسیار گران قیمت می باشند (Yan et al., 2002). بدین منظور، دستگاه فلورومتر طراحی شده ابزاری ضروری در مطالعه DNA می باشد که نسبت به دستگاه های مشابه بسیار ارزان می باشد. روش این دستگاه از این واقعیت بهره می گیرد که یک مولکول رنگینه فلورسنت دهنده به وسیله منبع نوری که می تواند انرژی خود را به یک مولکول رنگ فلورسنت پذیرنده بفرستد، تحریک می شود و این مولکول رنگ دوم دارای یک باند جذب است که با باند گسیل رنگ اول تداخل می کند. میزان انرژی انتقال بین دو مولکول قویاً تابع فاصله بین آن هاست، (Simmel & Yurke, 2002)، بنابراین تشخیص یا تغییر در فلورسانس رنگ دهنده و یا تغییر در فلورسانس رنگ پذیرنده یا هر دو به ما اجازه می دهد، به تغییرات پیکربندی در سازه های نانو که به رنگ متصل می شوند، پی ببریم. دستگاه اندازه گیری فلورسانس شرح داده شده در این تحقیق با عبور از فیلتر های خاص، اجازه می دهد تنها انرژی (FRET) که در آن تنها فلورسانس رنگ دهنده است را اندازه گیری کنیم (Mao et al., 1999)، با استفاده از نمودار های استاندارد می توان در تشخیص تفاوت DNA های سلول های مختلف به عنوان مثال DNA های سالم و بیمار و کنترل کیفی DNA و سنجش میزان بیان ژن و اندازه گیری میزان آسیب به DNA پی برد (Yurke et al., 2000).



شکل ۱- قسمت الکترونیکی دستگاه تعیین غلظت DNA.



Fig. 1. The electrical part of device for determination of DNA concentration.

می‌کند و می‌تواند اطلاعات را با سرعت به پورت USB کامپیوتر منتقل نماید. اطلاعات توسط میکرو با سرعت ۳۸۴۰۰ بیت بر ثانیه از مبدل ارسال می‌شود. آخرین بخش دستگاه فلورومتر سیستم پردازش سیگنال الکترونیکی است که اطلاعات بهوسیله پورت USB کامپیوتر توسط نرم‌افزار نوشته شده تحت زبان شی گرای ویژوال بیسیک دریافت می‌شود و به صورت RealTime نمایش داده می‌شود و در واحدهای زمانی مشخص ۱ ثانیه از اطلاعات دریافتنی تبدیل فرکانس FFT گرفته می‌شود و در نرم‌افزار به نمایش در می‌آید. نرم‌افزار امکان بزرگنمایی در مقدار و زمان را دارد و امکان ذخیره اطلاعات به صورت داده و عکس به صورت ولتاژ بر حسب زمان و فرکانس را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

### روش انجام آزمایش


در ابتداء طیف نور گسیلی از دیود LED که دارای طول موج ۲۵۰ nm می‌باشد توسط میکروکنترل به صورت امواج پالسی ۱۰ تا ۲۰ هرتز تبدیل می‌شود. سپس با گذراندن این طیف از فیلتر دارای باند گذار متناسب با طیف برانگیختگی مولکول رنگ موردنظر به نمونه برخورد می‌کند. نمونه DNA قبل توسط مولکول رنگ مورد نظر رنگ آمیزی شده است. که این مولکول رنگ مطابق شکل ۲ به هارپین DNA متصل می‌شود (Stryer, 1967 & Haugland, 1967)، این مولکول رنگ‌ها توسط طیف گسیلی برانگیخته می‌شوند و او خود نور ساطع می‌کنند. همان‌طور که فاصله این دو کاهش می‌باشد، فلورستن دهنده به صورت گسیل دفع می‌شود (Heller & Morrison, 1995). تغییر در فلورسانس ایجاد شده، تغییر در جابجایی بین رنگ‌ها را می‌دهد که نشان‌دهنده حرکت مولکول‌ها در DNA می‌باشد. اندازه‌گیری فلورسانس ساطع شده از رنگ متصل به رشته‌های DNA به طور موثر نشان دهنده فاصله بین رنگ‌ها می‌باشد (Niemeyer & Adler, 2002).

سیستم انتشار نور دستگاه فلورومتر شامل قسمت‌های زیر می‌باشد: ۱- LED: برای تولید نور از LED‌های دارای توان ۱ وات و ولتاژ ۳ ولت و جریان ۳۰۰ میلی آمپر و طول موجهای مختلف استفاده می‌شود؛ ۲- مدار کنترل: میکرو کنترل وظیفه‌ی ایجاد پالس‌های نوری بین ۱۰ تا ۲۰ هرتز را دارد که برای روشن و خاموش کردن LED استفاده می‌شود و نیز از تداخل این امواج با نور حالت ثابت و هارمونیک جلوگیری می‌کند. همچنین قطعات سیستم آشکارساز به شرح زیر است: ۱- فیلتر: از فیلترهای دارای باند گذار ۴۹۰ نانومتر و ۵۲۰ نانومتر برای تحریک بهینه‌ی نور LED قبل و بعد از برخورد به نمونه‌ی آزمایش استفاده می‌شود؛ ۲- فوتودیود: فوتودیود که وظیفه دریافت فلورسانس ساطع شده از نمونه را دارد از نوع RadioShack می‌باشد؛ ۳- مدار تقویت کننده: از آی سی AD633 جهت تقویت سیگنال ضعیف دریافتی از فوتودیود تا ۳۰ برابر و کاهش نویز همراه سیگنال استفاده می‌شود؛ ۴- مبدل آنالوگ به دیجیتال: از آی سی AD7816 جهت تبدیل سیگنال آنالوگ فوتودیود به دیجیتال استفاده می‌شود. این آی سی توانایی نمونه‌برداری تا سرعت ۲۰۰ کیلوهرتز و دقت ۱۲ بیت را دارد. قسمت سوم این دستگاه سیستم ارسال اطلاعات است که شامل ۱- مدار کنترل: میکروکنترل Atmega16 ساخت شرکت Atmel که با فرکانس ۸ مگا هرتز و ولتاژ ۵ ولت در این مدار استفاده شده که وظیفه دریافت اطلاعات دیجیتال از فوتودیود و ارسال این اطلاعات به کامپیوتر را دارد؛ ۲- آی سی DAQ: در این مدار جهت جمع آوری داده‌ها و نیز به خاطر کم کردن هزینه‌ها و بالا بردن سرعت پردازش از حافظه داخلی میکرو که ۱۰۲۴ بایت می‌باشد، استفاده می‌شود. اطلاعات به صورت نرم‌افزاری در صدم ثانیه توسط میکرو دریافت و در این حافظه ابانته و جهت ارسال به کامپیوتر آماده می‌شود؛ ۳- مبدل سریال به USB: جهت ارسال اطلاعات به کامپیوتر از پورت سرعت بالای USB استفاده می‌شود اما قبل از ارسال اطلاعات نیاز است که اطلاعات سریال میکرو به USB تبدیل شود. جهت انجام این تبدیل از FTDI مبدل Serial to USB FT232 ساخت شرکت FTDI استفاده شده است. این مبدل ۱۰۲۴ بیت گنجایش ذخیره اطلاعات را دارد و از پروتکل‌های USB1 و USB2 پشتیبانی

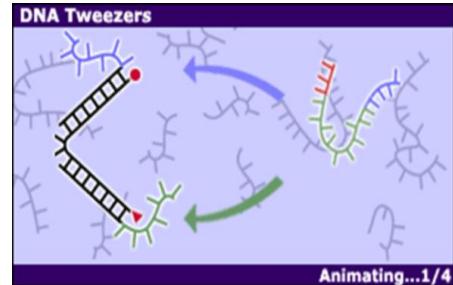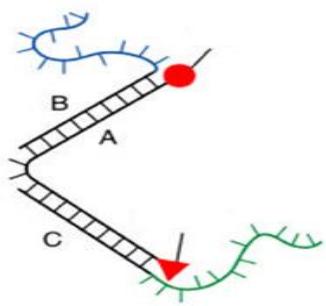

شکل ۲- نحوه اتصال مولکول رنگ‌ها به ساختار DNA

Fig. 2. The style of connection between pigment molecules to DNA structure.

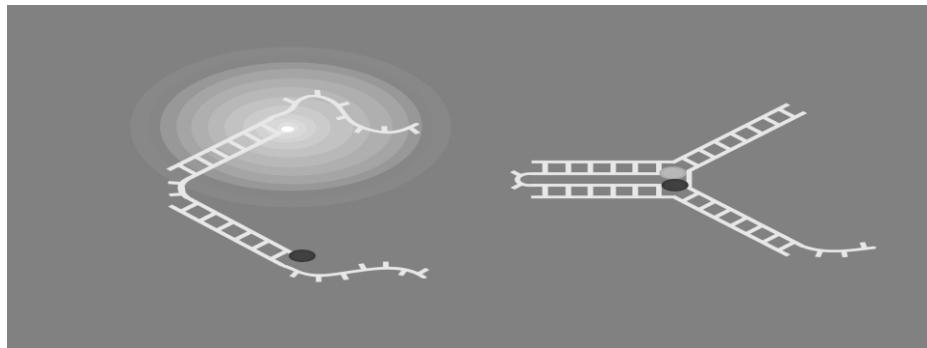

شکل ۳- انتشار نور فلورسانس توسط مولکول رنگیه.

Fig. 3. The fluorescent beam propagation by pigment molecule.

دست آمده به صورت مستقیم به سطح فلورسانس مشخص شده بستگی دارد (Smith *et al.*, 1992).

سپس این اطلاعات توسط آی سی DAQ جمع‌آوری شده و توسط مبدل سریال به USB به منظور پردازش اطلاعات توسط نرم‌افزار نوشته شده به زبان برنامه نویسی شی گرای ویژیوال بیسیک به کامپیوتر فرستاده می‌شود. این اطلاعات در این نرم-افزار به صورت ولتاژ بر حسب زمان و تبدیل فوریه آن به صورت فرکانسی نمایش داده می‌شود. تبدیل فوریه نوعی تبدیل است که یکتابع را بصورت توابع پایه‌ای سینوسی که هر کدام در مقادیری ضرب شده‌اند، نشان می‌دهد. اگر بردار X را مقادیر یک سری زمانی در نظر بگیریم، که  $(t)X$  مقدار مشاهده شده در زمان t است، تبدیل فوریه بروی این بردار، مقادیر آن را از دامنه زمانی به دامنه فرکانسی منتقل می‌کند. ضرایب بدست

شکل ۳ نشان می‌دهد که فلورسانس دهنده تابعی از فاصله بین مولکول فلورسانس می‌باشد. فلورسانس گسیلی از نمونه با عبور از فیلتر دارای باند گذار مناسب با طیف انتشار مولکول رنگیه مورد نظر منتشر می‌شود. فلورسانس گسیلی توسط سیلیکون فوتودیود جذب می‌شود. سیگنال خروجی از فوتودیود توسط آمپلی فایر تقویت شده و مقداری از نویز اپتیکی آن گرفته می‌شود. سپس توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال از حالت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده سپس سیگنال خروجی از مبدل با سیگنال خروجی که به صورت مستقیم از LED دیود به مدار کنترل می‌آید، تداخل می‌کند. این امر به این دلیل می‌باشد که طیف زمینه‌ی نور LED از طیف گسیلی از نمونه DNA کسر شود؛ زیرا فقط طیف فلورسانس حاصل از نمونه برای ما اهمیت دارد و نشان دهنده فلورسانس DNA مربوطه می‌باشد. این سیگنال به-

عبور نور یا ضخامت ماده جاذب، C غلظت ماده جاذب، I شدت نور تاییده شده و I شدت یا توان نور منتقل شده است. بر طبق این رابطه میزان جذب در یک فرکانس مشخص، مستقیماً متناسب با غلظت ماده و طول آن است. نسبت دامنه فرکانس یا ولتاژ بدست آمده توسط سری فوریه متناسب است با نسبت شدت قبل و بعد از برخورد با نمونه می‌باشد. با داشتن ضریب جذب مولار DNA و طول سلول حاوی نمونه‌ی DNA می‌توان غلظت نمونه DNA را تعیین نمود.


### نتایج و بحث


همان‌طور که بیان شد DNA رنگ آمیزی شده با مولکول رنگ سایبرگرین از نوع ۵۸ که از سلول‌های گیاهی استخراج شده است، دارای ضریب مولار ۰/۲. و غلظت ۴۴۰ میکرومولار می‌باشد. با قرار دادن پارامترهای  $I_0 = ۱۳۰.۰۰۰$ ،  $I = ۱۴۰.۰۰۰$ ،  $L = ۰.۳۶۵\text{ mm}$  و  $\epsilon = ۰/۲$  به صورت  $A = \log \frac{1}{T} = \log \frac{I_0}{I} = -\epsilon cL$  می‌آید.

آمده از تبدیل فوریه به گونه‌ای مرتب شده قرار می‌گیرند به‌طوری که ضرایب پر اهمیت در سمت چپ و ضرایب کم اهمیت‌تر در سمت راست قرار می‌گیرند. بنابراین پر اهمیت‌ترین ضریب در  $(0)X$  و کم اهمیت‌ترین ضریب در  $(N-1)X$  ذخیره شده است. هرچه یک ضریب پر اهمیت‌تر باشد، بدان معنی است که آن ضریب حاوی اطلاعات مهم‌تری (کلی‌تری) از بردار X می‌باشد.

از نمودارهای فرکانس و دامنه فرکانس به‌دست آمده می‌توان با استفاده از قانون بیر-لامبرت غلظت نسبی DNA مورد نظر را به دست آورد. طبق قانون لامبرت، در غلظت ثابت با افزایش طول ماده، میزان نور جذب شده به تناسب افزایش می‌یابد. طبق قانون بیر-نیز میزان جذب ماده تابع غلظت اجزای ماده می‌باشد. ترکیب این دو قانون تحت قانون بیر-لامبرت بیان می‌شود که رابطه آن به صورت  $A = \log \frac{1}{T} = \log \frac{I_0}{I} = -\epsilon cL$  بیان می‌شود که در آن A میزان جذب T ضریب انتقال،  $\epsilon$  ضریب جذب مولار (که تابع ساختار شیمیایی ماده‌ی جاذب می‌باشد)، L طول مسیر

الف

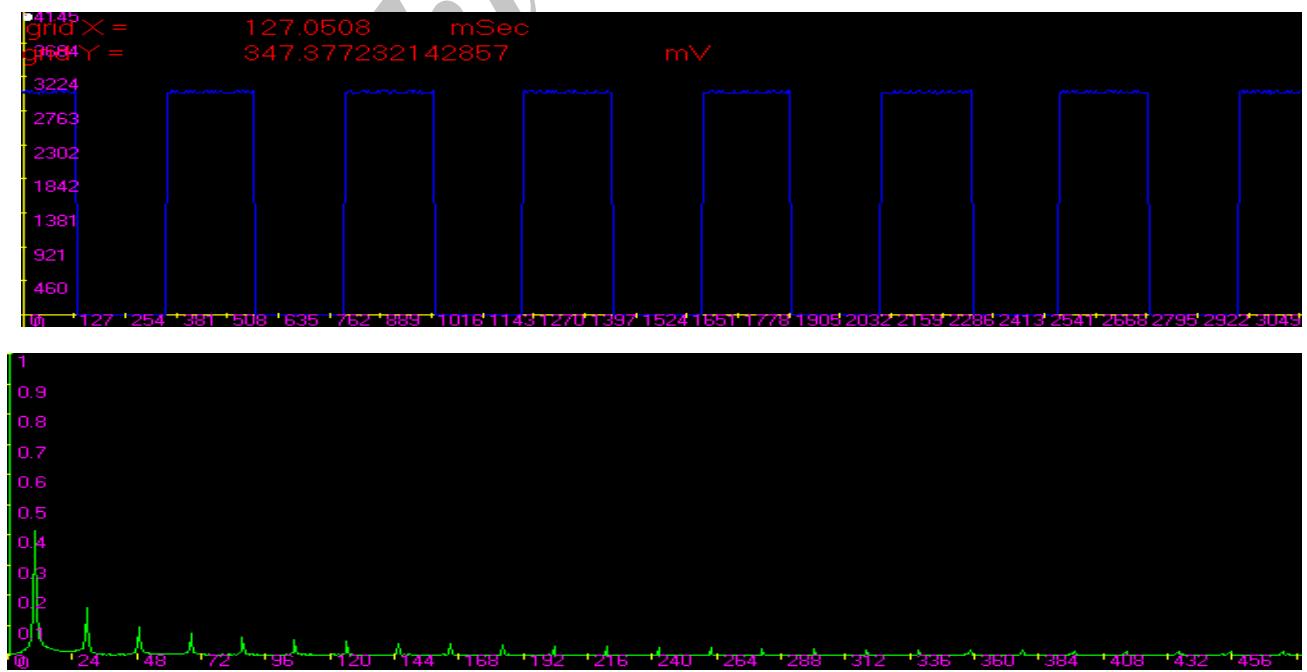

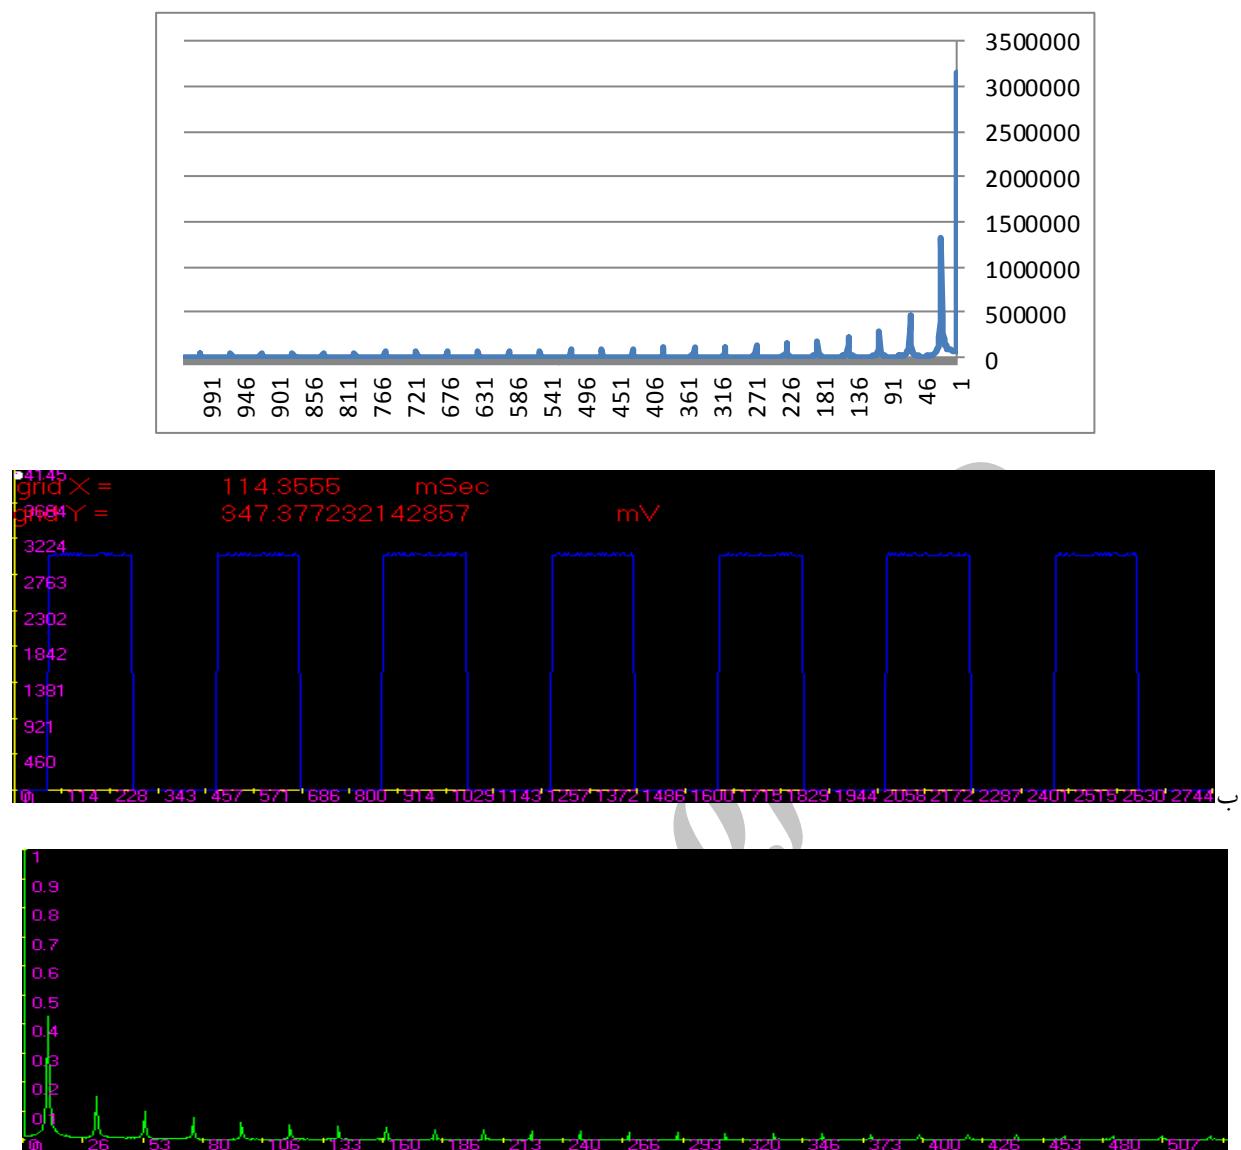


شکل ۴- نمودار طیف ولتاژ بر حسب زمان و دامنه ولتاژ حالت (الف) بدون ماده، (ب) با ماده.

Fig. 4. The plot of voltage spectrum versus of time and amplitude for (a) without sample and (b) with sample.





$$A = \log \frac{I}{I_0} = \log \frac{\mu m}{\mu m} = \log \frac{1}{T} = -\epsilon c L$$


فرمول  $c = 183/38 \text{ } \mu\text{m}$  به دست می‌آید.

در ادامه DNA رنگ آمیزی شده با مولکول رنگ سایبر گرین از نوع d6 که از سلول‌های گیاهی استخراج شده است، دارای ضریب مولار  $\epsilon = 184$  میکرومولار می‌باشد.  $L = 1357400 \text{ mm}$  و با جایگذاری در  $I = 1400000$  و  $\mu m = 0.2$

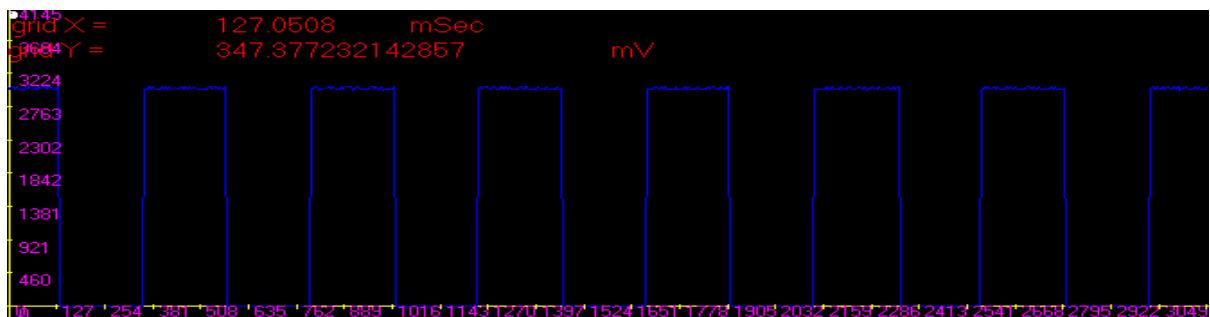

الف

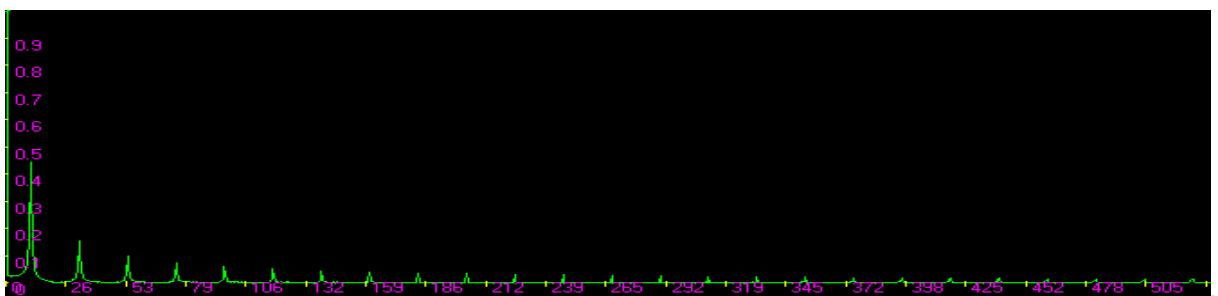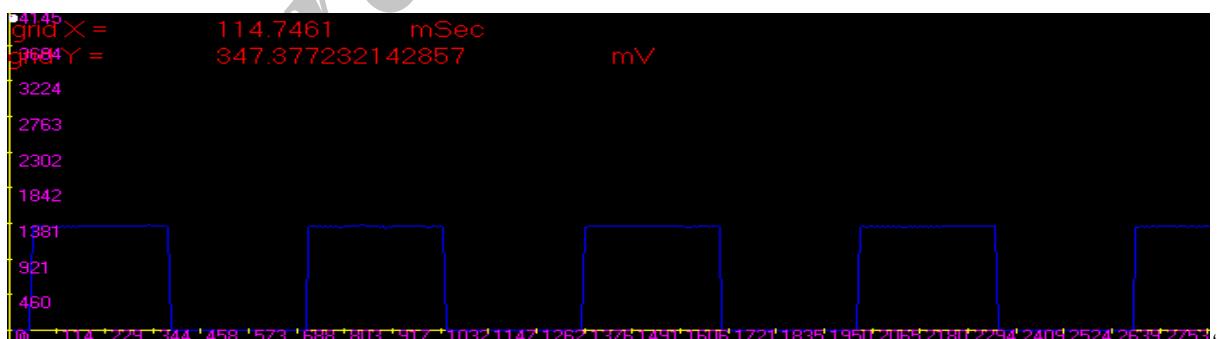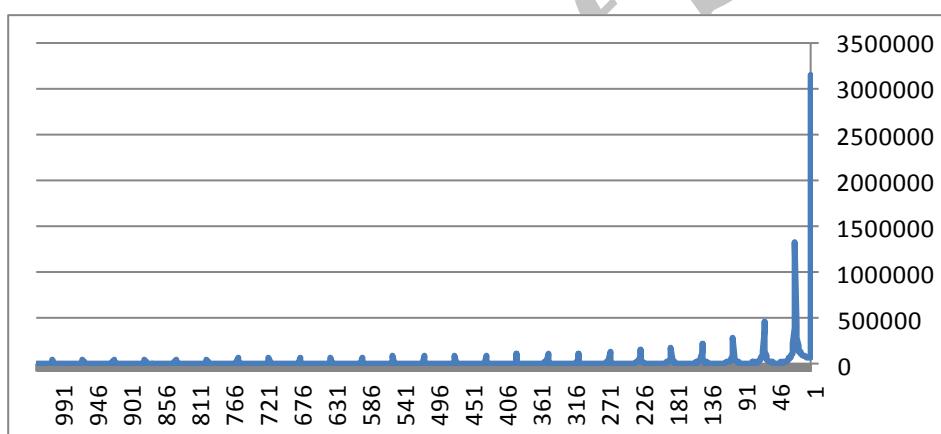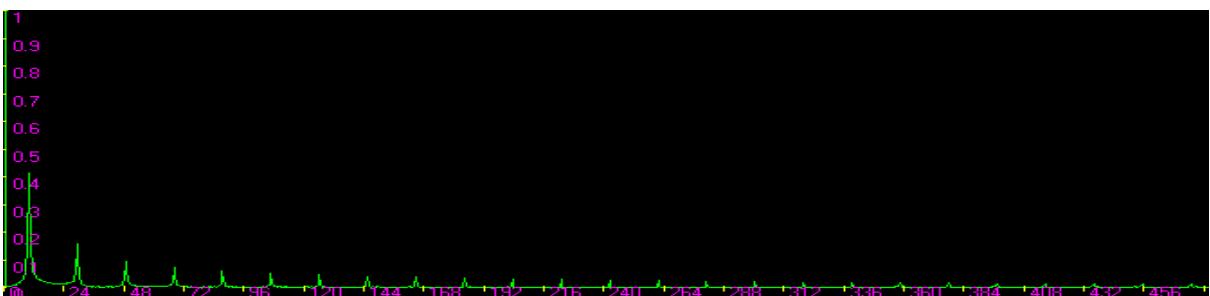

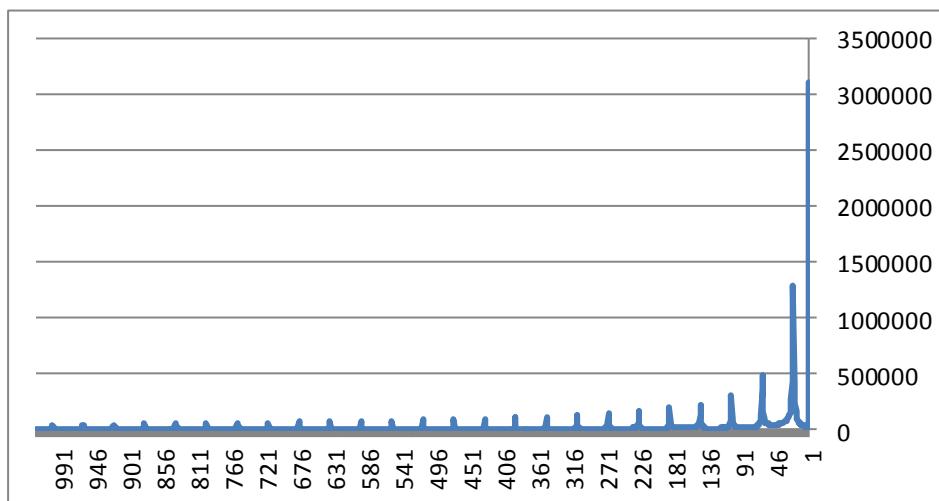



شکل ۵-نمودار طیف ولتاژ بر حسب زمان و دامنه ولتاژ حالت (الف) بدون ماده، (ب) با ماده.

Fig. 5. The plot of voltage spectrum versus of time and amplitude for (a) without sample and (b) with sample.

در نهایت نیز  $L = .۳۶۵\text{mm}$  و با جایگزاري در فرمول  $A = \log \frac{1}{T} = \log \frac{I_0}{I} = -\varepsilon cL$  به دست می آید.

در نهایت نیز DNA رنگآمیزی شده با مولکول رنگینه سایبرگرین از نوع مولوئیکا که از سلولهای گیاهی استخراج شده است، میباشد که دارای ضریب مولار  $\varepsilon = ۲۱۱.۹۵\text{ }\mu\text{m}^{-۱}$  و غلظت  $I_0 = ۱۴۰\text{ }\mu\text{M}$  میکرومولار می باشد.  $I = ۱۳۵\text{ }\mu\text{A}$

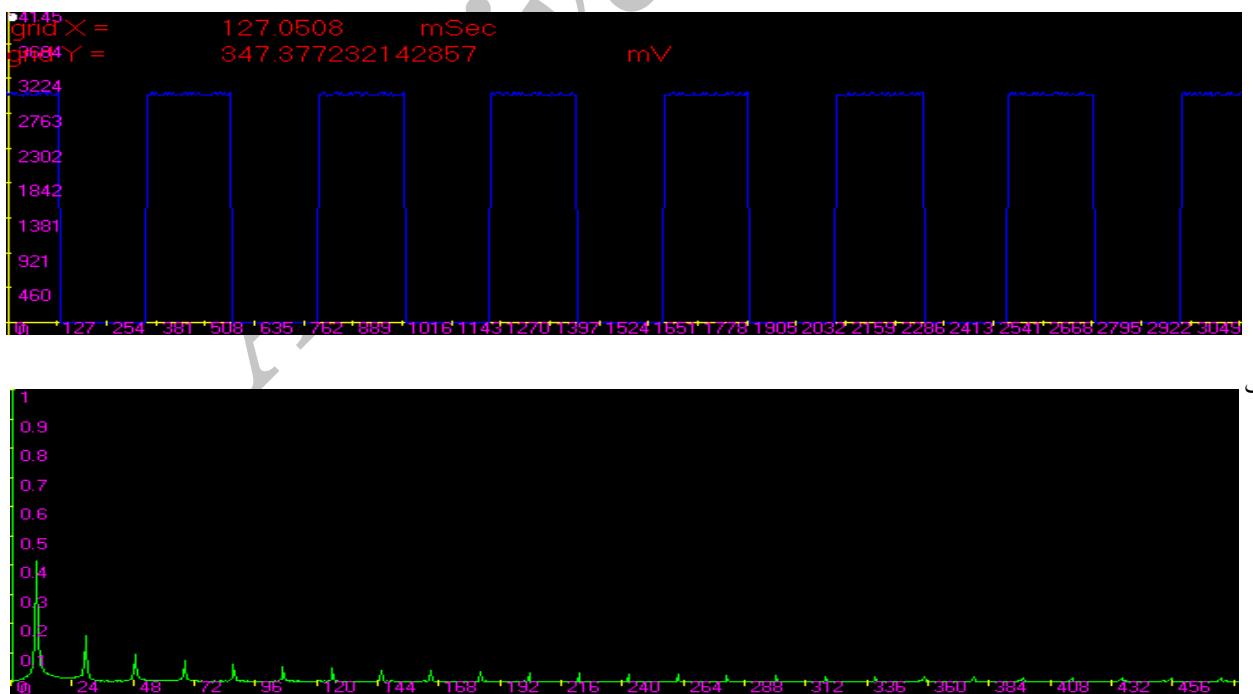

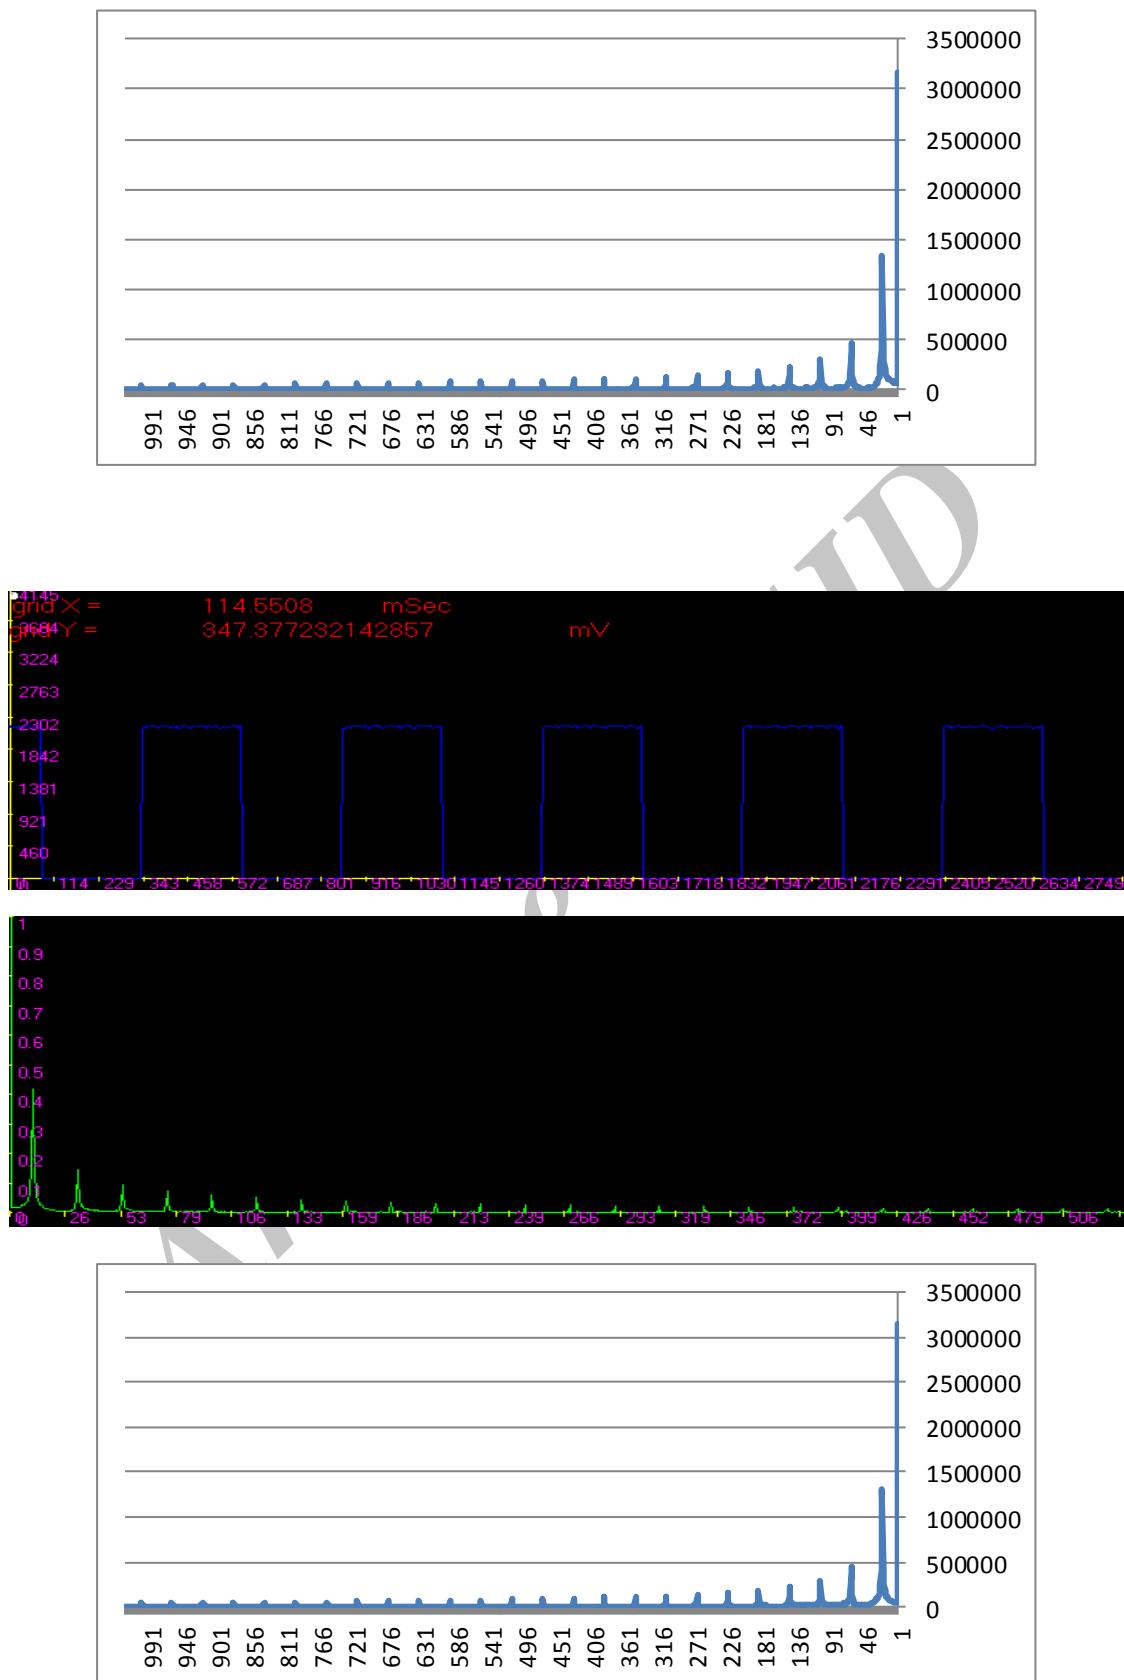

شکل ۶-نمودار طیف ولتاژ بر حسب زمان و دامنه ولتاژ حالت (الف) بدون ماده، (ب) با ماده.

Fig. 6. The plot of voltage spectrum versus of time and amplitude for (a) without sample and (b) with sample.

که در تشخیص تفاوت DNAهای سلول‌های مختلف به عنوان مثال DNAهای سالم و بیمار و کنترل کیفی DNA و سنجش میزان بیان ژن و اندازه‌گیری میزان آسیب به DNA و کاربردهای بسیار دیگر کاربرد دارد.

### نتیجه‌گیری نهایی

در این پژوهه طیف‌نگاری طراحی و ساخته شد که از نور LED برای تحریک نمونه‌ها استفاده می‌کند که بسیار ارزان قیمت‌تر و کاراتر از نمونه‌های مشابه می‌باشد. غلظت DNA را می‌توان به صورت مستقیم یا با استفاده از نمودارهای استاندارد تعیین کرد

### References

- Alberti, P. and Mergny, J.L.** 2003. DNA duplex-quadruples exchange as the basis for a nanomolecular machine. – PNAS 100: 1569-1573.
- Heller, M.J. and Morrison, L.E.** 1985. In Rapid detection and identification of infectious agents. – Academic Press, New York. pp: 245-256.
- Mao, C., Sun, W., Shen, Z. and Seeman, N.C.** 1999. A nanomechanical device based on the B-Z transition of DNA. – Nature 297: 144-146.
- Niemeyer, C. and Adler, M.** 2002. Nanomechanical devices based on DNA. – Angew. Chem. Int. Ed. 41: 3779-3783.
- Simmel, F.C. and Yurke, B.** 2002. A DNA-based molecular device switchable between three distinct mechanical states. – Appl. Phys. Lett. 80: 883-885.

**Smith, S.B., Finzi, L. and Bustamante, C.** 1992. Direct mechanical measurements of the elasticity of single DNA molecules by using magnetic beads. – Science 258: 1122-1126.

**Stryer, L. and Haugland, R.P.** 1967. Energy transfer: a spectroscopic ruler. – Proc. Natl. Acad. Sci. USA 58: 719-726.

**Yan, H., Zhang, X., Shen, Z. and Seeman, N.C.** 2002. A robust DNA mechanical device controlled by hybridization topology. – Nature 415: 62-65.

**Yurke, B., Turberfield, A.J., Mills, Jr., A.P., Simmel, F.C. and Neumann, J.L.** 2000. A DNA fuelled molecular machine made of DNA. – Nature 406: 605-608.

\*\*\*\*\*

Hashemi, S.M., Salmani, S. and Majles Ara, M.H. 2016. DNA structure spectroscopy by synthetic pigments using LED lighting. – Nova Biologica Reperta 2: 312-321.

هاشمی، س.م.، سلمانی، س. و مجلس آراء، م.ح. ۱۳۹۴. طیف نگاری ساختار DNA به کمک رنگدانه‌های مصنوعی با استفاده از نور LED. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۲: ۳۱۲-۳۲۱.