

# مطالعه توزیع دز چشمہ برآکی تراپی $Pd^{103}$ در درمان سرطان‌های مجاور با بافت‌های چربی و ماهیچه به روش مونت کارلو با استفاده از کد MCNP4C

حسین توکلی عنبران<sup>\*</sup>، ام‌لیلا احمدی<sup>۲</sup>

## چکیده

مقدمه: دزیمتری چشمہ‌های برآکی تراپی طبق پروتکل TG-43U1 در محیط آب اطراف چشمہ انجام می‌شود. برای رسیدن به یک نتیجه مناسب درمان، استفاده از ماده آب برای همه بافت‌های بدن می‌تواند یکی از منابع خطا در رسانیدن دز صحیح به تومور مورد نظر داشته باشد؛ از این رو در این مطالعه به تعیین پارامترهای دزیمتری بافت‌های متفاوت چربی با چگالی  $0.95 \text{ gr/cm}^3$  و ماهیچه با چگالی  $1.05 \text{ gr/cm}^3$  پرداخته‌ایم تا با مقایسه آن‌ها با نتایج حاصل از فانتوم آب ارزیابی درستی از اختلاف به وجود آمده در نتایج نشان دهیم.

روش بررسی: شبیه‌سازی‌های لازم جهت تعیین پارامترهای دزیمتری تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی در بافت‌های چربی، ماهیچه و فانتوم آب در فوائل و زوایای مختلف با استفاده از کد MCNP4C صورت گرفته است.

نتایج: بیشترین اختلاف نسبی تابع دز شعاعی در فانتوم بافت چربی نسبت به فانتوم آب در فوائل زیر  $1\text{cm}$  در حدود  $13\%$  می‌باشد. با افزایش فاصله از چشمہ این میزان افزایش پیدا کرده به طوری که در فاصله  $5\text{cm}$  از چشمہ به حدود  $167\%$  می‌رسد. اختلاف نسبی این پارامتر در بافت ماهیچه نسبت به آب در فاصله  $5\text{cm}$  حدود  $2\%$  و در فاصله  $5\text{cm}$  از چشمہ در حدود  $16\%$  است. بیشینه اختلاف نسبی پارامتر تابع ناهمسانگردی در فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه نسبت به آب به ترتیب بیش از  $2\%$  و  $3\%$  مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: در کاربرد کلینیکی چشمہ برآکی تراپی  $Pd^{103}$ ، در درمان تومورهای بدخیمی که در مجاورت بافت‌های چربی و ماهیچه قرار دارند می‌بایست تصحیحات لازم مربوط به پارامترهای دزیمتری این بافت‌ها را در برنامه‌های طراحی درمان طبق جداول  $۳$ ،  $۴$ ،  $۵$  و  $۶$  به دست آمده در این پژوهش اعمال نمود.

واژه‌های کلیدی: کد MCNP4C، فانتوم آب، بافت چربی، بافت ماهیچه، تابع دز شعاعی، تابع ناهمسانگردی

۱- استادیار، گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شهرورد، شهرورد

۲- دانشجوی دکتری فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شهرورد، شهرورد

<sup>\*</sup>(نویسنده مسئول): تلفن: ۰۳۳۲۳۹۵۲۷۰، پست الکترونیکی: tavakoli-anbaran@shahroodut.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۲/۹

## مقدمه

آن در حین برآکی تراپی پروستات و پرتوهای گامای پراکنده شده حاصل بر میزان دز جذبی با استفاده از کد MCNP4C صورت گرفت (۱۵). همچنین در سال ۲۰۱۶ مطالعاتی جهت مقایسه توزیع‌های دز چشمehای کم انرژی مختلف در برآکی تراپی درون حفره‌ای پروستات انجام شد (۱۶). در درمان سرطان‌های اندام‌های مختلف بدن از طریق پرتودرمانی، دریافت کمترین میزان دز رسیده به بافت‌های مختلفی که در مجاورت با اندام آسیب دیده قرار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای است. از این رو در تحقیق قبلی نشان داده‌ایم که محاسبات پارامترهای دزیمتري در فانتوم آب به جای بافت نرم دارای اختلاف نسبی حدوداً ۴٪ است که با انجام این تصحیحات می‌توان نتایج مربوط به فانتوم آب را به جای بافت نرم در طراحی برنامه درمان بکار بست (۱۷). همچنین مطالعه دیگری در بررسی اثر ناهمگنی بافت استخوان بر توزیع دز چشمeh برآکی تراپی <sup>103</sup>Pd مدل MED3633 به روش مونت کارلو صورت گرفت (۱۸). با توجه به آن که بافت‌های بدن انسان از درصدهای وزنی و ترکیبات و چگالی‌های متفاوتی تشکیل شده است برای رسیدن به یک نتیجه مناسب درمان، استفاده از ماده استاندارد آب برای همه بافت‌های بدن می‌تواند یکی از منابع خطا در رسانیدن دز بردن محیط آب در اطراف چشمeh با چگالی تقریباً ۱/۰ gr/cm<sup>3</sup> (۱۹)، برای همه بافت‌های بدن نمی‌توان به نتیجه درستی دست یافت. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم با تعیین توزیع دز چشمeh <sup>103</sup>Pd در بافت‌های ناهمگن چربی با چگالی <sup>۰/۹۵</sup> gr/cm<sup>3</sup> (۱۹) و ماهیچه با چگالی <sup>۱/۰۵</sup> gr/cm<sup>3</sup> (۲۰) مقایسه آن‌ها با نتایج حاصل از فانتوم آب ارزیابی درستی از اختلاف به وجود آمده در نتایج نشان دهیم. در تمامی مراحل انجام شبیه‌سازی‌ها، از کد مونت کارلوی MCNP نسخه 4C استفاده شده است.

## روش بررسی


محاسبه آهنگ دز جذبی در پرونکل TG-43U1 به صورت زیر است (۸).

امروزه از چشمehای گسیلنده گاما و بتا به طور گسترده در درمان تومورهای بدخیم در روش برآکی تراپی استفاده می‌شود (۲، ۱). چشمeh گامای کم انرژی با متوسط انرژی ۲۰ keV در سال ۱۹۸۶ به عنوان یک انتخاب مناسب به جای ۱۲۵I مطرح شد و در درمان سرطان‌های سینه، پروستات و گردان کاربرد دارد (۳). مطالعات در جهت تعیین پارامترهای دزیمتري مدل‌های مختلف چشمehای برآکی تراپی طبق توصیه‌های انجمن فیزیک پزشکی آمریکا TG-43U1 صورت می‌گیرد (۴، ۵). در سال ۲۰۰۱ پارامترهای دزیمتري چشمeh برآکی تراپی <sup>103</sup>Pd مدل MED3633 توسط ریوارد مورد بررسی قرار گرفت (۶). به منظور بهبود بخشیدن مقادیر پارامترهای دزیمتري در کاربردهای کلینیکی مطالعه‌ای در جهت تصحیح مقادیر تابع دز شعاعی چشمeh برآکی تراپی <sup>125</sup>I با استفاده از کد مونت کارلوی MCNP برای مدل‌های ۶۷۱۱ و ۶۷۱۱ در سال ۲۰۰۴ انجام شد (۷). در همین راستا توزیع دز چشمeh برآکی تراپی <sup>103</sup>Pd مدل MED3633 در فانتوم آب با استفاده از کد MCNP در سال ۲۰۰۶ به دست آمد (۸). در سال ۲۰۰۷ مشخصه‌یابی پارامترهای دزیمتري چشمeh <sup>103</sup>Pd Iso Aid Advantage مدل <sup>۱۰۳</sup>Pd گرفت (۹). همچنین مطالعه‌ای در خصوص دزیمتري پلاک‌های چشمی <sup>103</sup>Pd و <sup>۱۲۵</sup>I مورد استفاده در برآکی تراپی به روش مونت کارلو در سال ۲۰۰۸ انجام شد (۱۰). اختلاف دز جذبی در ریه با در نظر گرفتن بافت به صورت همگن و ناهمگن در سال ۲۰۱۱ با استفاده از چشمeh برآکی تراپی <sup>۱۹۲</sup>Ir به روش مونت کارلو مورد مطالعه قرار گرفت (۱۱). تعیین پارامترهای دزیمتري طرح جدیدی از چشمeh <sup>103</sup>Pd، مدل IR01 در سال ۲۰۱۲ با استفاده از روش مونت کارلو حاصل شد (۱۲). در سال ۲۰۱۴ اثر ترکیبات بافت بر توزیع دز چشمehای گسیلنده مختلف فوتوна در برآکی تراپی مورد مطالعه قرار گرفت (۱۳). تحقیقی جهت بررسی اثرات ناهمگنی‌های فانتوم کروی بر مشخصه‌های دزیمتري چشمehای برآکی تراپی مینیاتوری پرتو ایکس به روش مونت کارلو در سال ۲۰۱۵ انجام شد (۱۴). اخیراً بررسی‌هایی در جهت تخمین دزهای پروستات، اندام‌های مجاور

آن،  $r$ ، فاصله نقطه دلخواه تا مرکز تقارن چشمه بر حسب cm،  $\beta$  زاویه بین ابتدا و انتهای چشمه بر حسب رادیان، L طول مؤثر چشمه بر حسب cm و همچنین زاویه  $\theta$ ، زاویه نسبت به محور طولی چشمه بر حسب رادیان است. نقطه  $P(r_0, \theta_0)$ ، نقطه مرجع محاسبات یعنی در زاویه  $90^\circ$  درجه و فاصله 1cm بر روی محور عرضی چشمه است.

$$\dot{D}(r, \theta) = S_k \Lambda \left[ \frac{G(r, \theta)}{G(r_0, \theta_0)} \right] g(r) F(r, \theta) \quad (1)$$

مطابق آنچه در رابطه (1) مشاهده می‌شود این فرمول بندی شامل:تابع ناهمسانگردی  $F(r, \theta)$ ، ثابت نرخ دز  $\Lambda$ ،تابع هندسی  $G(r, \theta)$ ،تابع دز شعاعی  $g(r)$  و شدت کرمای هوا  $S_k$  است. مختصات سیستم برای محاسبات دزیمتري چشمه‌های برای تراپی در شکل ۱ نشان داده شده است که در

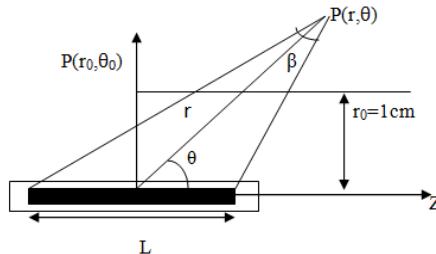

شکل ۱: مختصات چشمه برای تراپی برای محاسبه پارامترهای دزیمتري طبق پروتکل TG-43U1 (۸).

مراحل شبیه‌سازی نیز از کد مونت کارلوی MCNP4C با تاریخچه ذرات  $10^9 \times 2$  ذره استفاده شده است.

برای تعیین پارامترهای تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی که بیانی از تغییرات دز به دلیل توزیع ماده رادیواکتیویته بر روی کره‌های چشم، اثرات خود جذبی درون چشم، انحنای کپسول، ضخامت ماده تشکیل‌دهنده آن و محیط اطراف چشم است نیاز به دو شبیه‌سازی است: اول برای محاسبه دز جذبی در مکان‌ها و زوایای مختلف اطراف چشم در فانتوم‌های مختلف بافت و فانتوم آب ازتالی F4 کد MCNP4C استفاده شده است. این تالی تخمين گر شار ذرات با استفاده از طول مسیر پیموده شده آن‌ها در سلول است که به همراه کارت‌های تبدیل شار به دز، دز جذبی در محیط اطراف چشم را محاسبه می‌کند (۲۱). برای این منظور محاسبات دز جذبی در فواصل ۰/۵، ۰/۷۵، ۱، ۱/۵، ۲/۵، ۳، ۴/۵ و ۵cm از چشم در زوایای صفر تا  $90^\circ$  درجه با فواصل ۱۰ درجه انجام شده است. شبیه‌سازی دوم نیز برای محاسبه تابع هندسی است از آنجایی که این تابع تنها به هسته فعال بستگی دارد و به رادیونوکلئید و کپسول بستگی ندارد (۵)، برای محاسبات این تابع چگالی جرمی و همه ترکیبات داخلی چشم را صفر در نظر گرفته و شار در اطراف چشم در محیط خلاء را با استفاده

در رابطه دز جذبی در اطراف چشم، هریک از پارامترها به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$G(r, \theta) = \begin{cases} 1/r^2 \\ \beta/Lr \sin\theta \end{cases} \quad (2)$$

$$g(r) = \frac{\dot{D}(r, \theta_0) G(r, \theta_0)}{\dot{D}(r_0, \theta_0) G(r, \theta_0)} \quad (3)$$

$$F(r, \theta) = \frac{\dot{D}(r, \theta) G(r, \theta_0)}{\dot{D}(r_0, \theta_0) G(r, \theta)} \quad (4)$$

$$S_k = k_\delta(d) d^2 \quad (5)$$

واحد شدت کرمای هوا برابر است با  $\mu \text{ Gy m}^2 \text{ h}^{-1}$  که اصطلاحاً به آن U می‌گویند.

$$\Lambda = \frac{\dot{D}(r_0, \theta_0)}{S_k} \quad (6)$$

واحد ثابت نرخ دز  $\text{cGyh}^{-1} \text{U}^{-1}$  می‌باشد (۸).

با در نظر گرفتن بافت‌های مختلف اطراف چشم برای تراپی  $^{103}\text{Pd}$ ، توزیع دز تنها به پارامترهای تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی وابسته است از این رو با تعیین این پارامترها در فانتوم بافت چربی با چگالی  $0.95 \text{ gr/cm}^3$  (۱۹) و فانتوم بافت ماهیچه با چگالی  $1.05 \text{ gr/cm}^3$  (۲۰)، به مقایسه آن با نتایج حاصل از این پارامترها در فانتوم آب پرداخته‌ایم. در تمام

ماهیچه مشاهده می شود.

از تالی F4 کد MCNP4C محاسبه می کنیم (۱۷). در جداول ۱ و ۲ درصد وزنی و ترکیبات بافت‌های چربی و

جدول ۱: ترکیبات و درصد وزنی عناصر بافت چربی با چگالی  $0.95 \text{ gr/cm}^3$ .

نام عنصر	درصد وزنی بافت
۱۱/۴	هیدروژن
۵۹/۸	کربن
۰/۷	نیتروژن
۲۷/۸	اکسیژن
۰/۱	سدیم
۰/۱	منیزیم
۰/۱	کلر


جدول ۲: ترکیبات و درصد وزنی عناصر بافت ماهیچه با چگالی  $1.05 \text{ gr/cm}^3$ .

نام عنصر	درصد وزنی بافت
۱۰/۲	هیدروژن
۱۴/۳	کربن
۳/۴	نیتروژن
۷۱/۰	اکسیژن
۰/۱	سدیم
۰/۳	فسفر
۰/۱	گوگرد
۰/۱	کلر
۰/۴	پتاسیم

## نتایج

بافت‌های چربی و ماهیچه به همراه نتایج تجربی اندازه‌گیری شده در آب توسط والاس و فن که با استفاده از TLD انجام گرفته (۲۲)، جهت مقایسه رسم شده‌اند. همچنین نتایج شبیه‌سازی تابع دز شعاعی در جدول ۳ آورده شده است.

نتایج تابع دز شعاعی بعد از انجام شبیه‌سازی‌های لازم نمودارهای مربوط به تابع دز شعاعی در فواصل  $0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5$  و  $5 \text{ cm}$  بر روی محور عرضی چشمۀ در فانتم آب و فانتم

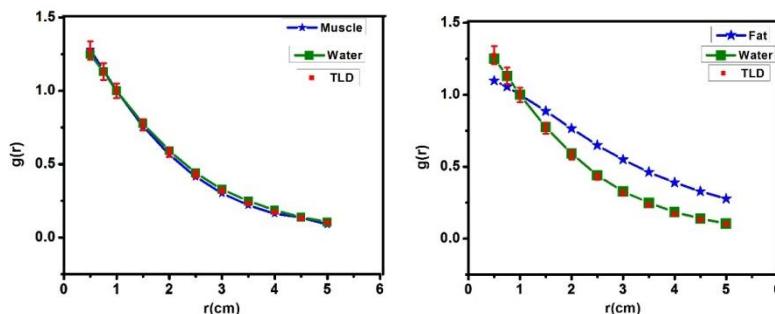

شکل ۲: مقایسه نمودارهای تابع دز شعاعی در فانتم آب و فانتم بافت‌های چربی و ماهیچه در این پژوهش به روش مونت کارلو همراه با مقادیر اندازه‌گیری شده در تجربه توسط والاس و فن در آب (۲۲).

جدول ۳: مقادیر تابع دز شعاعی محاسبه شده با کد MCNP4C در این پژوهش برای فانتوم‌های آب، بافت چربی و بافت ماهیچه

فانتوم آب	فانتوم چربی	فانتوم ماهیچه	r(cm)
۱/۲۵۰	۱/۰۹۸	۱/۲۸۰	۰/۵
۱/۱۳۰	۱/۰۵۶	۱/۱۴۱	۰/۷۵
۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰
۰/۷۷۶	۰/۸۸۶	۰/۷۵۸	۱/۵
۰/۵۹۱	۰/۷۶۵	۰/۵۶۵	۲/۰
۰/۴۴۰	۰/۶۴۹	۰/۴۱۳	۲/۵
۰/۳۲۸	۰/۵۴۹	۰/۳۰۰۹	۳/۰
۰/۲۴۸	۰/۴۶۲	۰/۲۲۰	۳/۵
۰/۱۸۵	۰/۳۸۹	۰/۱۶۲	۴/۰
۰/۱۳۹	۰/۳۲۸	۰/۱۱۸	۴/۵
۰/۱۰۴	۰/۲۷۷	۰/۰۸۸	۵/۰


دلیل دارا بودن کربن با ۱۴/۳٪ و تعداد اتم‌های بیشتری نسبت به آب سبب می‌شود در فواصل نزدیک، فوتون انرژی بیشتری در بافت ماهیچه به جا گذاشته یا به عبارتی جذب بیشتر از پراکندگی در این مکان‌ها رخ دهد. به طوری که اختلاف نسبی در این فواصل حدوداً ۳٪ می‌شود؛ اما در فاصله‌های دور از چشم، فوتون حامل انرژی کمتری بوده و به همین دلیل این اختلاف نسبی افزایش پیدا کرده و به حدود ۱۶٪ در فاصله ۵cm از چشم می‌رسد. بافت چربی دارای عناصر سبک با ترکیبات و درصد وزنی کمتری نسبت به آب است؛ بنابراین فوتون در طی گذر از این بافت بیشتر دستخوش پراکندگی قرار گرفته، به طوری که در فواصل نزدیک در بافت چربی، انرژی کمتری نسبت به آب به جا می‌گذارد و سبب به وجود آمدن اختلاف نسبی منفی در این فواصل می‌شود که بیشترین میزان آن ۱۳٪ است. با افزایش فاصله از چشم این میزان افزایش پیدا کرده به طوری که در فاصله ۵cm از چشم به حدود ۱۶٪ می‌رسد.

با توجه به نمودارهای شکل ۲، اختلافاتی در مقادیر تابع دز شعاعی در فانتوم آب نسبت به مقادیر اندازه‌گیری شده این تابع در فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه مشاهده می‌گردد. برای نشان دادن اختلاف بهتر بین مقادیر به دست آمده در فانتوم آب نسبت به فانتوم بافت‌های دیگر کمیت

$$C_i = \frac{g(r)_i - g(r)_{\text{Water}}}{g(r)_{\text{Water}}} \times 100$$

مقادیر  $i = \text{Muscle, Fat, Water}$ ، اختلاف نسبی هر یک از مقادیر تابع دز شعاعی در فانتوم بافت‌های چربی، ماهیچه و آب نسبت به آب بر حسب درصد می‌باشد. برای نشان دادن بهتر اختلافات مقادیر هر یک از این کمیات همانند آنچه در نمودارهای شکل ۳، مشاهده می‌کنید با مقادیر  $C_{\text{Water}}$  (اختلاف نسبی تابع دز شعاعی در آب نسبت به آب بر حسب درصد) مقایسه شده است.

همان‌طور که هر یک از نمودارها نشان می‌دهند به خوبی اختلاف نسبی بین مقادیر تابع دز شعاعی در فانتوم آب و فانتوم بافت‌های دیگر را به وضوح می‌توان دریافت. بافت ماهیچه شامل ترکیبات با درصد وزنی و عدد اتمی نزدیک به آب است؛ اما به

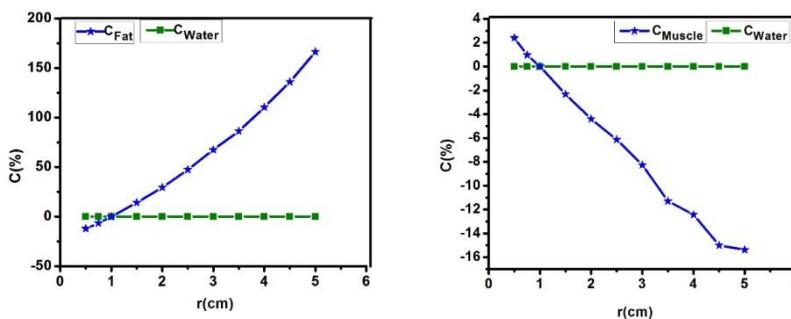


شکل ۳: نمودارهای اختلاف نسبی تابع دز شعاعی آب نسبت به آب بر حسب درصد و تابع دز شعاعی بافت‌های چربی و ماهیچه نسبت به آب بر حسب درصد

طولی کمتر بوده میزان شار رسیده به نقاط مورد نظر بر روی این محور چشمی بیشتر شده و در نهایت دز جذبی افزایش می‌یابد. برای نشان دادن بهتر تغییرات این تابع در فانتوم

آب نسبت به فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه کمیت آب معرفی می‌کنیم؛ که در آن:

$$D_i = \frac{F(r, \theta)_i - F(r, \theta)_{\text{Water}}}{F(r, \theta)_{\text{Water}}} \times 100$$

در فانتوم بافت‌های چربی، ماهیچه و آب نسبت به آب بر حسب درصد است. برای نشان دادن بهتر اختلاف مقادیر هر یک از این کمیات همانند آنچه که در نمودارهای شکل ۵، مشاهده می‌کنید با مقادیر  $D_{\text{Water}}$  (اختلاف نسبی تابع ناهمسانگردی در آب نسبت به آب بر حسب درصد) مقایسه شده است.

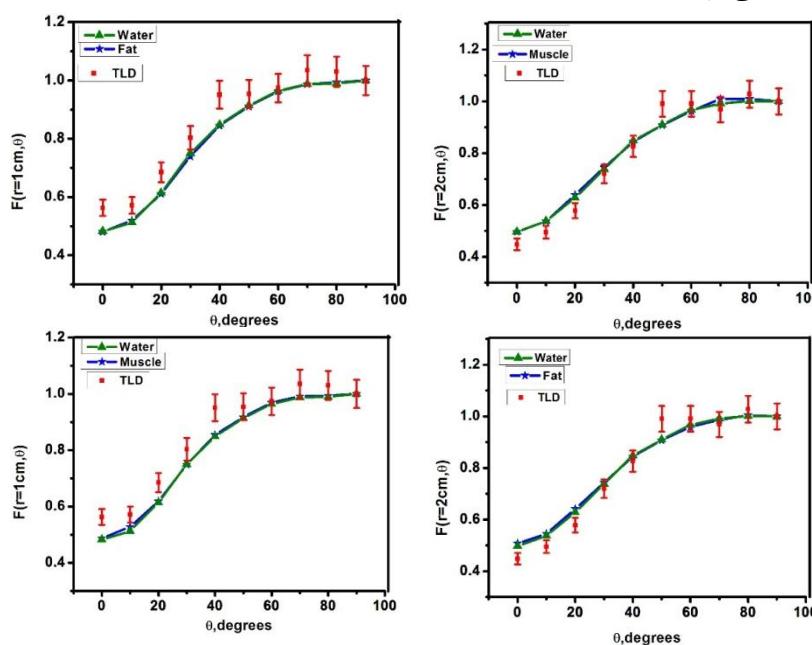

شکل ۴: مقایسه نمودارهای تابع ناهمسانگردی در فانتوم آب همراه با مقادیر محاسبه شده در فانتوم ماهیچه و چربی در این پژوهش به روش مونت کارلو و مقادیر اندازه‌گیری شده در تجربه توسط والاس و فندر آب (۲۲)

#### نتایج تابع ناهمسانگردی

شبیه‌سازی‌های لازم جهت محاسبه تابع ناهمسانگردی در فواصل ۱، ۲ و ۳ cm از چشمde در زوایای صفر تا ۹۰ درجه با فاصله ۱۰ درجه انجام شد و نتایج حاصل از این تابع در فانتوم آب به همراه مقادیر محاسبه شده در فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه و اندازه‌گیری شده در TLD توسط والاس و فن در آب (۲۲) جهت مقایسه رسم شده‌اند، شکل ۴. همچنین مقادیر محاسبه شده این تابع در جداول ۴، ۵ و ۶ آورده شده است. از نمودارهای رسم شده برای تابع ناهمسانگردی مشاهده می‌شود که: با نزدیک شدن به زاویه ۹۰ درجه به علت تقارن چشمde، پرتوهای بیشتری به نقاط مورد نظر می‌رسند. از طرفی چون ضخامت کپسول در راستای عرضی چشمde نسبت به محور

مقادیر تابع ناهمسانگردی محاسبه شده در فانتوم آب

و فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه در جداول زیر آورده

جدول ۴: مقادیر تابع ناهمسانگردی در فانتوم آب


۳ cm	۲ cm	۱ cm	زاویه
•/۵۴۵	•/۵۰۸	•/۴۸۰	صفر درجه
•/۵۷۱	•/۵۴۵	•/۵۱۹	۱۰ درجه
•/۶۶۱	•/۶۴۲	•/۶۱۰	۲۰ درجه
•/۷۵۹	•/۷۴۳	•/۷۳۹	۳۰ درجه
•/۸۴۴	•/۸۴۴	•/۸۴۵	۴۰ درجه
•/۸۵۸	•/۹۰۶	•/۹۱۰	۵۰ درجه
•/۹۷۷	•/۹۵۹	•/۹۶۲	۶۰ درجه
•/۹۸۹	•/۹۸۷	•/۹۸۷	۷۰ درجه
۱/۰۱۷	۱/۰۰۴	۰/۹۹۲	۸۰ درجه
۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۹۰ درجه

جدول ۵: مقادیر تابع ناهمسانگردی در فانتوم چربی

۳ cm	۲ cm	۱ cm	زاویه
•/۵۲۴	•/۴۹۷	•/۴۸۲	صفر درجه
•/۵۴۳	•/۵۳۸	•/۵۱۲	۱۰ درجه
•/۶۴۰	•/۶۲۸	•/۶۱۴	۲۰ درجه
•/۷۵۳	•/۷۳۸	•/۷۴۹	۳۰ درجه
•/۸۴۴	•/۸۴۸	•/۸۴۸	۴۰ درجه
•/۹۳۳	•/۹۰۹	•/۹۱۳	۵۰ درجه
•/۹۷۹	•/۹۶۷	•/۹۶۴	۶۰ درجه
۱/۰۱۵	۰/۹۹۱	•/۹۸۷	۷۰ درجه
۱/۰۲۰	۱/۰۰۱	•/۹۸۹	۸۰ درجه
۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۹۰ درجه

جدول ۶: مقادیر تابع ناهمسانگردی در فانتوم ماهیچه

۳ cm	۲ cm	۱ cm	زاویه
•/۵۲۵	•/۴۹۶	•/۴۸۶	صفر درجه
•/۵۴۶	•/۵۳۷	•/۵۲۷	۱۰ درجه
•/۶۵۴	•/۶۳۸	•/۶۱۸	۲۰ درجه
•/۷۵۴	•/۷۴۵	•/۷۴۸	۳۰ درجه
•/۸۵۹	•/۸۴۴	•/۸۵۴	۴۰ درجه
•/۹۴۲	•/۹۰۸	•/۹۱۷	۵۰ درجه
•/۹۸۲	•/۹۶۲	•/۹۷۰	۶۰ درجه
۱/۰۰۱	۱/۰۰۹	۰/۹۹۱	۷۰ درجه
۱/۰۱۵	۱/۰۰۹	•/۹۹۳	۸۰ درجه
۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۹۰ درجه

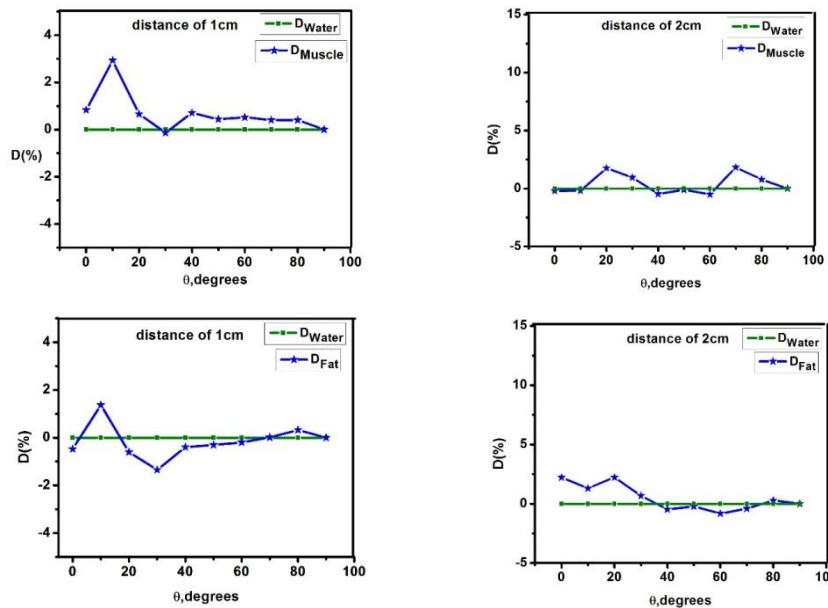

شکل ۵: نمودارهای اختلاف نسبی تابع ناهمسانگردی در فانتوم آب نسبت به آب برحسب درصد و اختلاف نسبی تابع ناهمسانگردی در فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه نسبت به آب برحسب درصد در این پژوهش به روش مونت‌کارلو

دز ارائه شده توسط انجمان فیزیک پزشکی آمریکا طبق پروتکل TG-43U1 در محیط آب اطراف چشمہ انجام گردد؛ اما با توجه به این که ساختار بدن از بافت‌ها با ترکیبات و درصد وزنی‌های متفاوتی تشکیل شده است با بکار بردن پارامترهای دزیمتري در محیط آب به جای بافت‌های متفاوت بدن نمی‌توان به ارزیابی درستی برای طراحی درمان دقیق دست یافت. از این رو باید تصحیحات لازم در زمان استفاده از این پارامترها را در مرحله درمان اعمال نمود؛ بنابراین با توجه به موارد ذکر شده که هدف از انجام این مطالعه بوده است به ارزیابی چگونگی توزیع دز دو بافت متفاوت چربی با چگالی  $0.95 \text{ gr/cm}^3$  (۱۹) و ماهیچه با چگالی  $1.05 \text{ gr/cm}^3$  (۲۰) پرداخته و اختلاف هر یک از آن‌ها را با فانتوم آب با چگالی  $1.00 \text{ gr/cm}^3$  (۱۹) مورد بررسی قرار داده‌ایم. طبق آنچه که نتایج نشان می‌دهند، تابع دز شعاعی در هر یک از نمودارهای شکل ۲ با افزایش فاصله از مرکز تقارن چشمہ کاهش پیدا می‌کند زیرا با افزایش عمق از شدت فوتون‌ها کم شده و منجر به کم شدن تعداد اندرکنش‌ها (از نوع فوتوالکترویک و کامپتون) می‌شود از این رو تعداد انتقال‌های انرژی فوتون‌ها به ماده توسط الکترون‌ها کم شده و

همان‌طور که هر یک از نمودارهای شکل ۵ نشان می‌دهند بیشینه اختلاف نسبی در استفاده از فانتوم بافت‌های مختلف نسبت به فانتوم آب، در زوایای زیر  $20^\circ$  درجه مشاهده می‌گردد که نتیجه دو عامل است: ۱) با فاصله از خط تقارن چشمہ درصد یکنواختی پرتوهای گسیلی از آن کاهش می‌یابد. ۲) تفاوت در چگالی الکترونی بافت‌های مختلف و آب، در نهایت موجب تفاوت دز جذبی در این دو محیط می‌شود.

## بحث

دزیمتري قابل استفاده در برآکی تراپی به معنای محاسبه مقدار آهنگ دز، در نقطه مورد نظر از چشمہ، در محیط داده شده است که ارزیابی آن قبل از کاربرد کلینیکی چشمہ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی به دلیل هندسه استوانه‌ای شکل چشمہ، دزیمتري در برآکی تراپی تجربی بیچیده و در هر نقطه و هر زاویه‌ای امکان‌پذیر نیست. برای بررسی درستی محاسبه، استفاده از روش‌های مونت کارلو برای بهبود فهم ما در همه فرآیندهای وابسته به گسیل تابش و انتقال با استفاده از اعداد کاتورهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربردهای کلینیکی چشمہ باید بر اساس توصیه‌های محاسبه

استفاده از فانتوم بافت‌های مختلف نسبت به فانتوم آب، در زوایای زیر ۲۰ درجه است که نتیجه دو عامل است: ۱) با فاصله از خط تقارن چشمہ درصد یکنواختی پرتوهای گسیلی از آن کاهش می‌یابد. ۲) تفاوت در چگالی الکترونی بافت‌های مختلف و آب، درنهایت موجب تفاوت دز جذبی در این دو محیط می‌شود؛ که این میزان اختلاف در فانتوم بافت ماهیچه بیش از ۳٪ و فانتوم بافت چربی بیش از ۲٪ بوده که دلالت بر اهمیت نوع محیط اندرکنش کننده فوتون با ماده دارد. در بررسی دزیمتری اثر چگالی و ترکیبات بافت‌های مختلف نسبت به آب در چشممهای مورد استفاده در برآکی تراپی مطالعات گوناگونی انجام شده است. مطالعه مشابهی همانند کار انجام شده در این پژوهش با استفاده از چشمہ گاما $^{137}Cs$  با انرژی  $0.662\text{ keV}$  در بافت ماهیچه و چربی برای تابع دز شعاعی با استفاده از کد MCNP4C توسط سینا و همکاران صورت گرفته و نتایج آن با آب مقایسه شده است که در آن اختلاف تابع دز شعاعی در ماهیچه و چربی نسبت به آب تا فاصله  $10\text{ cm}$  از چشمہ به ترتیب  $11/6\%$  و  $11/1\%$  است (۲۳)، که این اختلاف به دلیل تفاوت نوع چشمہ مورد استفاده در پژوهش است. همچنین مقایسه نتایج حاصل از تابع دز شعاعی در این پژوهش در آب با نتایج به دست آمده از دیگران برای چشمہ  $Pd^{103}$  مدل MED3633 در جدول ۷ آمده است.

بدین ترتیب دز جذبی کاهش پیدا می‌کند. با مقایسه هر یک از نمودارهای تابع دز شعاعی فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه با فانتوم آب و مقادیر تجربی اندازه‌گیری شده توسط والاس و فن در آب (۲۲) با توجه به آن که بیشترین ترکیبات بافت چربی با چگالی  $0.95\text{ gr/cm}^3$  (۱۹)، شامل عناصر سبک، هیدروژن با  $11/4\%$ ، کربن با  $59/8\%$  و اکسیژن با عدد اتمی  $27/8\%$  می‌باشند که عناصری با عدد اتمی پائین هستند و آب نیز شامل هیدروژن با  $11/19\%$  و اکسیژن با  $88/81\%$  است؛ بنابراین احتمال پراکندگی در فانتوم بافت چربی بیشتر از جذب رخ می‌دهد و به دلیل آن که تعداد اتم‌های تشکیل‌دهنده آب بیشتر از تعداد اتم‌های تشکیل‌دهنده بافت چربی است احتمال اندرکنش‌های فوتون در آب بیشتر از بافت چربی شده و بیشتر انرژی خود را در فواصل نزدیک‌تری از دست می‌دهند. از طرفی چون بیشترین ترکیبات مربوط به بافت ماهیچه با چگالی  $1.05\text{ gr/cm}^3$  (۲۰) شامل عناصر هیدروژن با  $10/2\%$ ، کربن  $14/3\%$  و اکسیژن با  $71/0\%$  است. به دلیل ترکیبات با وزن اتمی و عدد اتمی نزدیک به آب تابع دز شعاعی فانتوم بافت ماهیچه با فانتوم آب دارای تطابق خوبی است. با استفاده از تابع ناهمسانگردی، توزیع دز در اطراف چشمہ که شامل اثرات جذب و پراکندگی در محیط می‌باشند محاسبه می‌گردد. نتایج حاصل از این تابع نشان می‌دهند که: بیشینه اختلاف نسبی در

جدول ۷: مقادیر تابع دز شعاعی چشمہ  $Pd^{103}$  مدل MED3633 در آب

$r(\text{cm})$	مولوی و همکاران (۸)	والاس و فن (۲۲)	لی و همکاران (۲۴)	ریوارد (۶)	این پژوهش
۰/۵	-	-	-	-	-
۱	۱/۲۵۱	۱/۲۷۵	۱/۲۴۳	۱/۲۴۳	۱/۲۵۰
۱/۵	۰/۷۸۰	۰/۷۶۹	۰/۷۷۰	۰/۷۸۰	۰/۷۷۶
۲	۰/۵۸۰	۰/۵۸۰	۰/۵۸۳	۰/۳۴۷	۰/۳۲۸
۳	۰/۳۳۹	۰/۳۱۸	۰/۳۲۵	۰/۱۹۷	۰/۱۸۵
۴	-	۰/۱۷۴	۰/۱۷۷	۰/۱۱۴	۰/۱۰۴
۵	-	-	-	-	-

از فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه نسبت به فانتوم آب در فواصل نزدیک به چشمہ با در نظر گرفتن چگالی‌های مختلف بافت‌ها دارای اختلاف قابل ملاحظه‌ای است که بسیار حائز اهمیت است. همچنین اختلاف نسبی در پارامتر تابع

### نتیجه‌گیری

چشمہ برآکی تراپی  $Pd^{103}$ ، مورد مطالعه یک چشمہ با فوتون‌های کم انرژی است که عمق نفوذ آن بالا نیست و انرژی آن در فاصله‌های نزدیک‌تری نسبت به چشمہ افت می‌کند. از طرفی اختلاف نسبی بین پارامتر تابع دز شعاعی نیز با استفاده

می‌بایست تصحیحات لازم مربوط به پارامترهای دزیمتری این بافت‌ها را در برنامه‌های طراحی درمان طبق جداول به دست آمده در این پژوهش اعمال نمود.

### سپاسگزاری

بدین وسیله از حمایت مالی دانشگاه صنعتی شاهروд سپاسگزاری می‌گردد.

ناهمسانگردی در فانتوم بافت‌های چربی و ماهیچه نسبت به آب به علت تفاوت در چگالی الکترونی بافت‌های مختلف و آب و همچنین به علت ناهمسانگردی توزیع دز در زوایای زیر ۲۰ درجه مشهودتر است؛ بنابراین چون هدف در پرتودرمانی رسیدن دز دقیق به تومور به طوری که کمترین آسیب به بافت‌های سالم اطراف برسد است از این رو در درمان تومورهای بدخیمی که در مجاورت بافت‌های چربی و ماهیچه قرار دارند

### References:

- 1- Shahrabi M, Tavakoli-Anbaran H. *Calculating dosimetry parameters in brachytherapy using the continuous beta spectrum of Sm-153 in the Monte Carlo simulation approach*. Euro Physical J Plus 2015; 130(2): 1-8.
- 2- Wilfred N, Houari K, Amin IK, Rajiv K, Srinivas S, Mike MG, Robert AC. *In vitro radiosensitization by gold nanoparticles during continuous low-dose-rate gamma irradiation with I-125 brachytherapy seeds*. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2013; 9(1): 25-7.
- 3- Sharma KP, Singh S, Kapoor A. *Brachytherapy and external beam radiation therapy for prostate cancer*. Am J Cancer Sci 2015; 4(1): 2.
- 4- Stephen TM, Penny KS, Michael WM. *I-125 Brachytherapy for Recurrent Atypical and Malignant Skull Base Meningiomas: Complications and Outcomes*. J Neurological Surgery Part B, 2015.
- 5- Rivard MJ, Coursey BM, Deward LA, Hanson WF, Saiful-Huq M, libbott G, et al. *Update of AAPM Task Group No.43 Report*. Med Phiys 2004; 33(3): 633-74.
- 6- Rivard MJ. *A discretized approach to determining TG-43 brachytherapy dosimetry parameters: case study using Monte Carlo calculations for the MED3633 <sup>103</sup>Pd source*. Applied Radiation and Isotopes 2001; 55: 775-82.
- 7- Duggan DM. *Improved radial dose function estimation using current version MCNP Monte-Carlo simulation model 711 and ISC3500 <sup>125</sup>I brachytherapy sources*. Applied Radiation and Isotopes, 2004; 61(6): 1443-50.
- 8- Molavi AA, Binesh A, Moslehitar H. *Dose distribution and dosimetry parameters calculation of MED3633 palladium-103 source in water phantom using MCNP*. Iran J Radiat Res 2006; 4 (1): 15-19.
- 9- Sowards KT. *Monte Carlo dosimetric characterization of the IsoAid ADVANTAGE <sup>103</sup>Pd brachytherapy source*. J App Clinic Med Physic 2007; 8(2): 18-25.
- 10- Thomson RM, Taylor REP, Rogers DWO. *Monte Carlo dosimetry for <sup>125</sup>I and <sup>103</sup>Pd eye plaque brachytherapy*. Med Phys 2008; 35: 5530.
- 11- Gialousis G, Dimitriadis A, Yakoumakis E. *Monte Carlo estimation of dose difference in lung from <sup>192</sup>Ir brachytherapy due to tissue in homogeneity*. Published by Oxford University Press, 2011; 10-28.

- 12- Saidi P, Sadeghi M, Shirazi M, Tenreiro C. *Dosimetric parameters of the new design  $^{103}\text{Pd}$  brachytherapy source based on Monte Carlo study*. Physica Medica 2012; 28(1): 13-18.
- 13- Ghorbani M, Salahshour F, Haghparast A, Ahmadi-moghaddas T. *Effect of tissue composition on dose distribution in brachytherapy with various photon emitting sources*. J Contemp Brachytherapy, 2014; 6(1).
- 14- Karimi-jashni H, Safigholi H, Meigooni AS. Influences of Spherical Phantom heterogeneities on dosimetric characteristics of miniature electronic brachytherapy X-ray sources Monte Carlo study. Applied Radiation and Isotopes, 2015; 95: 108-113.
- 15- Vahabi SM, Shamsae-Zafarghandi. *Prostate dose estimates and adjacent organs during the prostate brachytherapy and the scattering study of dose distribution using MCNP4C code*. Iran J Radiation Safety Measur 2015; 3(4). [Persian]
- 16- Bakhshabadi M, Ghorbani M, Khosroabadi M, Knaup C, Meigooni AS. *A compration study on various low energy sources in interstitial prostate brachytherapy*. J Contemporary Brachytherapy 2016; 8(1): 74-81.
- 17- Ahmadi OL, Tavakoli-Anbaran H. *Calculation of Error Percentage Encounter via Water Phantom instead of Soft Tissue for Brachytherapy Source Distribution of  $^{103}\text{Pd}$  by using Monte Carlo Method*. J Shahid Sadoughi University Med Sci 2015; 23(9): 806-818. [Persian]
- 18- Tavakoli-Anbaran H, Ahmadi OL. *The study effect of Bone tissue heterogeneity on the dose distribution of  $^{103}\text{Pd}$  source brachytherapy MED3633 Model Using Monte Carlo Method*. Iran J Radiation Safety Measure 2016; 4(1): 25-34. [Persian].
- 19- Azhari H. *Appendix A: Typical Acoustic Properties of Tissues in Basics of Biomedical Ultrasound for Engineers*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, 2010.
- 20- Wolfe RR, Chinkes DL. *Isotope Tracers in Metabolic Research: Principles and Practice of Kinetic Analysis*. John Wiley & Sons, 2005.
- 21- Los Alamos National Labrotatory. *OAK RIDGE national laboratory RSICC data library collection MCNP data*. New Mexico, 2000.
- 22- Wallace R, Fan J. *Dosimetric characterization of new design  $^{103}\text{Pd}$  brachytherapy source*. Med Phys 1999; 26(11): 2456-70.
- 23- Sina S, Faghihi R, Soleymani-Meigooni A. *A Comparison of the Dosimetric Parameters of Cs-137 Brachytherapy Source in Different Tissues with Water Using Monte Carlo Simulation*. Iran J Med Phys 2012; 8: 65-74.
- 24- Li Z, Palta JR, Fan JJ. *Monte Carlo calculations and experimental measurements of dosimetry parameters of a new  $^{103}\text{Pd}$  source*. Med Phys 2000; 27(5): 110812.

# **Study of Dose Distribution $^{103}\text{Pd}$ Source Brachytherapy in Treatment of Cancer Adjacent to Fat and Muscle Tissues by the Monte Carlo method using MCNP4C code**

**Hossein Tavakoli-Anbaran (PhD)<sup>\*1</sup>, OmeLeila Ahmadi (PhD Student)<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Department of Physics, Faculty of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

**Received:** 28 Apr 2016

**Accepted:** 6 Oct 2016

## **Abstract**

**Introduction:** The dosimetry of the brachytherapy sources is performed in the water source medium according to protocol TG-43U1. To achieve a resonable results on treatment, the use of the water material for all body tissues can be one of the faulty sources in delivering the correct dose to the tumor. Thus, we have focused on the dosimetry parameters in fat density  $0.95 \text{ gr/cm}^3$  and the muscle with density  $1.05 \text{ gr/cm}^3$  in the present study. The results are compared with the results of the water phantom to show the accurate assessment via the differences of the results.

**Methods:** Dissymmetry simulations for determining the parameters of the radial dose function and the anisotropy function in fat tissues, muscle and water phantom distances and different angles has been using MCNP4C code.

**Results:** The greatest relative differences of the phantom radial dose function of the fat tissue at distances below 1cm approximately reached 13%; and this rate increased, when the distance from the source increased; whereas at the distance of 5cm from the source, it approximately reached 167%. In the muscle tissue, the relative difference of these parameters was about 3% at the distance of 0.5cm, while at the distance of 5cm from the source, it approximately increased 16%. The maximum relative difference of the anisotropy parameter of the fat and muscle tissue phantom compared with the water were observed more than 2% and 3%, respectively.

**Conclusion:** In the clinical application of the  $^{103}\text{Pd}$  brachytherapy source, which is contracted in the treatment of the adjacent malignant tumors to the fat and muscle tissues, the correct decisions must be applied on the tissue dosimetry parameters in the treatment planings according to the tables of 3, 4, 5 and 6 in this study.

**Keywords:** MCNP4C Code; Water Phantom; Fat Tissue; Muscle Tissue; Radial Dose Function; Anisotropy Function

### **This paper should be cited as:**

Hosein Tavakoli-Anbaran, OmeLeila Ahmadi. *Study of dose distribution  $^{103}\text{pd}$  source brachytherapy in treatment of cancer adjacent to fat and muscle tissues by the monte carlo method using mcnp4c code.* J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2016; 24(8): 618-29.

\*Corresponding author: Tel: 02332395270, email: tavakoli-anbaran@shahroodut.ac.ir