

## سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جهت تشخیص سینوزیت‌های صوت و پیشانی

مهندس جواد صفایی  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
javad\_safaii@yahoo.com

مهندس نصیر عابدی  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
nassirabedi@yahoo.com

دکتر حمید ابریشمی مقدم  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
moghadam@eedt.kntu.ac.ir

چکیده- در این مقاله طراحی و ساخت یک سیستم تشخیصی ماوراء صوت A-scan بر پایه PC تشریح می‌گردد. سیستم حاصله می‌تواند جهت تشخیص سینوزیت‌های صوت و پیشانی و نیز جهت انجام آزمایشات مربوط به تشخیص نسوج بکار رود. به منظور جلوگیری از حذف هر گونه اطلاعات سیگنال بازگشتی، سخت افزار به گونه‌ای طراحی شده که امکان جمع‌آوری موج RF بازگشتی را فراهم می‌آورد. برای نمایش و پردازش اولیه سیگنال، نرم‌افزاری نوشته شده است که امکان نمایش بلادرنگ آکوهای بازگشتی را فراهم نموده و نیز توانایی انجام پردازشهای اولیه بر روی سیگنال را دارد. نتایج آزمایشگاهی بدست آمده حاکی از درستی عملکرد سخت‌افزار و نرم‌افزار سیستم می‌باشد.


واژگان کلیدی- سیستم ماوراء صوت A-scan، کامپیوتر شخصی، میکروکنترلر، تشخیص نسوج به کمک ماوراء صوت، پژواک RF.

### ۱) مقدمه

هدف ما در این پروژه ساخت یک سیستم A-mode بر پایه کامپیوتر شخصی بوده است [۱]. یکی از کاربردهای این سیستم که در این پروژه مدنظر بوده تشخیص سینوزیت‌های صوت و پیشانی می‌باشد. هدف دیگر ساخت این سیستم، ایجاد یک مجموعه آزمایشگاهی برای مطالعه انتشار و پراکندگی امواج ماوراء صوت درون بافت است که میتوان از آن در زمینه ایجاد الگوریتم‌های تشخیص نسوج استفاده نمود. به همین دلیل در این سیستم بجای نمونه برداری از پوش سیگنال RF بازگشتی، سخت‌افزار طراحی شده از خود سیگنال RF نمونه برداری می‌نماید. همچنین سیستم فوق به نحوی طراحی شده که امکان کار با مبدل‌های ماوراء صوت گوناگون با فرکانسهای متفاوت را دارد. بنابراین می‌تواند با مختصر تغییراتی جهت انجام آزمایشهای تشخیصی روی سایر اندامها نظیر چشم نیز بکار رود.


با توجه به کامپیوتری بودن سیستم نهایی، معماری سخت‌افزاری آن تفاوت‌های کلی با آنچه به عنوان یک سیستم A-mode متداول است خواهد داشت. با وجود کامپیوتر امکان انجام پردازشهای گوناگون روی اطلاعات دریافتی را داریم که این امر در راستای تشخیص بیماری، کمک شایانی به پزشک خواهد نمود.

علاوه بر این می‌توان بعضی از قسمتهای سخت‌افزاری مورد نیاز را به صورت نرم‌افزاری، با دقت و قابلیت انتخاب بیشتر انجام داد. به عنوان مثال بخش TGC در تقویت‌کننده را-البته برای عمق‌های جسنجوی کم- می‌توان به کمک نرم‌افزار شبیه‌سازی کرد. واضح است که در ازای دستیابی به مزایای فوق سخت‌افزار سیستم از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار خواهد شد که در بخش‌های آتی به تفصیل شرح داده می‌شود.



## ۲) روش A-mode

این روش مانند اکثر روشهای تصویر برداری، بر پایه تکنیک pulse-echo می باشد. در این تکنیک، پالس از امواج آکوستیکی توسط میدل تولید شده و به داخل بافتی که تحت بررسی است فرستاده می شود. هر انعکاس ناشی از برخورد این موج به مرز بین دو بافت با امپدانسهای آکوستیکی متفاوت، توسط میدل دریافت خواهد شد. زمان بین انعکاسها متناسب با عمق مرز دو بافت خواهد بود. روش فوق در واقع می تواند یک تصویر تک بعدی در راستای انتشار موج آکوستیک از وضعیت و ضخامت بافتهای متفاوت را بدست دهد. شکل (۱) طرح کلی یک سیستم تصویر برداری A-mode را نشان می دهد [۲].

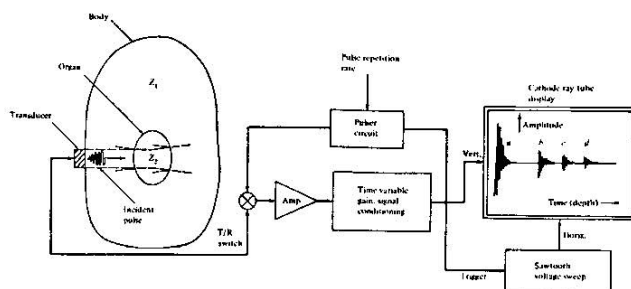


شکل ۱. اجزای اصلی یک سیستم ماوراء صوت A-scan

مدار تحریک، یک پالس با ولتاژ بالا تولید می کند که باعث تحریک میدل شده و یک پالس آکوستیکی تولید خواهد شد. سوئیچ T/R در واقع تقویت کننده حساس با بهره بالای ورودی را از موج تحریک که دارای دامنه ولتاژ زیاد است جدا میکند، در نتیجه از پدیده هایی نظیر اشباع و سوختن طبقات آن جلوگیری می شود. این کلید در حالت فرستندگی، موج تحریک را عبور داده و به میدل می رساند و در موقع گیرندگی، امواج ضعیف حاصل از انعکاس را به پیش تقویت کننده هدایت خواهد کرد.

به محض تحریک، یک مولد موج دندانه اره ای شروع به کار خواهد کرد که از این مدار برای جاروب افقی صفحه نمایش (CRT) استفاده می شود. اطلاعات عمودی صفحه نمایش نیز از سیگنالهای دریافتی که تقویت و پردازش شده اند، بدست خواهد آمد.

در گیرنده، مدارهای الکترونیکی وجود دارد که موج دریافتی را به منظور بهبود کیفیت و سادگی مطالعه روی آن، شکل دهی میکند. اولین طبقه تقویت کننده باید دارای بهره زیاد، نویز کم و پاسخ فرکانسی مطلوب جهت تقویت سیگنالهای ضعیف ورودی باشد. طبقه بعدی، تقویت کننده دیگری است که مقدار بهره آن با زمان تغییر میکند. این طبقه که به TGC<sup>۱</sup> معروف است برای جبران انعکاسهایی است که از اعماق پایین تری می آیند، زیرا این انعکاسها به دلیل طی مسافت بیشتر دچار تضعیف بیشتری شده اند. بهره طبقه TGC باید با نرخ حدوداً 1

<sup>۱</sup> Time Gain Control




dB/MHz برای دوره‌های زمانی که در آنها موج حدوداً 1 Cm از بافت را طی می‌کند، افزایش یابد. چون سرعت امواج آکوستیکی را در بافتهای نرم حدود 154 Cm/ms فرض کردیم بنابراین نرخ افزایش بهره برابر خواهد بود با 154 dB/ms به ازای هر 1MHz از امواج فرستاده شده.


یکی از زمینه‌هایی که روش A-mode در آن کاربرد فوق العاده دارد بررسی تورم میانی مغز<sup>۲</sup> است. این پدیده را میتوان از دریافت انعکاسهای سطوح نزدیک و دور مغز مورد بررسی قرار داد. از کاربردهای دیگر سیستم A-mode می توان به چشم پزشکی اشاره کرد. در این حیطه میتوان از قابلیت‌های سیستم A-mode در تشخیص ابعاد و اندازه کره چشم، انواع خونریزیهای داخلی، وجود تومورها و یا تشخیص موقعیت یک جسم خارجی که وارد چشم شده استفاده نمود. در این کاربردها به علت کوچکی فواصلی که باید اندازه گیری کرد از میدلهایی با فرکانس بالا بین 5-15MHz استفاده میشود که در نتیجه تصویر حاصله دارای دقت مناسبی خواهد بود

### ۳) سخت افزار

شکل (۲) شمای کلی سخت‌افزار طراحی شده را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می شود، قسمتهای سخت افزاری موجود قبل از میدل آنالوگ به دیجیتال، تقریباً مشابه آنچه به عنوان سیستم A-mode گفته شد، می باشد [۴]. از میدل A/D به بعد بخاطر دیجیتال شدن سیگنال و سیستم‌های لازم برای ذخیره و ارسال اطلاعات به کامپیوتر، ساختار مدار کاملاً شکل دیگری پیدا میکند. تحریک میدل ماوراءصوت توسط پالسهای

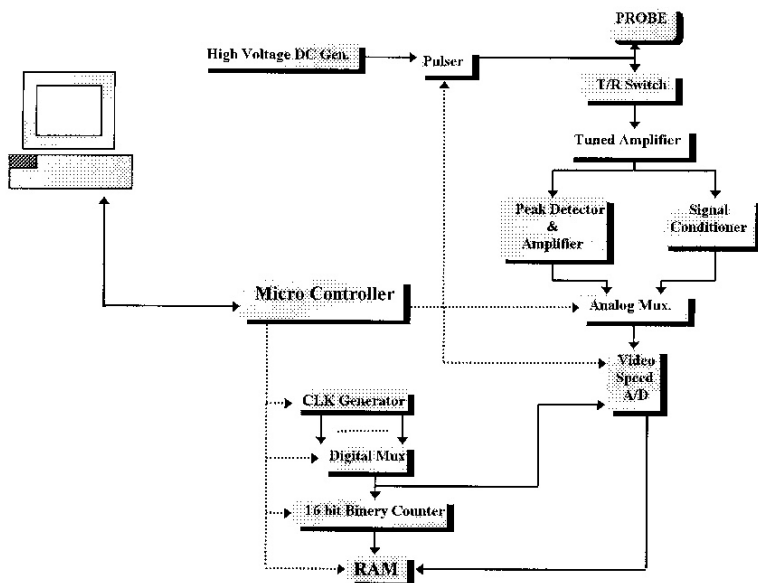

شکل ۲. طرح کلی سخت افزار سیستم



ولتاژ سوزنی شکل با دامنه ولتاژ زیاد صورت می‌پذیرد. به منظور تولید این پالسها، از یک مبدل سوئیچینگ DC/DC و یک مدار پالس استفاده شده است. مدار مبدل DC/DC یک ولتاژ قابل کنترل در رنج ۱۰۰ الی ۲۰۰ ولت تولید میکند و مدار پالس، با دستور میکرو کنترلر (MCS8951)، که نقش هماهنگ کننده قسمتهای گوناگون سیستم را بر عهده دارد [۵]، پالس مورد نیاز برای تحریک مبدل را فراهم می‌کند.

مبدل ماوراءصوت مورد استفاده در این پروژه، یک مبدل صنعتی با نام تجاری MB2S ساخت شرکت Krautkramer است. پس از تحریک، اکوهای بازگشتی وارد یک تقویت کننده با بهره بالا و پهنای باند محدود می‌شوند. این مدار به نحوی طراحی گردیده که امکان پشتیبانی از مبدلهای ماوراءصوتی با فرکانس مرکزی ۱ الی ۵ مگاهرتز را داشته باشد (فرکانس مرکزی مبدل MB2S، ۲ مگاهرتز است). پس از تقویت، بسته به دلخواه کاربر، سخت افزار امکان نمونه برداری از موج RF بازگشتی با پوش سیگنال (سیگنال A-scan) را دارد. این امکان به ما اجازه خواهد داد تا از این سیستم بتوانیم در آزمایشات دیگری مانند تشخیص نسوج بهره برداری نماییم. سرعت نمونه برداری مبدل آنالوگ به دیجیتال ۸ بیتی سیستم نیز توسط کاربر قابل تنظیم است و حداکثر می‌تواند تا ۱۲ مگاهرتز افزایش یابد. بدین ترتیب پس از تبدیل اطلاعات با شکل و سرعت نمونه برداری دلخواه به دیجیتال، این مجموعه در حافظه موجود در سخت افزار ذخیره شده و نهایتاً با دسترسی مستقیم میکروپروسور به کامپیوتر منتقل میگردد. در این انتقال، به جهت افزایش سرعت، سخت‌افزار به نحوی طراحی شده که از دخالت میکرو کنترلر جلوگیری میکند. البته برای افزایش سرعت سیستم می‌توان از قابلیت‌های DMA نیز استفاده نمود.

#### ۴) نرم افزار


سیستم طراحی شده، دارای دو نرم‌افزار میباشد که یکی به زبان پاسکال نوشته شده، در کامپیوتر اجرا میگردد و دیگری به زبان اسمبلی که در میکرو کنترلر وجود دارد. برای شناخت بهتر به بررسی هر بخش بصورت جداگانه می‌پردازیم.

#### ۴-۱) نرم افزار کامپیوتر

این نرم‌افزار که نمودار جریان آن در شکل (۳) مشاهده میشود، تحت سیستم عامل DOS و با استفاده از TurboPascal 7 نوشته شده و نقش یک واسطه گرافیکی بین کاربر و سیستم را بر عهده دارد. در این نرم افزار امکان انتخاب مشخصات کاری سیستم و نیز مشخصات یافت مورد آزمایش نظیر سرعت، عمق و ضریب TGC پیش بینی گردیده است. همچنین این نرم افزار امکان آشکار سازی امواج RF بازگشتی را بصورت نرم افزاری دارد که این امر ما را از پارامترهای غیر خطی مدار آشکار ساز بدور خواهد داشت.

#### ۴-۲) نرم افزار میکرو کنترلر


این نرم افزار که نمودار جریان آن در شکل (۴) نشان داده شده است، در محیط اسمبلی نوشته شده و قابلیت تنظیم پارامترهای قابل تغییر سیستم نظیر نرخ نمونه برداری، تنظیم زمان نمونه برداری و غیره را درد که برای این منظور توسط یک پروتکل ویژه با کامپیوتر ارتباط برقرار کرده و اطلاعات لازم را دریافت می‌کند.

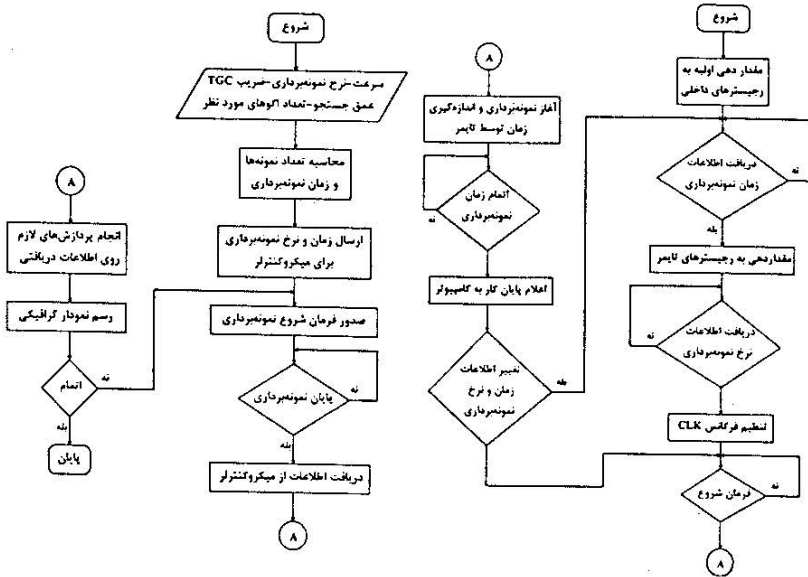

شکل ۳. نمودار جریان نرم افزار موجود در میکروکنترلر      شکل ۴. نمودار جریان نرم افزار موجود در کامپیوتر


ه) نتایج و اندازه گیریها

به منظور تست صحت عملکرد سیستم طراحی شده، با توجه به اینکه صرفاً یک مبدل ماوراء صوت صنعتی در اختیار بود، آزمایشهای گوناگونی روی یک قطعه آهن که نمای کلی آن در شکل (۵) آمده است، انجام گردید. در این حالت با قرار دادن مبدل بر روی آهن و استفاده از آب به عنوان ماده کوپل کننده، پس از تحریک مبدل ماوراء صوت، اکوهای بازگشتی زیادی خواهیم داشت که ناشی از حرکت موج داخل فلز، برخورد آن به دیواره و بازتابش مجدد می باشد.




شکل ۵. ابعاد و شکل قطعه آهنی مورد استفاده در آزمایش


برای نمایش اکوهای بازگشتی با توجه به سخت افزار طراحی شده، دو روش نمایش وجود دارد که هر دو در نرم افزار سیستم در نظر گرفته شده اند. روش اول نمایش اکوهای بازگشتی به صورت واقعی یا RF است. روش دوم که نمایش به شیوه A-mode است، اطلاعات امواج دریافتی پس از آشکارسازی، در صفحه نمایش رسم می گردند. علاوه بر روشهای فوق، دو حالت دیگر برای عملکرد سیستم در نظر گرفته شده است. این دو حالت را



با عنوان‌های Free Run و Step by Step شناسایی می‌کنیم. در حالت اول با اجرای برنامه، نرم‌افزار پس از هر بار دریافت و نمایش اطلاعات، مجدداً به صورت خودکار فرمان شروع را صادر می‌کند. در حالت دوم پس از دریافت اطلاعات مربوطه و نمایش آن در انتظار صدور فرمان مجدد از طرف کاربر می‌ماند. در این روش، مشاهده دقیق تصویر و بررسی آن امکان‌پذیر خواهد بود. به منظور تست صحیح عملکرد، آزمایش‌های گوناگونی با سیستم طراحی شده انجام گرفت که در شکل‌های (۶) و (۷)، دو نمونه از آنها نمایش داده شده است. اگر سرعت امواج آکوستیکی در آهن را  $5900 \text{ m/s}$  فرض کنیم [۳]، اطلاعات حاصله از محاسبات تنوری و مشاهدات عملی با یکدیگر هماهنگی نشان می‌دهند.

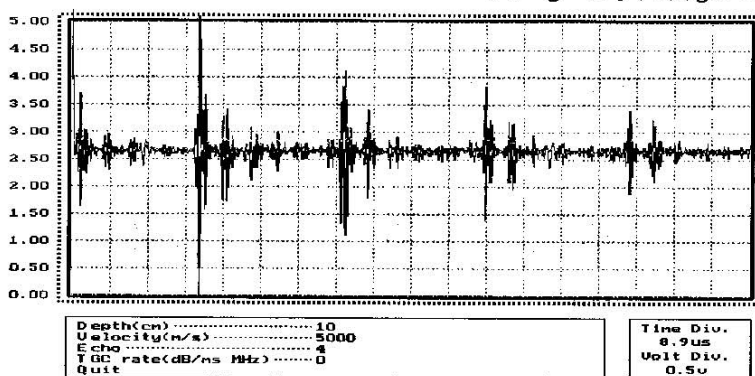


شکل ۶. تست افقی قطعه با نمایش سیگنال RF بدون TGC

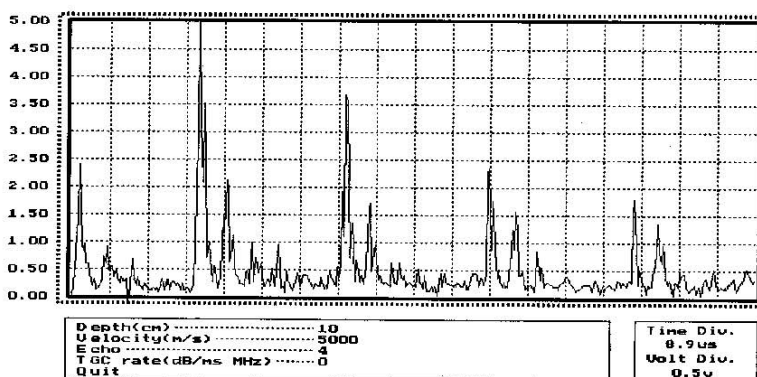

شکل ۷. تست افقی قطعه با نمایش موج آشکار شده بدون TGC

نتیجه گیری و پیشنهادات





۱- سخت افزار یک PC کلیه قابلیت‌های لازم از جمله سرعت بالای جابجایی اطلاعات برای انجام آزمایش اولتراسونیک روی بافت را دارا می باشد. از این رو امکان استفاده از سخت افزار کامپیوتر جهت انجام آزمایشات در بیمارستانها، کلینیکها و حتی مطبهای خصوصی وجود دارد. به این ترتیب طرح فوق این قابلیت را دارد که با حداقل هزینه، انجام تستهای اولتراسونیک را در مراکز درمانی ممکن سازد.

۲- علاوه بر آزمایش سونوگرافی و پیشانی، با بالا بردن فرکانس کار مبدل ماوراء صوت، از این سیستم می توان جهت تستهای مربوط به اپتومتری (آزمایشات معاینه چشم) استفاده نمود. طبق بررسی های انجام شده، در این مورد نیز یک PC کلیه قابلیت‌های لازم را دارا میباشد. البته سیستم طراحی شده در چارچوب این پروژه با مختصر تغییراتی می تواند جهت معاینات چشم بکار رود.

۳- با توجه به اینکه سخت‌افزار و نرم‌افزار ایجاد شده امکان استخراج سیگنال RF بازگشتی را در اختیار قرار می‌دهند، بنابراین این سیستم می تواند به عنوان یک مجموعه آزمایشگاهی جهت تحقیقات در زمینه تشخیص سونوگرافی به کمک ماوراءصوت بکار رود [۶]. همچنین PC امکان ارتقاء سیستم بصورت نرم افزاری را در اختیار قرار می‌دهد. بطور مثال با تکمیل نرم‌افزار سیستم از طریق پیاده سازی و افزودن الگوریتم های پردازش سیگنال دیجیتال، می توان ابزارهای لازم جهت تجزیه و تحلیل سیگنال را در اختیار قرار داد. پر واضح است که سیستم های تجاری معادل سیستم فوق، نمی توانند انعطاف پذیری‌های سیستم فوق را از خود نشان دهند.



۴- سیستم A-scan ایجاد شده، امکان ارزیابی توانایی یک PC را بمنظور ارتقاء سیستم جهت کار در فرکانسهای بالاتر و حتی تحقق سیستم تصویربرداری B-scan، میسر ساخته است. به نظر مجریان پروژه در حال حاضر، یک کامپیوتر شخصی، قادر به تامین احتیاجات محاسباتی و سرعتی مورد نیاز یک سیستم ساده B-scan می باشد.

در جهت بهینه سازی و ارتقاء سیستم ساخته شده، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:


- ۱) برای بالا بردن سرعت سیستم در انتقال اطلاعات می توان از قابلیت‌های DMA موجود در کامپیوتر استفاده نمود.
- ۲) به منظور ایجاد امکان ارتباط آسانتر کاربر با مجموعه ساخته شده، می توان یک محیط کاملاً گرافیکی با نرم افزارهای تحت Windows ایجاد نمود که امکان تغییر پارامترهای سیستم را در حین انجام کار نیز داشته باشد.
- ۳) برای ایجاد قابلیت بیشتر در پردازش اطلاعات، امکان تنظیم ضریب TGC به صورت یک منحنی غیر خطی برای کاربر وجود داشته باشد.
- ۴) امکان انجام انواع پردازش ها بر روی سیگنال بصورت از قبل تعریف شده وجود داشته باشد تا به وی در امر تشخیص کمک نماید.

#### مراجع

- [1] جواد صفایی، 'سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جهت تشخیص سینوزیتهای صورت و پیشانی'، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور ۱۳۷۹
- [2] Douglas A. Christensen, *Ultrasonic Biinstrumentation*, 1988, John Wiley & Sons.
- [3] Josef Krautkramer, Herbert Krautkramer, *Ultrasonic Testing of Materials*, 1990, Springer-Verlog
- [4] Albert S. Birks, *Nondestructive Testing Handbook*, 1995, Vol. 7, Ultrasonic Testing, American Society for Nondestructive Testing.
- [5] I. Scott Mackenzic, *The 8051 Microcontroller*, 1995, Prentice-Hall.
- [6] John T. Harnon, "Fetal Tissue Characterization for Transplantation", NIH Guide, Vol. 22, No. 28, August 1998.

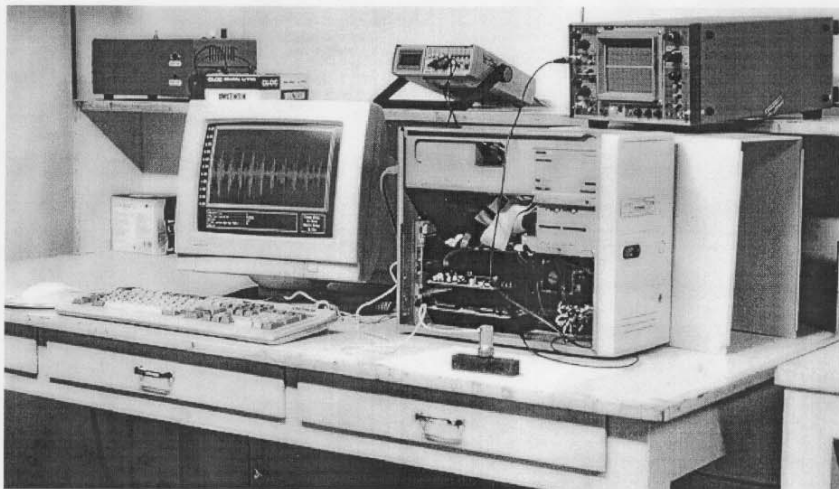

ضمیمه ۱- شمای کلی سیستم در حین کار

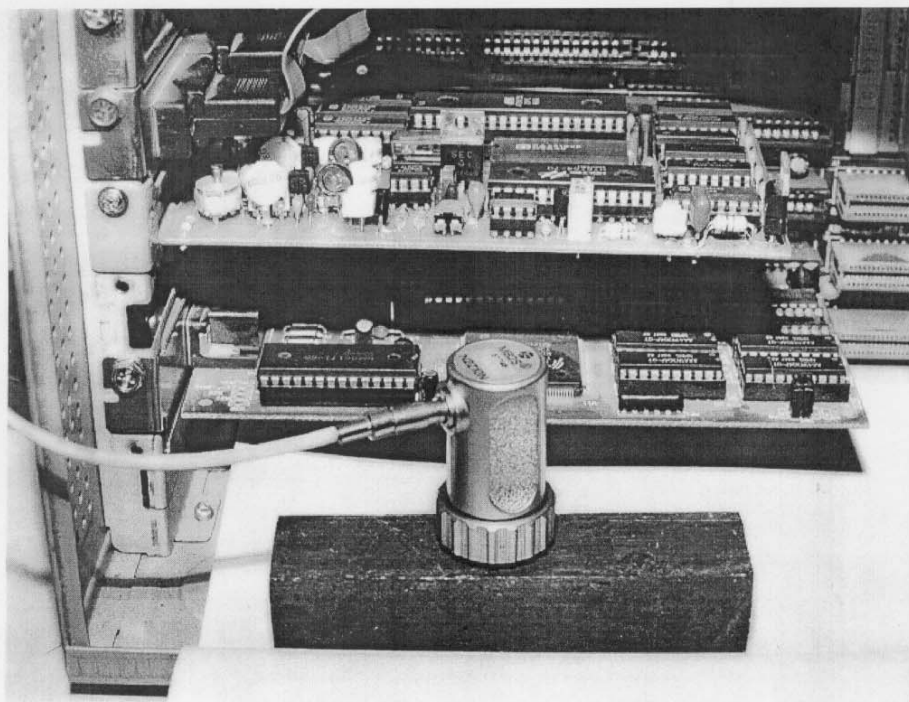

ضمیمه ۲- تصویر کارت طراحی شده، پراب و قطعه مورد آزمایش